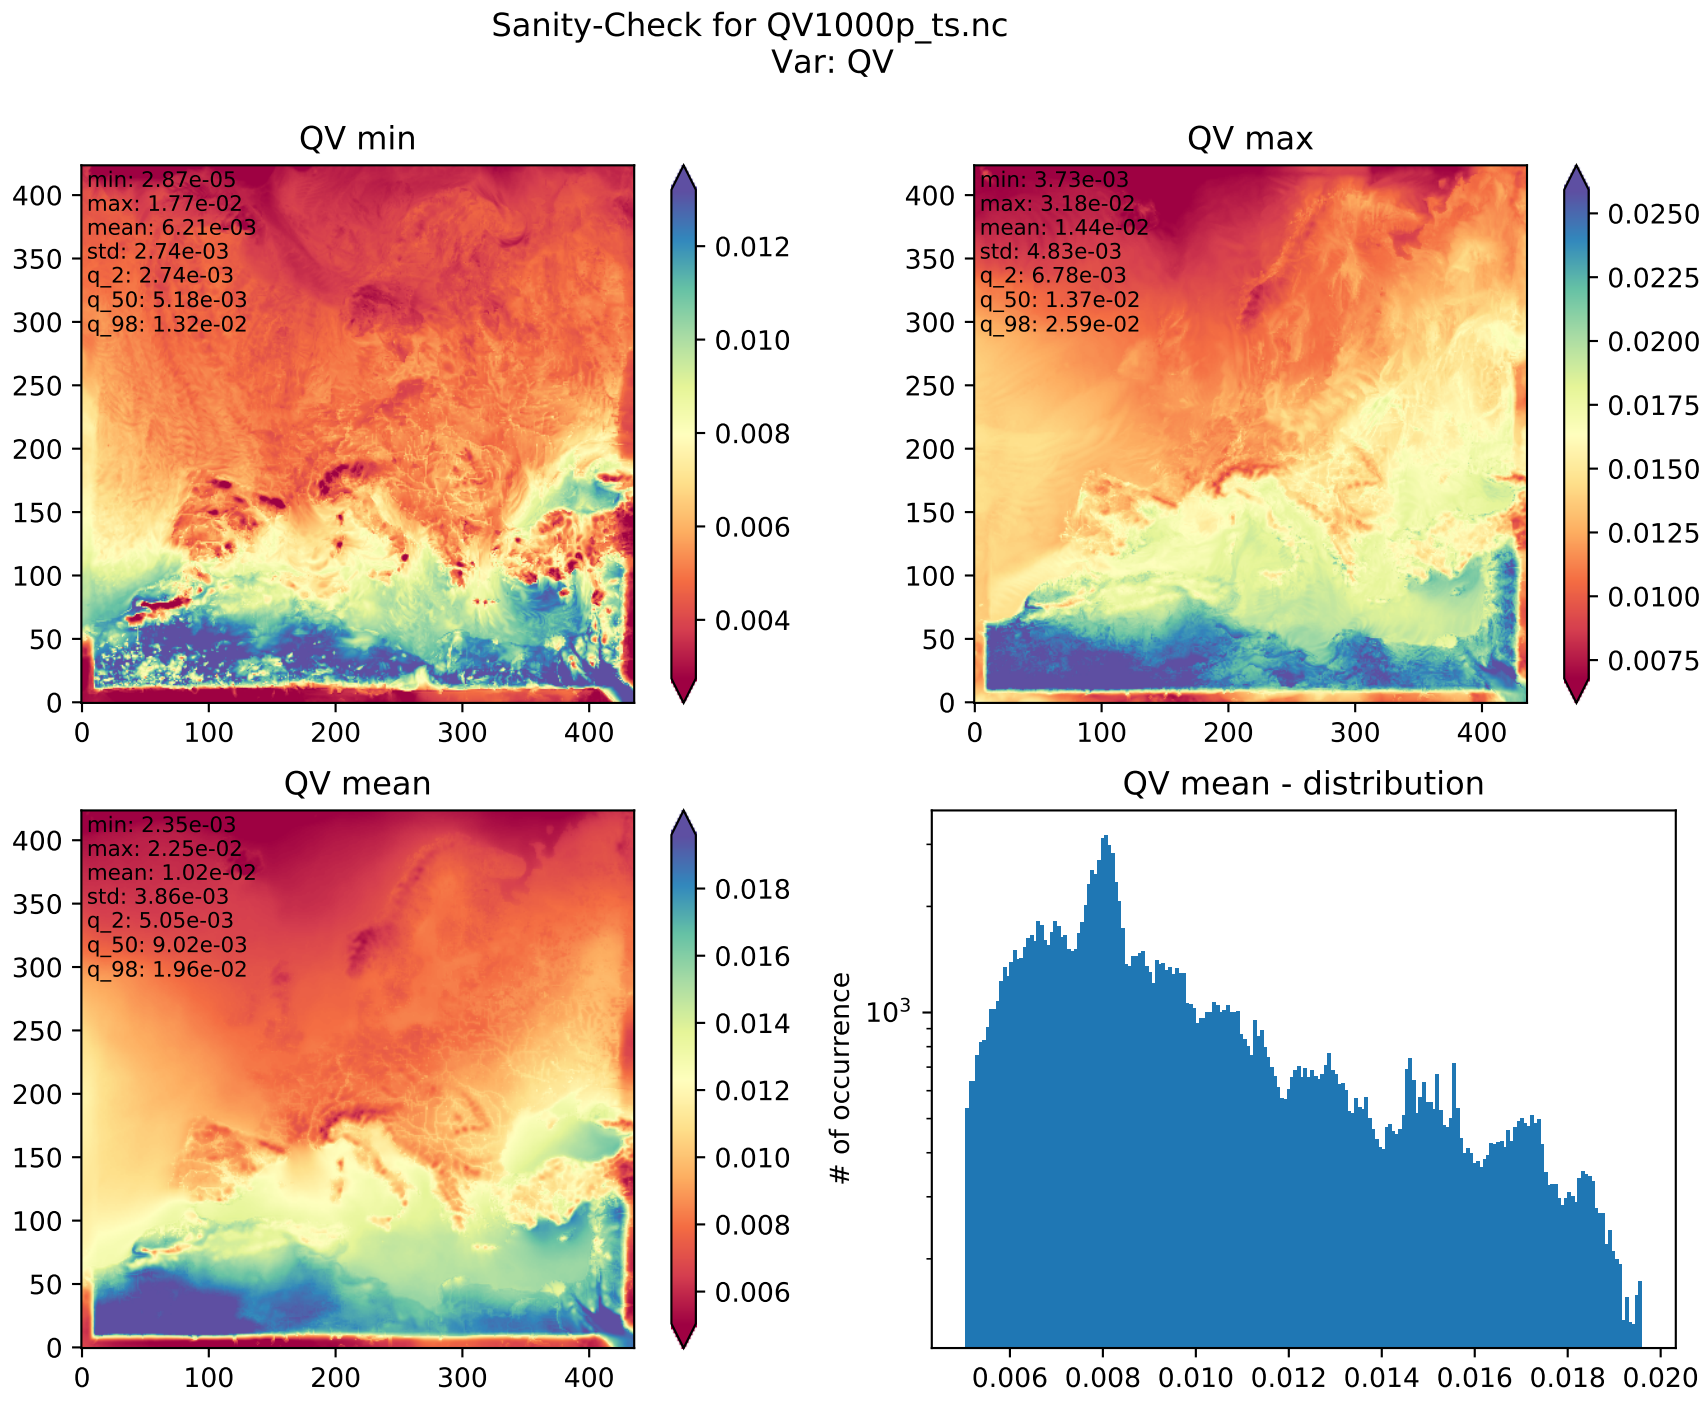
Sanity-Check for QV1000p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 2.87e-05
max: 1.77e-02
mean: 6.21e-03
std: 2.74e-03
q_2: 2.74e-03
q_50: 5.18e-03
q_98: 1.32e-02
QV max
min: 3.73e-03
max: 3.18e-02
mean: 1.44e-02
std: 4.83e-03
q_2: 6.78e-03
q_50: 1.37e-02
q_98: 2.59e-02
QV mean
min: 2.35e-03
max: 2.25e-02
mean: 1.02e-02
std: 3.86e-03
q_2: 5.05e-03
q_50: 9.02e-03
q_98: 1.96e-02
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3