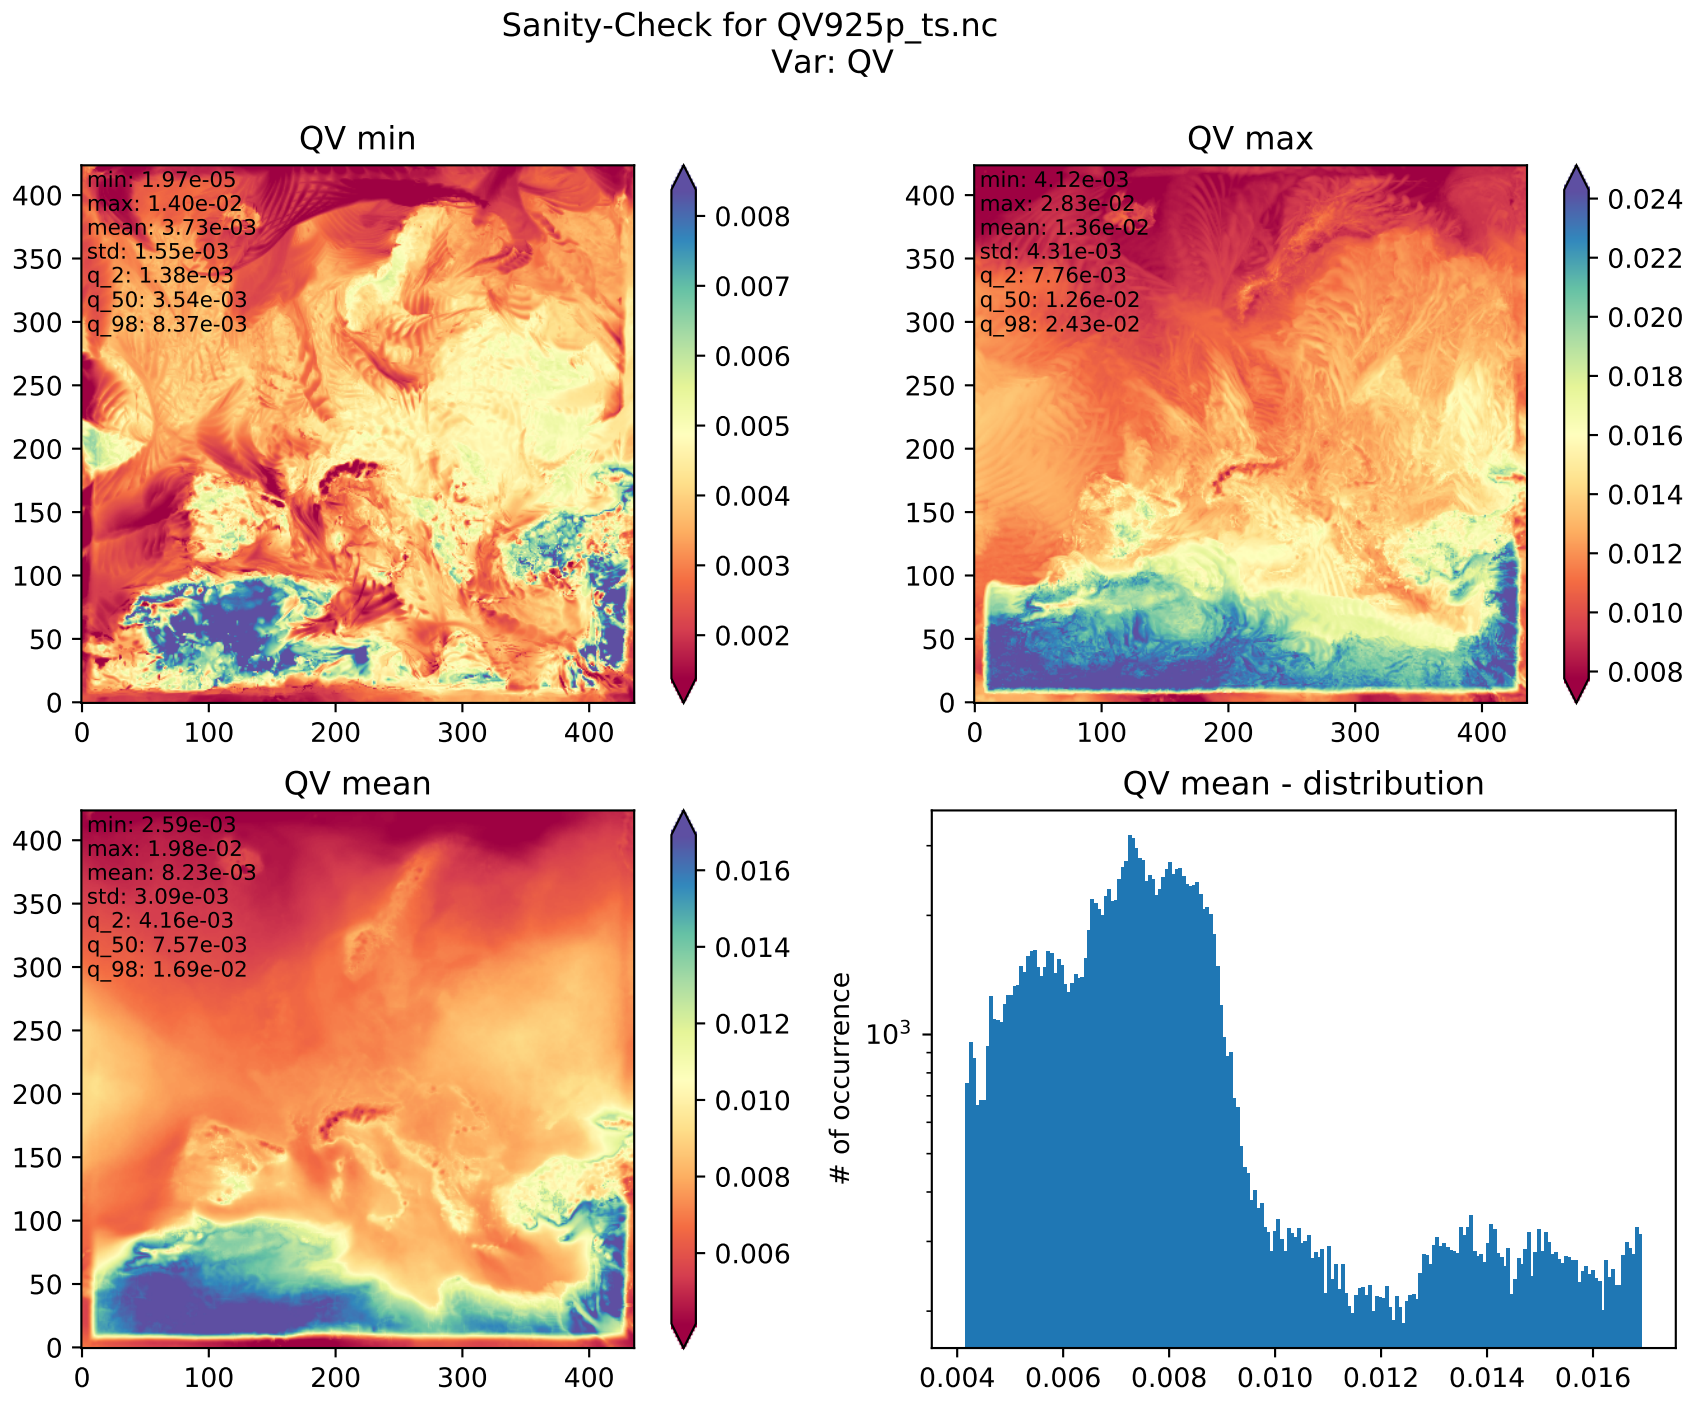
Sanity-Check for QV925p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 1.97e-05
max: 1.40e-02
mean: 3.73e-03
std: 1.55e-03
q_2: 1.38e-03
q_50: 3.54e-03
q_98: 8.37e-03
QV max
min: 4.12e-03
max: 2.83e-02
mean: 1.36e-02
std: 4.31e-03
q_2: 7.76e-03
q_50: 1.26e-02
q_98: 2.43e-02
QV mean
min: 2.59e-03
max: 1.98e-02
mean: 8.23e-03
std: 3.09e-03
q_2: 4.16e-03
q_50: 7.57e-03
q_98: 1.69e-02
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3