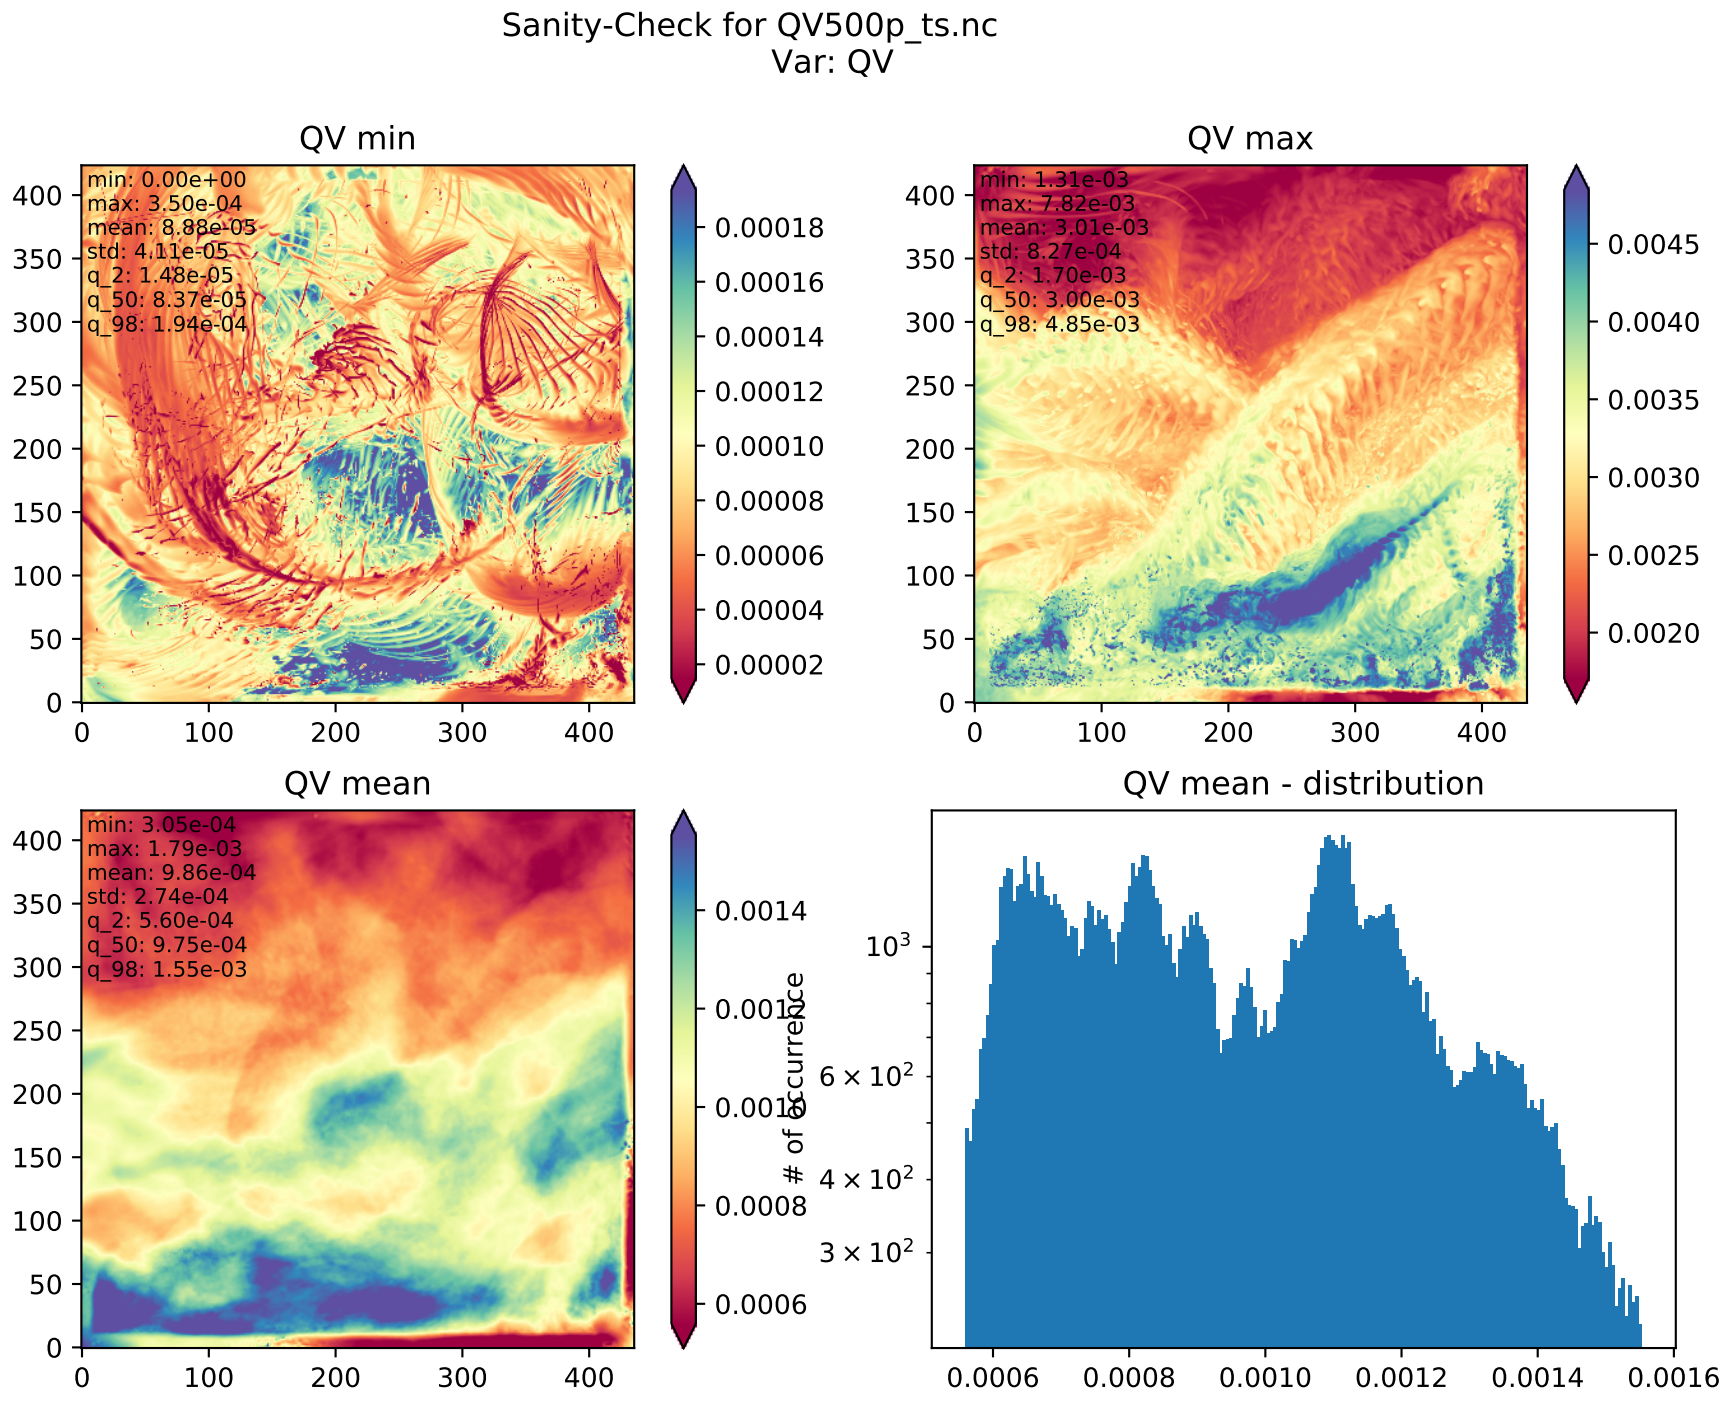
Sanity-Check for QV500p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 0.00e+00
max: 3.50e-04
mean: 8.88e-05
std: 4.11e-05
q_2: 1.48e-05
q_50: 8.37e-05
q_98: 1.94e-04
QV max
min: 1.31e-03
max: 7.82e-03
mean: 3.01e-03
std: 8.27e-04
q_2: 1.70e-03
q_50: 3.00e-03
q_98: 4.85e-03
QV mean
min: 3.05e-04
max: 1.79e-03
mean: 9.86e-04
std: 2.74e-04
q_2: 5.60e-04
q_50: 9.75e-04
q_98: 1.55e-03
QV mean - distribution
# of occurrence