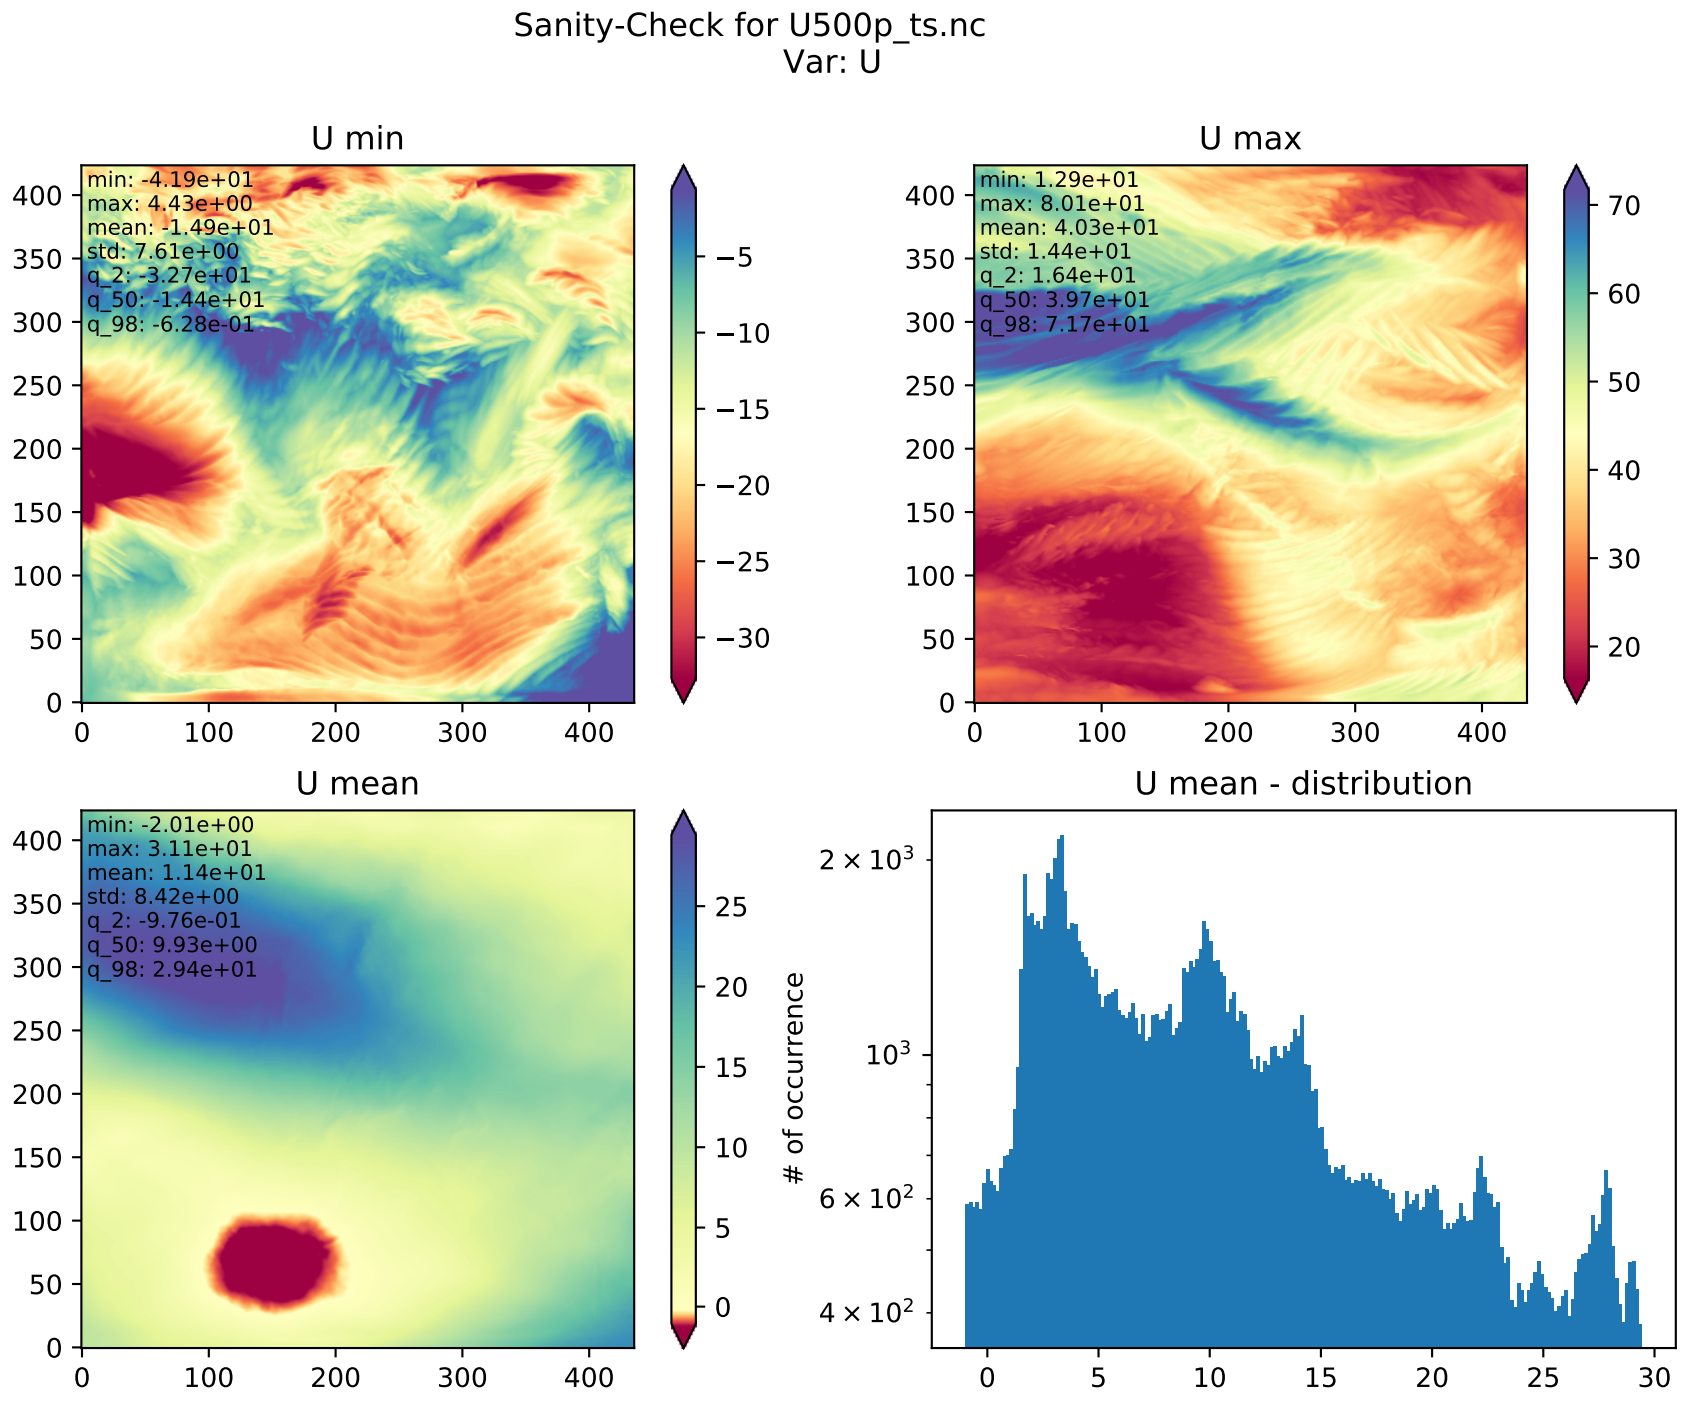
Sanity-Check for U500p_ts.nc
Var: U
U min
min: -4.19e+01
max: 4.43e+00
mean: -1.49e+01
std: 7.61e+00
q_2: -3.27e+01
q_50: -1.44e+01
q_98: -6.28e-01
U max
min: 1.29e+01
max: 8.01e+01
mean: 4.03e+01
std: 1.44e+01
q_2: 1.64e+01
q_50: 3.97e+01
q_98: 7.17e+01
U mean
min: -2.01e+00
max: 3.11e+01
mean: 1.14e+01
std: 8.42e+00
q_2: -9.76e-01
q_50: 9.93e+00
q_98: 2.94e+01
U mean - distribution
# of occurrence