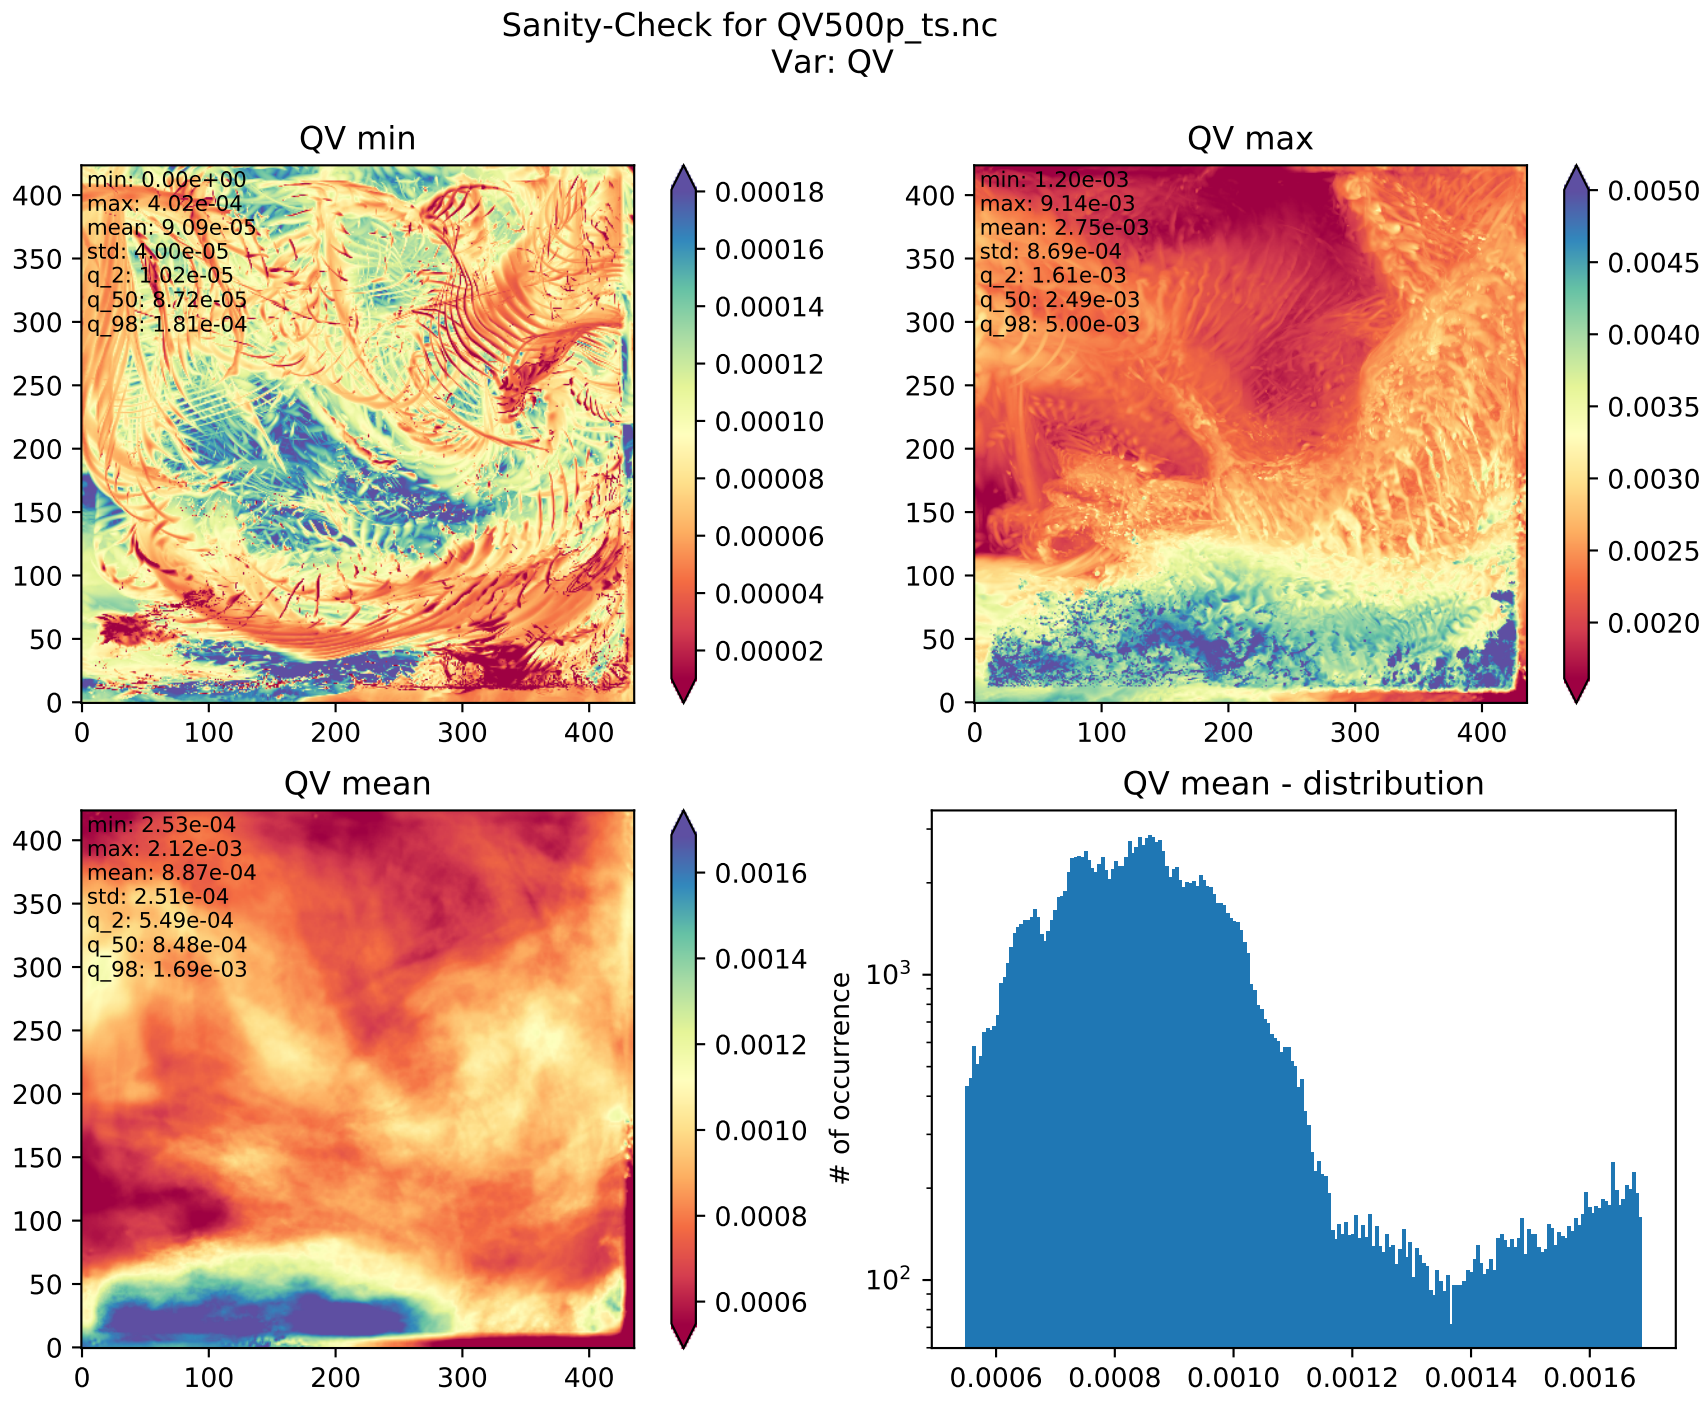
Sanity-Check for QV500p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 0.00e+00
max: 4.02e-04
mean: 9.09e-05
std: 4.00e-05
q_2: 1.02e-05
q_50: 8.72e-05
q_98: 1.81e-04
QV max
min: 1.20e-03
max: 9.14e-03
mean: 2.75e-03
std: 8.69e-04
q_2: 1.61e-03
q_50: 2.49e-03
q_98: 5.00e-03
QV mean
min: 2.53e-04
max: 2.12e-03
mean: 8.87e-04
std: 2.51e-04
q_2: 5.49e-04
q_50: 8.48e-04
q_98: 1.69e-03
QV mean - distribution
# of occurrence