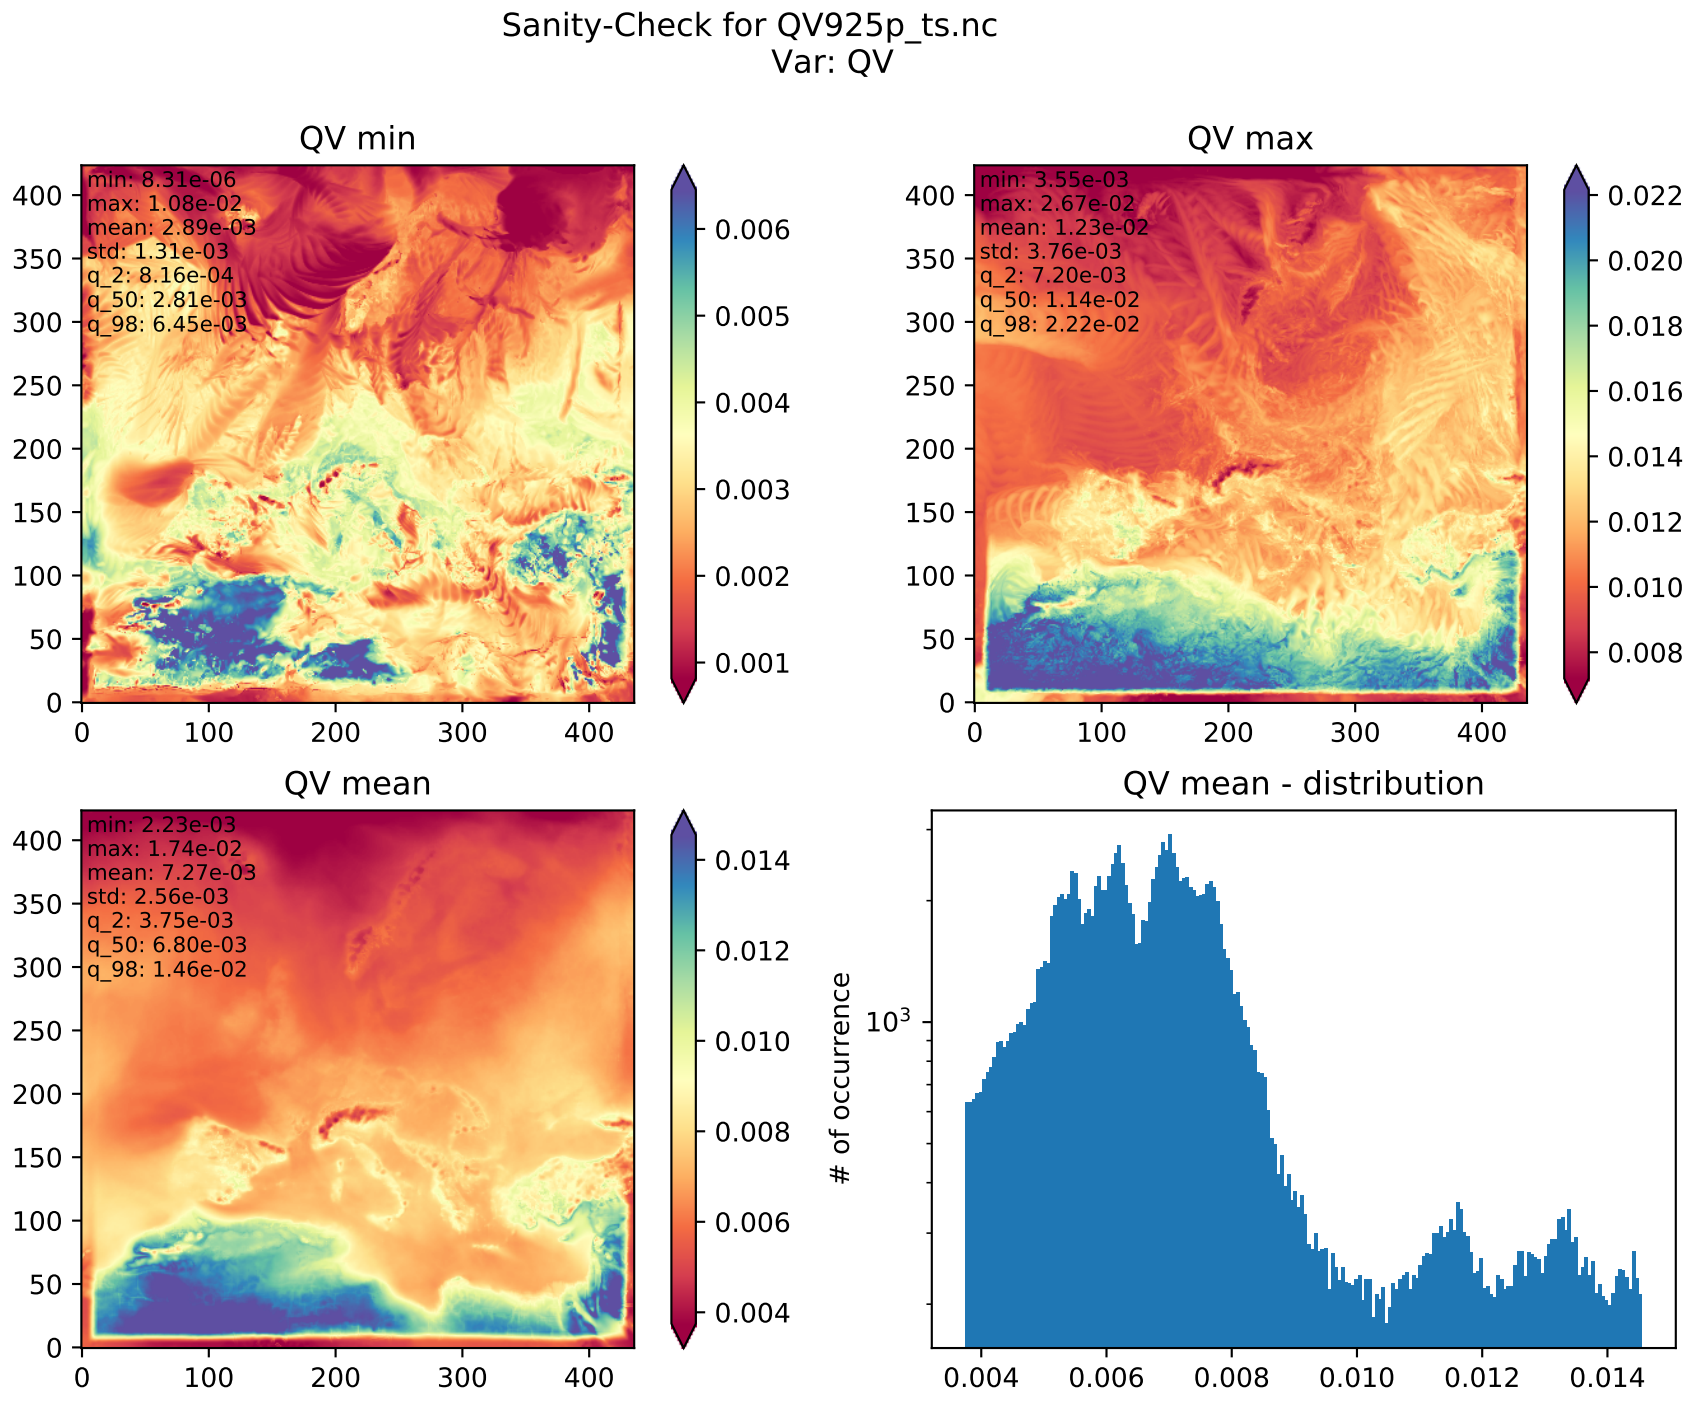
Sanity-Check for QV925p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 8.31e-06
max: 1.08e-02
mean: 2.89e-03
std: 1.31e-03
q_2: 8.16e-04
q_50: 2.81e-03
q_98: 6.45e-03
QV max
min: 3.55e-03
max: 2.67e-02
mean: 1.23e-02
std: 3.76e-03
q_2: 7.20e-03
q_50: 1.14e-02
q_98: 2.22e-02
QV mean
min: 2.23e-03
max: 1.74e-02
mean: 7.27e-03
std: 2.56e-03
q_2: 3.75e-03
q_50: 6.80e-03
q_98: 1.46e-02
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3