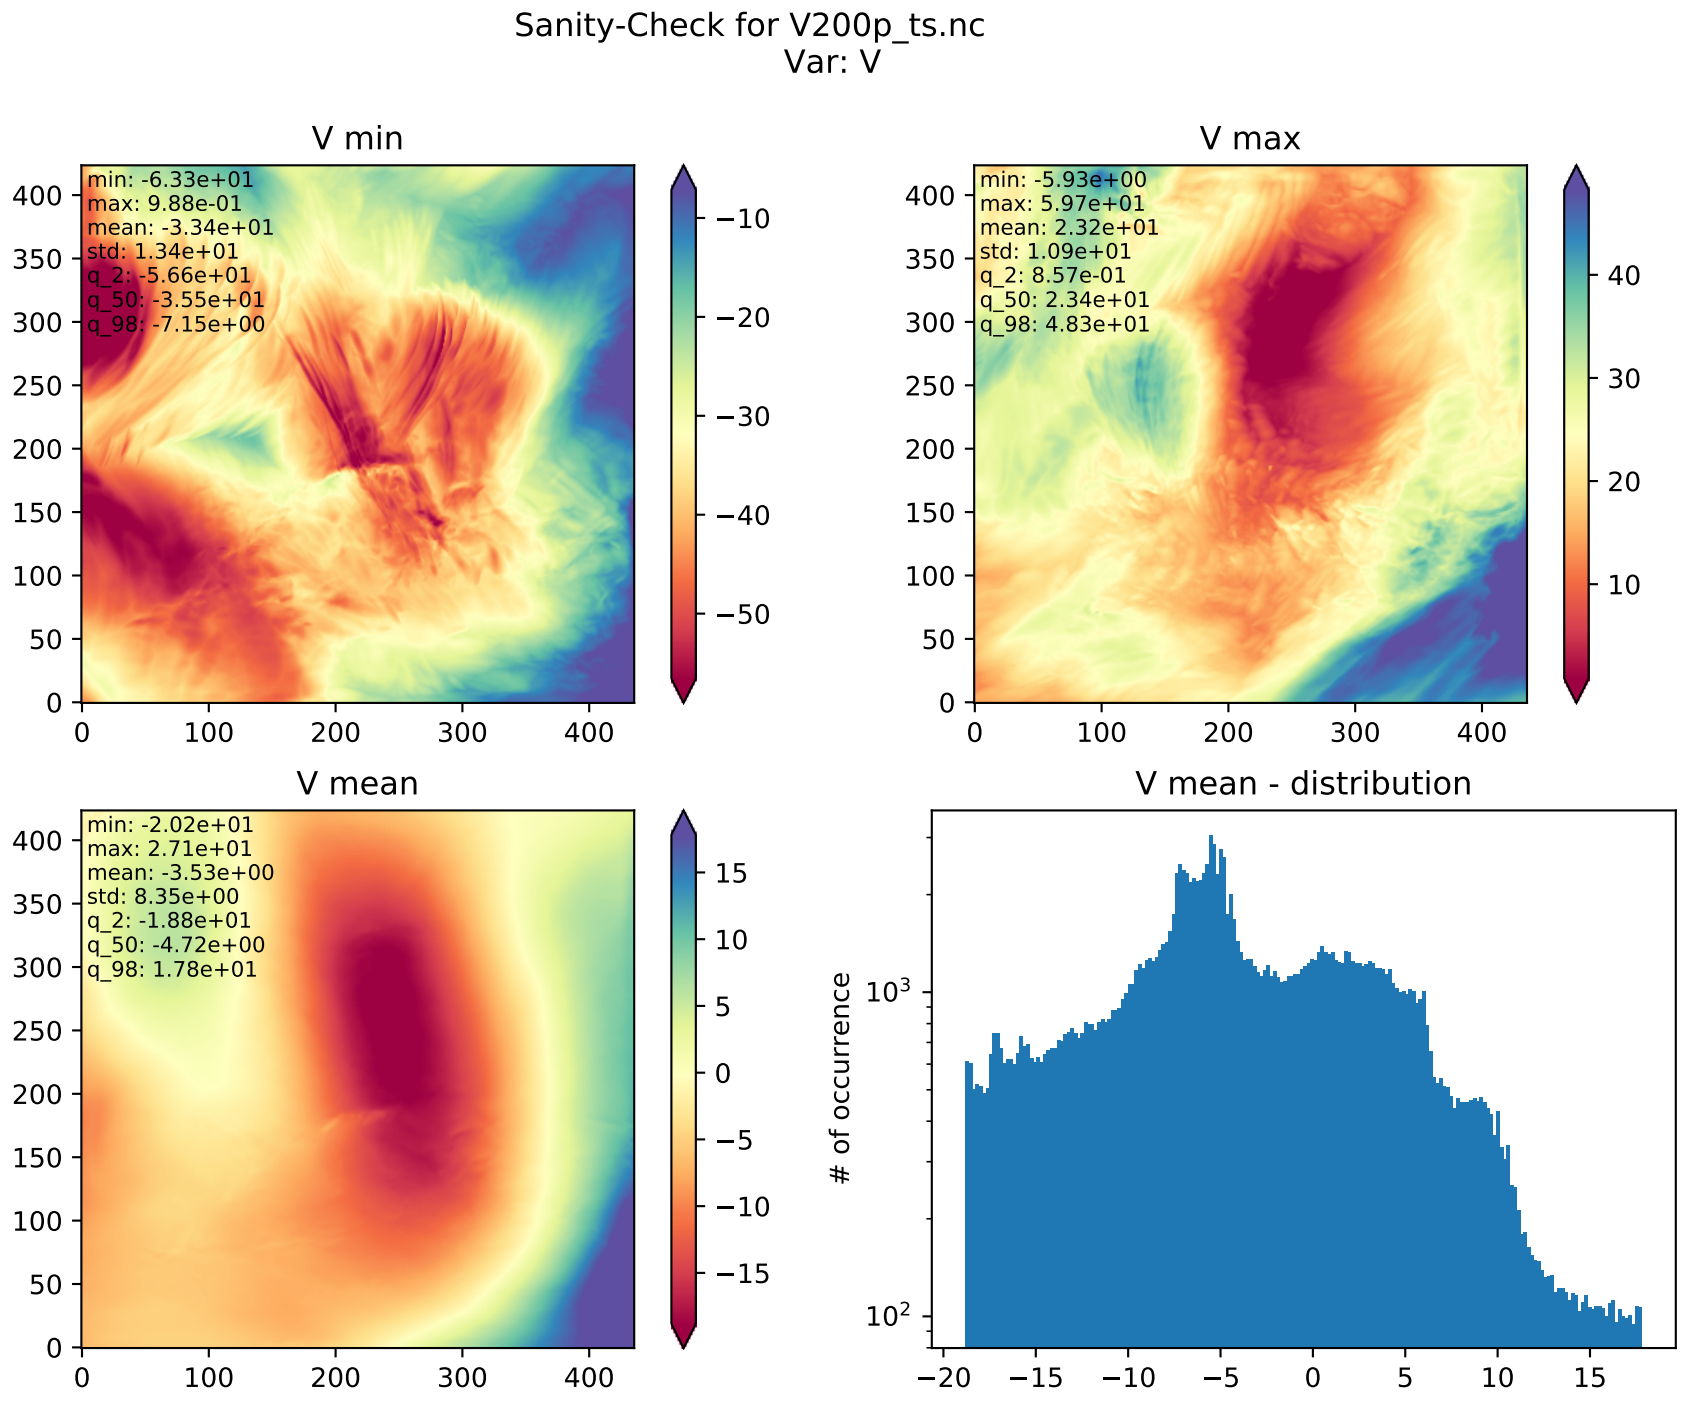
Sanity-Check for V200p_ts.nc
Var: V
V min
min: -6.33e+01
max: 9.88e-01
mean: -3.34e+01
std: 1.34e+01
q_2: -5.66e+01
q_50: -3.55e+01
q_98: -7.15e+00
V max
min: -5.93e+00
max: 5.97e+01
mean: 2.32e+01
std: 1.09e+01
q_2: 8.57e-01
q_50: 2.34e+01
q_98: 4.83e+01
V mean
min: -2.02e+01
max: 2.71e+01
mean: -3.53e+00
std: 8.35e+00
q_2: -1.88e+01
q_50: -4.72e+00
q_98: 1.78e+01
V mean - distribution
# of occurrence