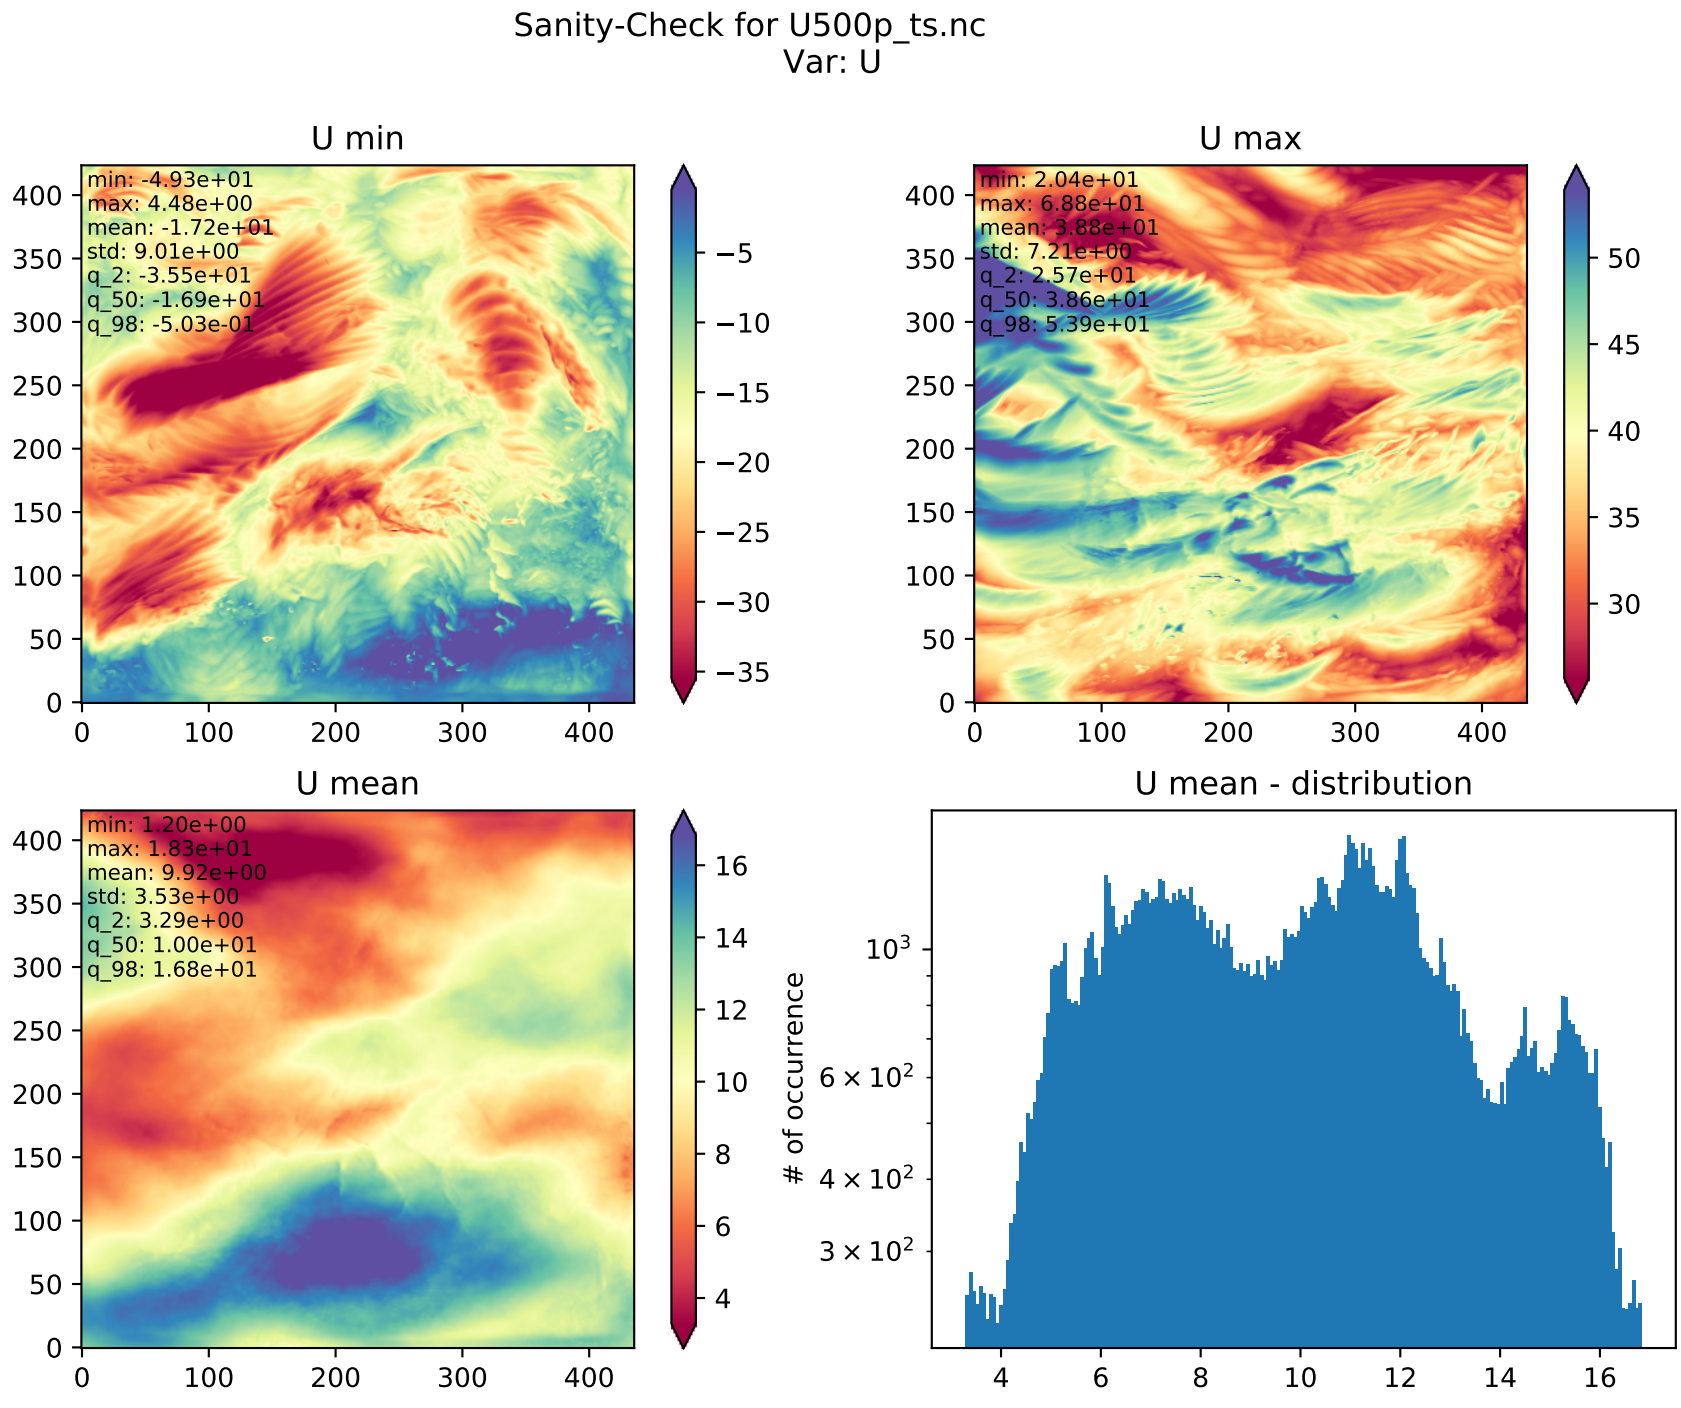
Sanity-Check for U500p_ts.nc
Var: U
U min
min: -4.93e+01
max: 4.48e+00
mean: -1.72e+01
std: 9.01e+00
q_2: -3.55e+01
q_50: -1.69e+01
q_98: -5.03e-01
U max
min: 2.04e+01
max: 6.88e+01
mean: 3.88e+01
std: 7.21e+00
q_2: 2.57e+01
q_50: 3.86e+01
q_98: 5.39e+01
U mean
min: 1.20e+00
max: 1.83e+01
mean: 9.92e+00
std: 3.53e+00
q_2: 3.29e+00
q_50: 1.00e+01
q_98: 1.68e+01
U mean - distribution
# of occurrence