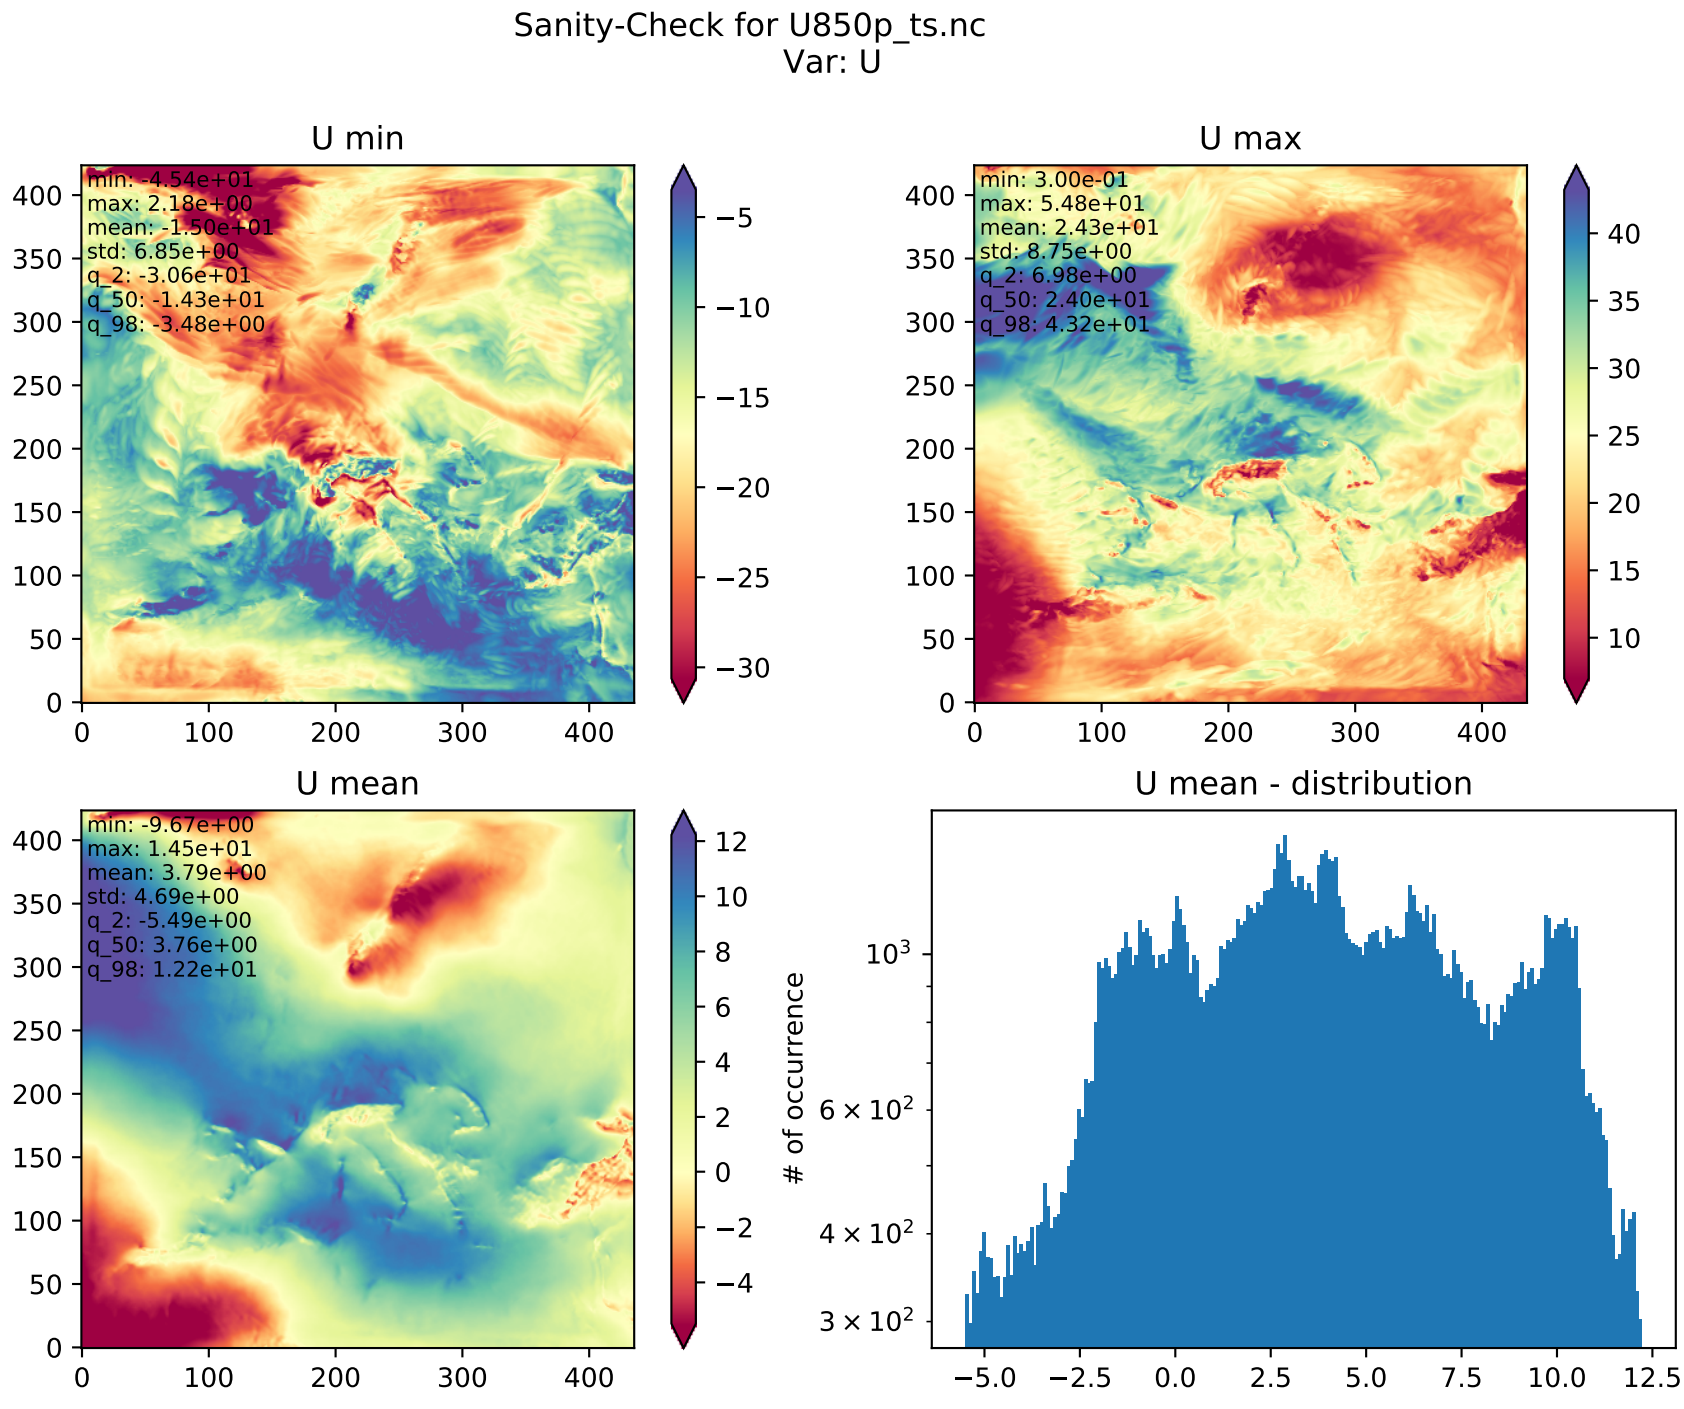
Sanity-Check for U850p_ts.nc
Var: U
U min
min: -4.54e+01
max: 2.18e+00
mean: -1.50e+01
std: 6.85e+00
q_2: -3.06e+01
q_50: -1.43e+01
q_98: -3.48e+00
U max
min: 3.00e-01
max: 5.48e+01
mean: 2.43e+01
std: 8.75e+00
q_2: 6.98e+00
q_50: 2.40e+01
q_98: 4.32e+01
U mean
min: -9.67e+00
max: 1.45e+01
mean: 3.79e+00
std: 4.69e+00
q_2: -5.49e+00
q_50: 3.76e+00
q_98: 1.22e+01
U mean - distribution
# of occurrence