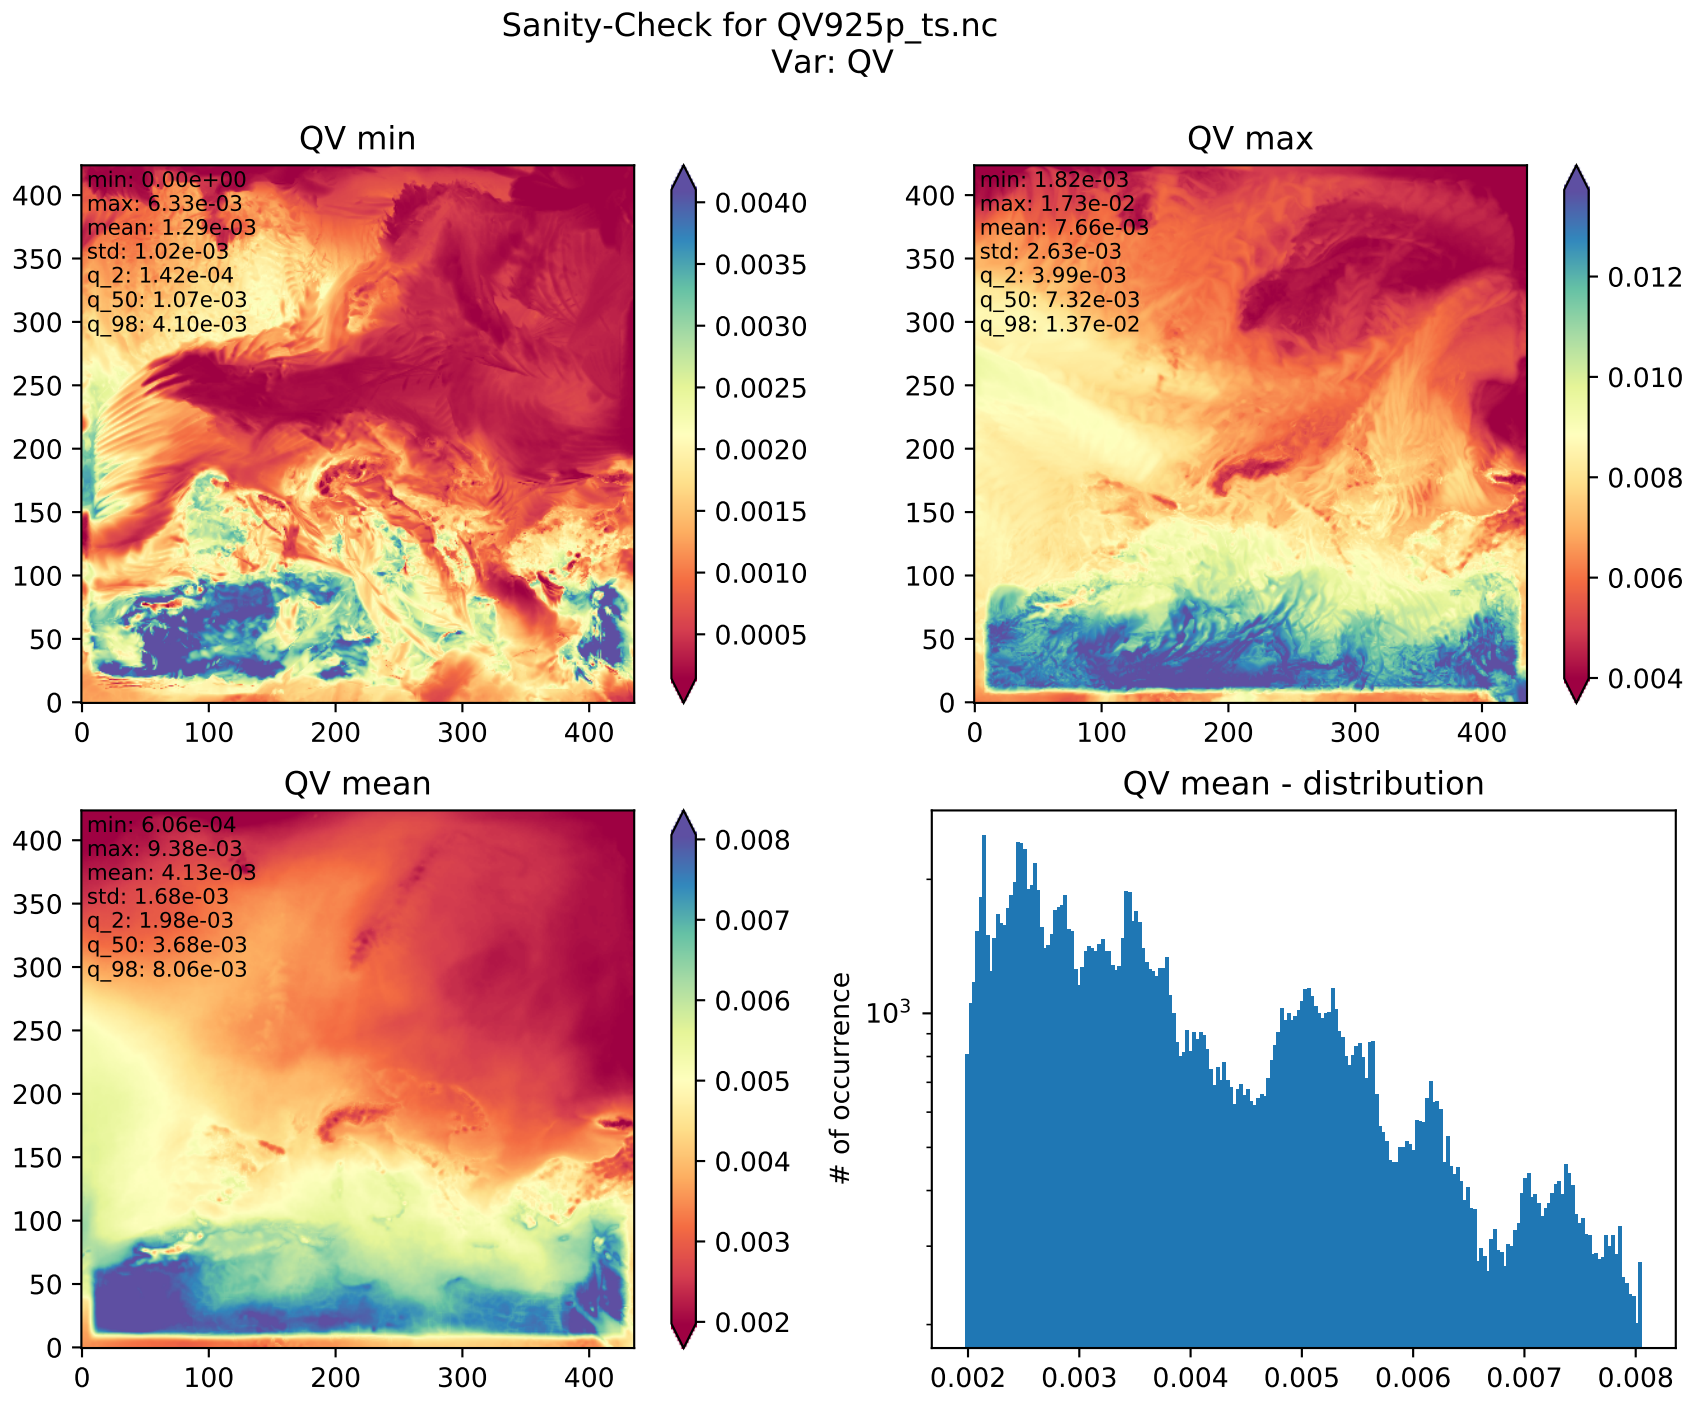
Sanity-Check for QV925p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 0.00e+00
max: 6.33e-03
mean: 1.29e-03
std: 1.02e-03
q_2: 1.42e-04
q_50: 1.07e-03
q_98: 4.10e-03
QV max
min: 1.82e-03
max: 1.73e-02
mean: 7.66e-03
std: 2.63e-03
q_2: 3.99e-03
q_50: 7.32e-03
q_98: 1.37e-02
QV mean
min: 6.06e-04
max: 9.38e-03
mean: 4.13e-03
std: 1.68e-03
q_2: 1.98e-03
q_50: 3.68e-03
q_98: 8.06e-03
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3