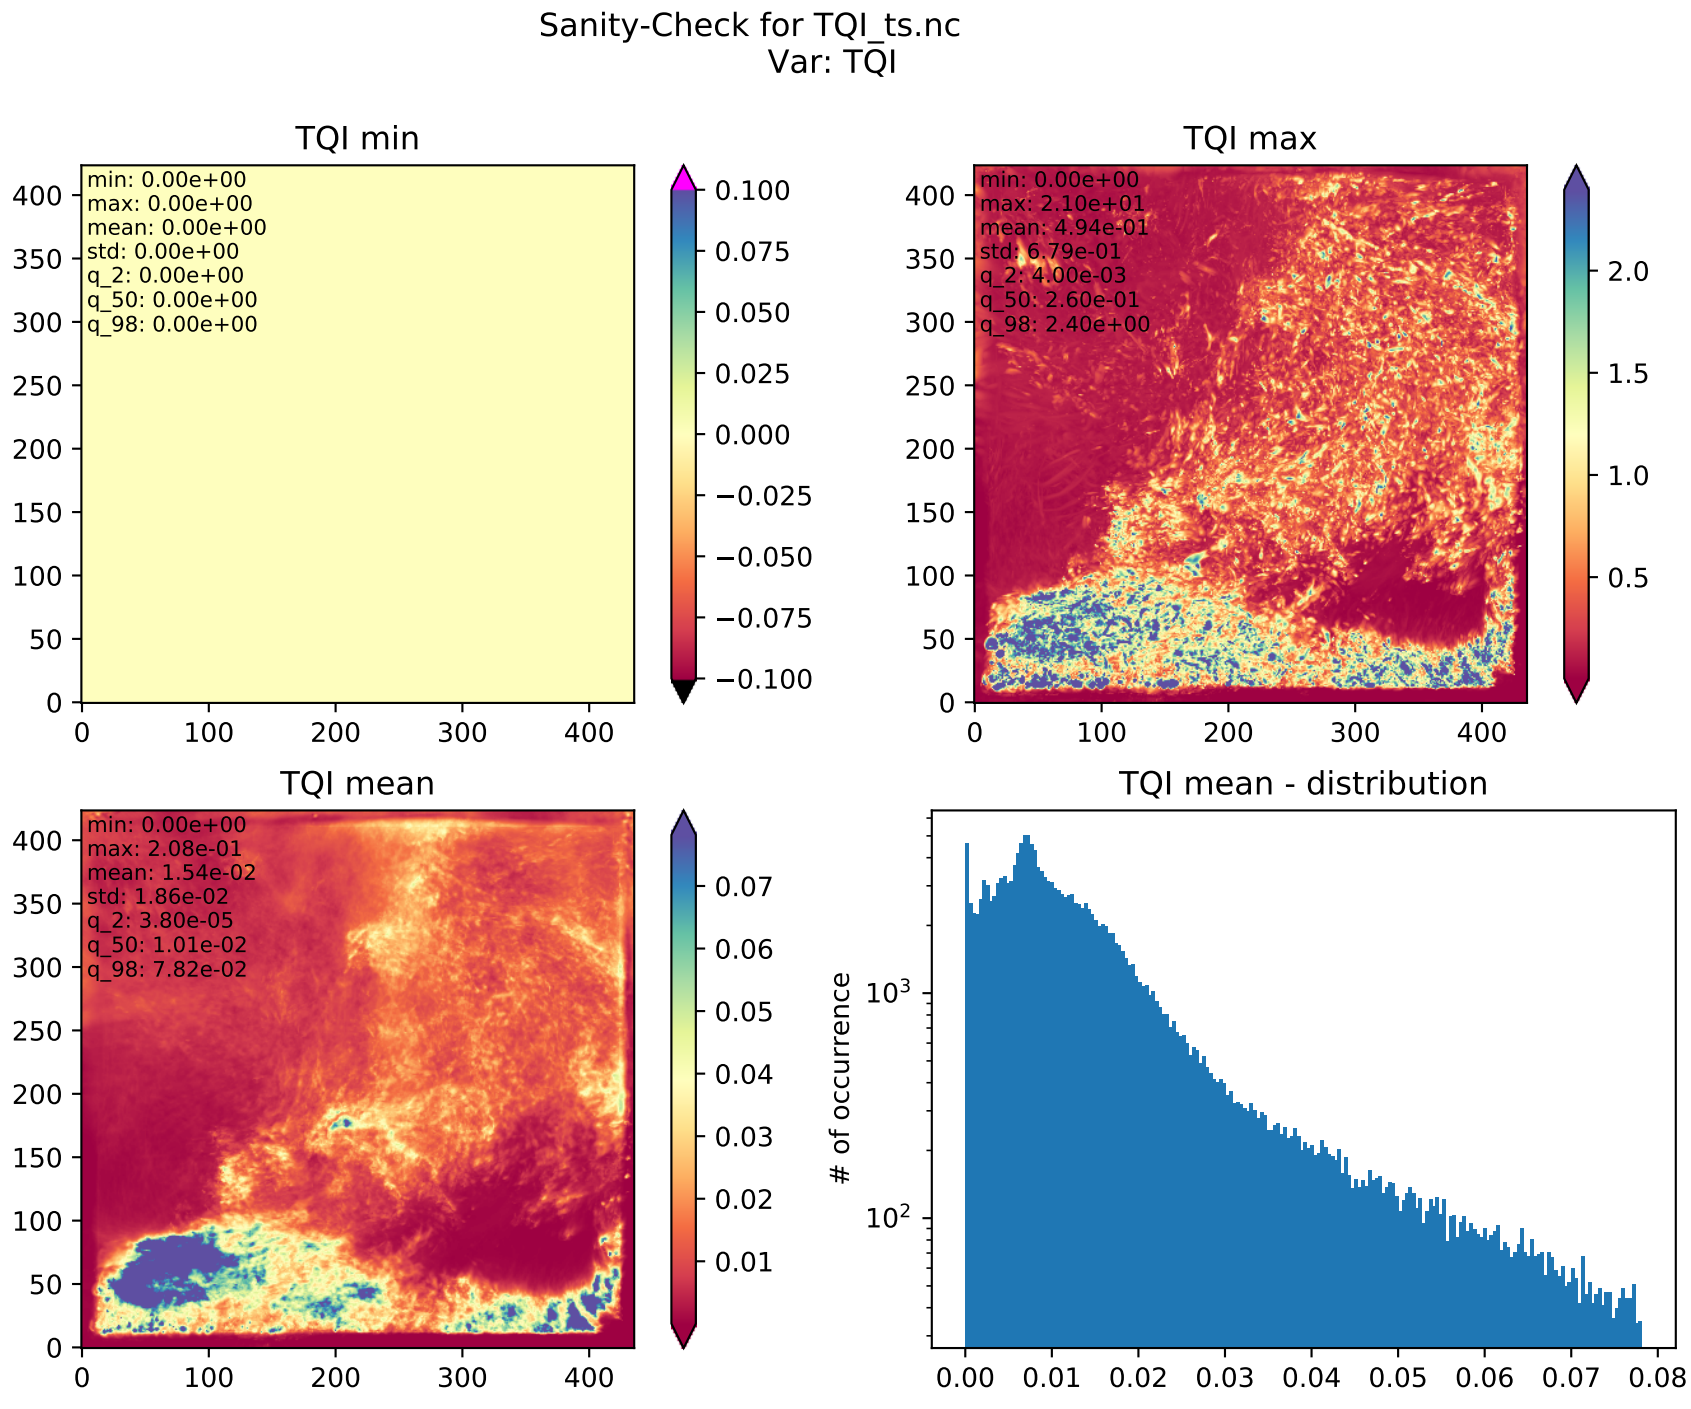
Sanity-Check for TQI_ts.nc
Var: TQI
TQI min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TQI max
min: 0.00e+00
max: 2.10e+01
mean: 4.94e-01
std: 6.79e-01
q_2: 4.00e-03
q_50: 2.60e-01
q_98: 2.40e+00
TQI mean
min: 0.00e+00
max: 2.08e-01
mean: 1.54e-02
std: 1.86e-02
q_2: 3.80e-05
q_50: 1.01e-02
q_98: 7.82e-02
TQI mean - distribution
# of occurrence