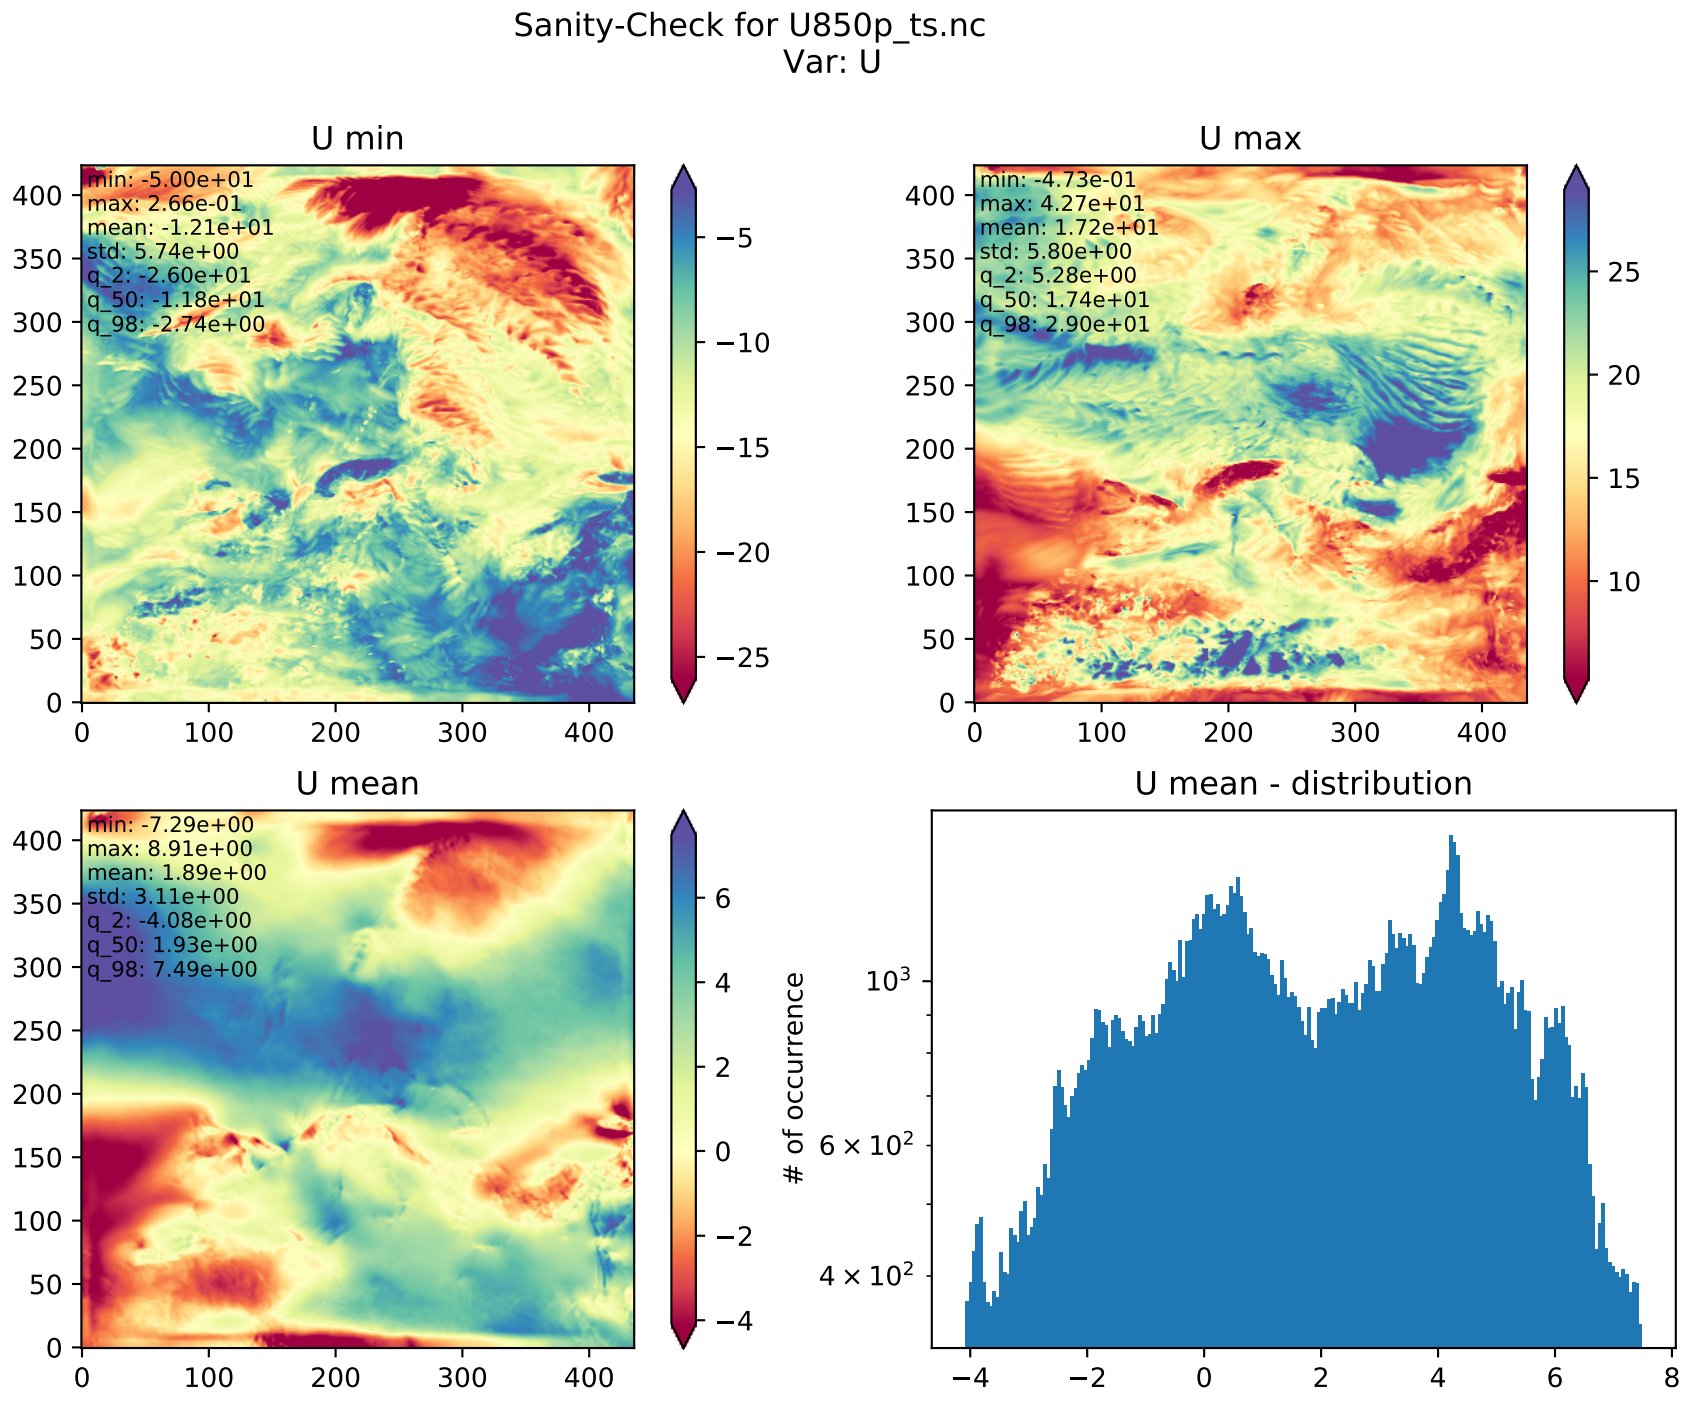
Sanity-Check for U850p_ts.nc
Var: U
U min
min: -5.00e+01
max: 2.66e-01
mean: -1.21e+01
std: 5.74e+00
q_2: -2.60e+01
q_50: -1.18e+01
q_98: -2.74e+00
U max
min: -4.73e-01
max: 4.27e+01
mean: 1.72e+01
std: 5.80e+00
q_2: 5.28e+00
q_50: 1.74e+01
q_98: 2.90e+01
U mean
min: -7.29e+00
max: 8.91e+00
mean: 1.89e+00
std: 3.11e+00
q_2: -4.08e+00
q_50: 1.93e+00
q_98: 7.49e+00
U mean - distribution
# of occurrence