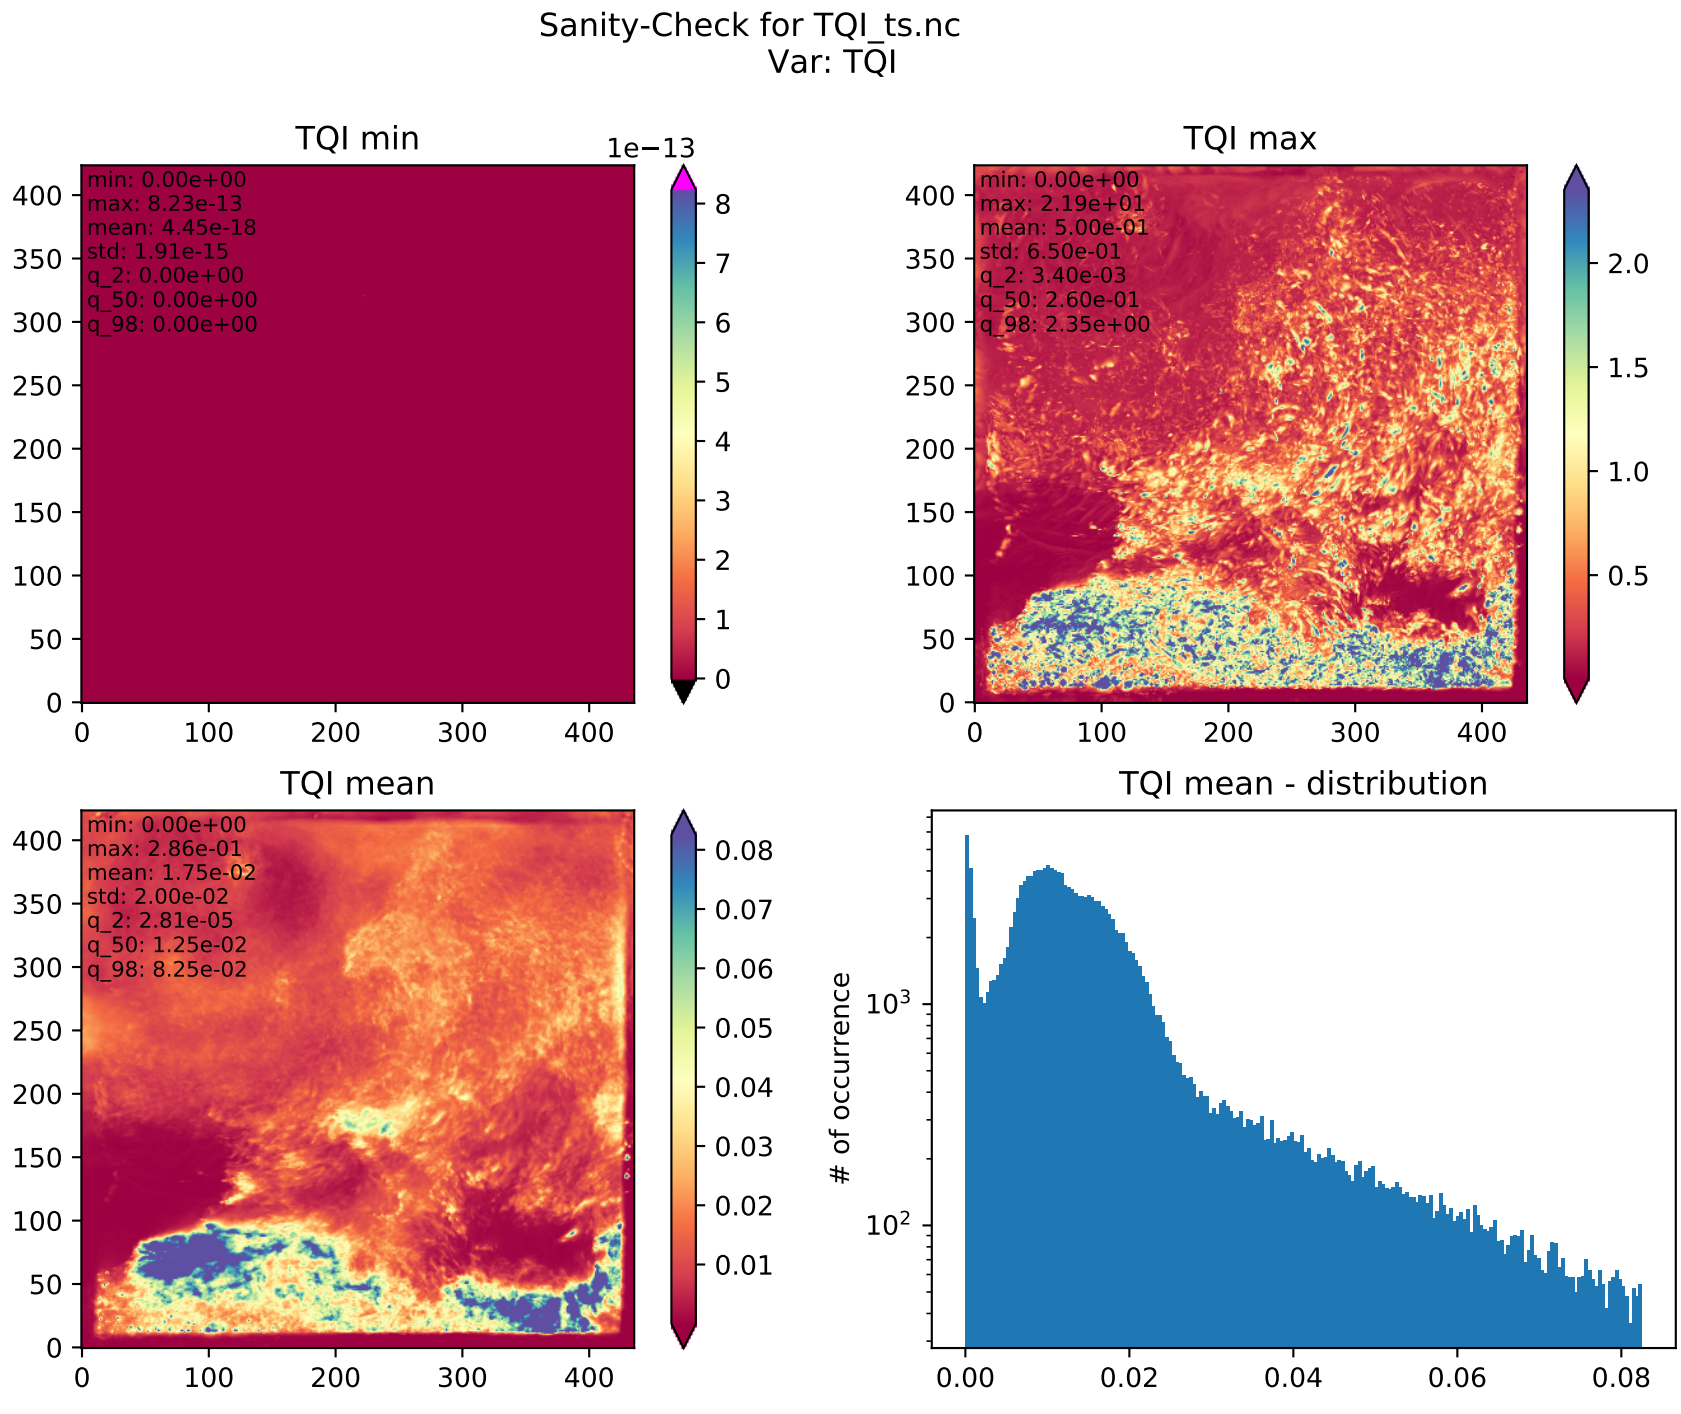
Sanity-Check for TQI_ts.nc
Var: TQI
TQI min
min: 0.00e+00
max: 8.23e-13
mean: 4.45e-18
std: 1.91e-15
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−13
TQI max
min: 0.00e+00
max: 2.19e+01
mean: 5.00e-01
std: 6.50e-01
q_2: 3.40e-03
q_50: 2.60e-01
q_98: 2.35e+00
TQI mean
min: 0.00e+00
max: 2.86e-01
mean: 1.75e-02
std: 2.00e-02
q_2: 2.81e-05
q_50: 1.25e-02
q_98: 8.25e-02
TQI mean - distribution
# of occurrence