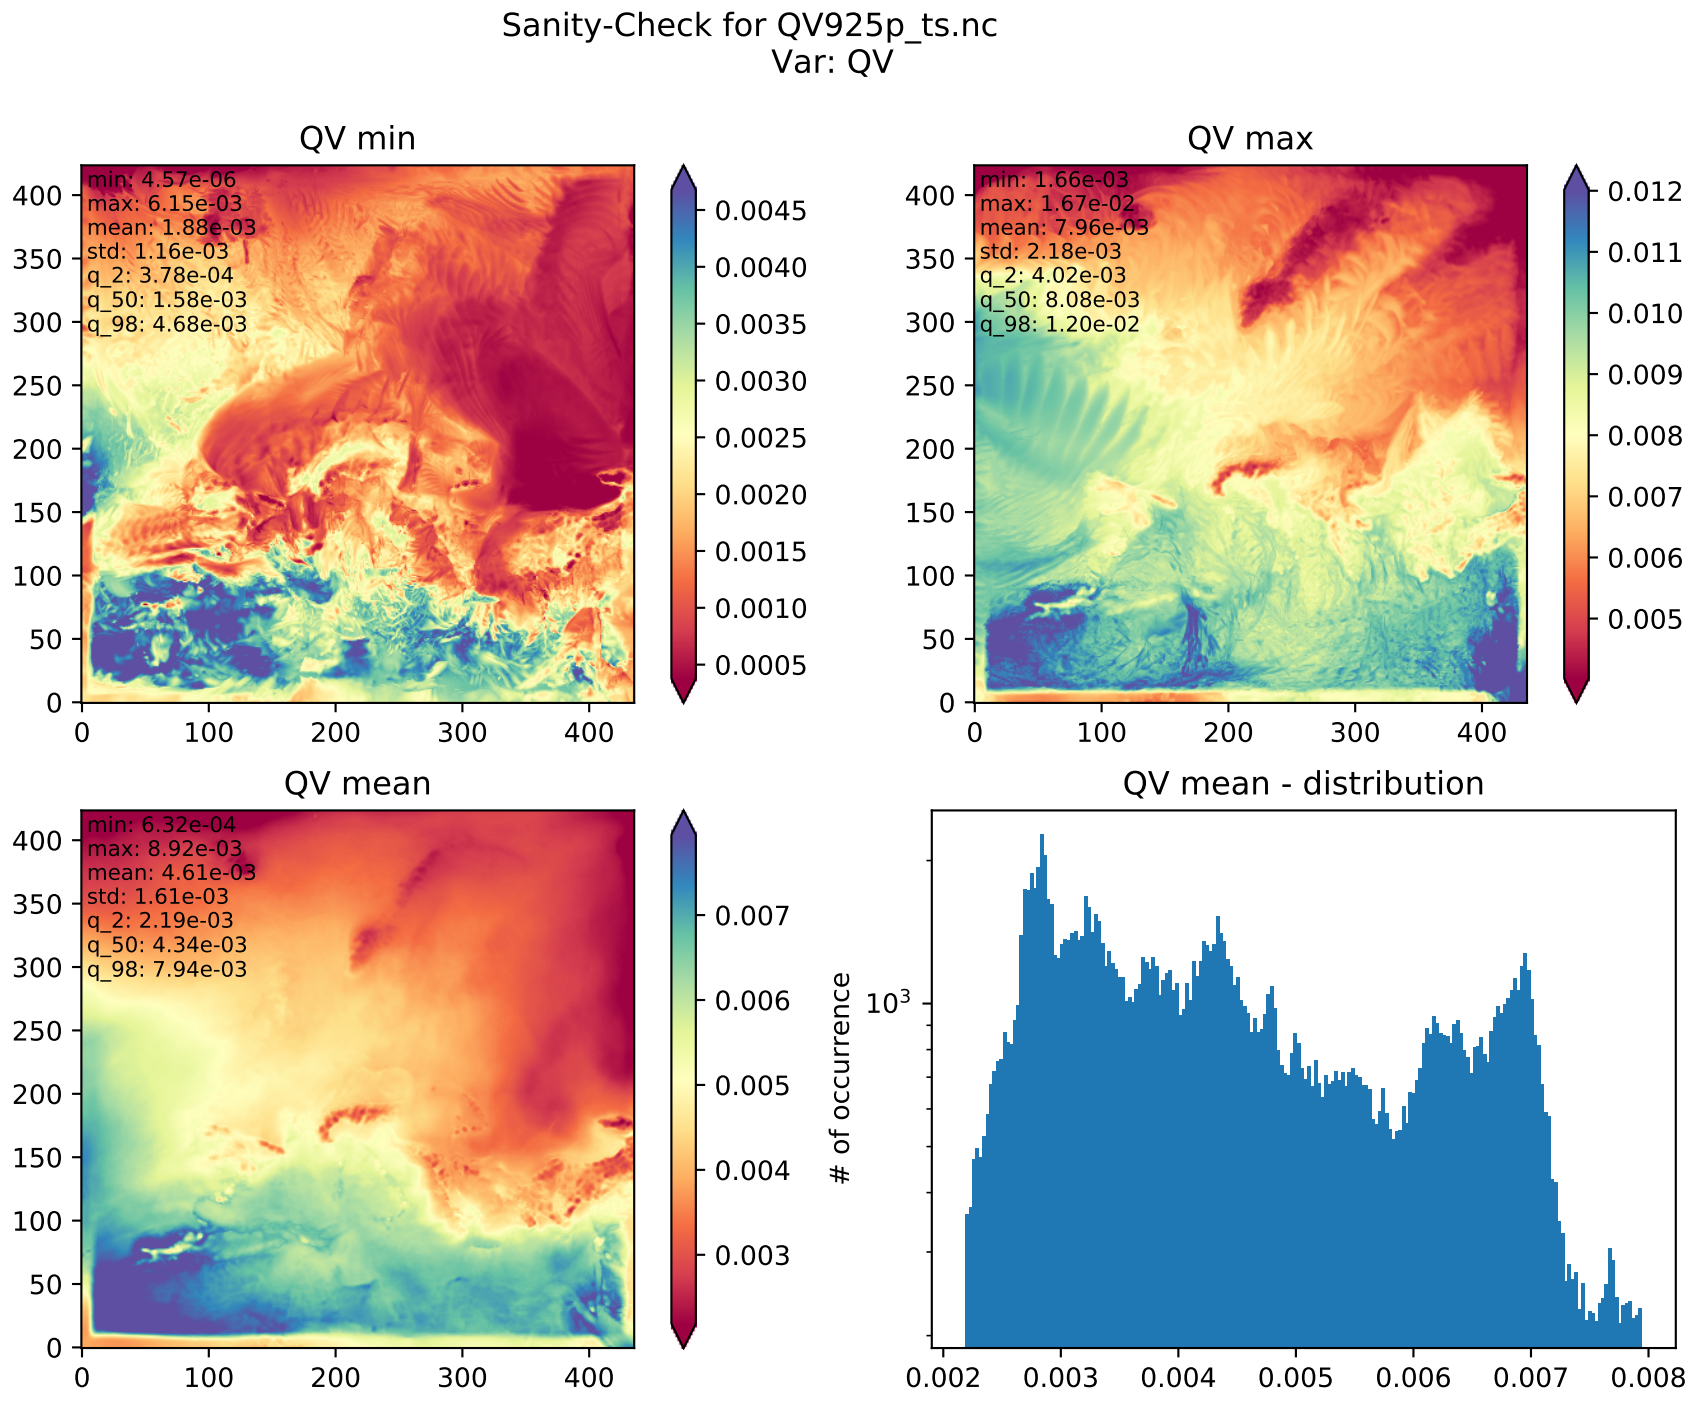
Sanity-Check for QV925p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 4.57e-06
max: 6.15e-03
mean: 1.88e-03
std: 1.16e-03
q_2: 3.78e-04
q_50: 1.58e-03
q_98: 4.68e-03
QV max
min: 1.66e-03
max: 1.67e-02
mean: 7.96e-03
std: 2.18e-03
q_2: 4.02e-03
q_50: 8.08e-03
q_98: 1.20e-02
QV mean
min: 6.32e-04
max: 8.92e-03
mean: 4.61e-03
std: 1.61e-03
q_2: 2.19e-03
q_50: 4.34e-03
q_98: 7.94e-03
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3