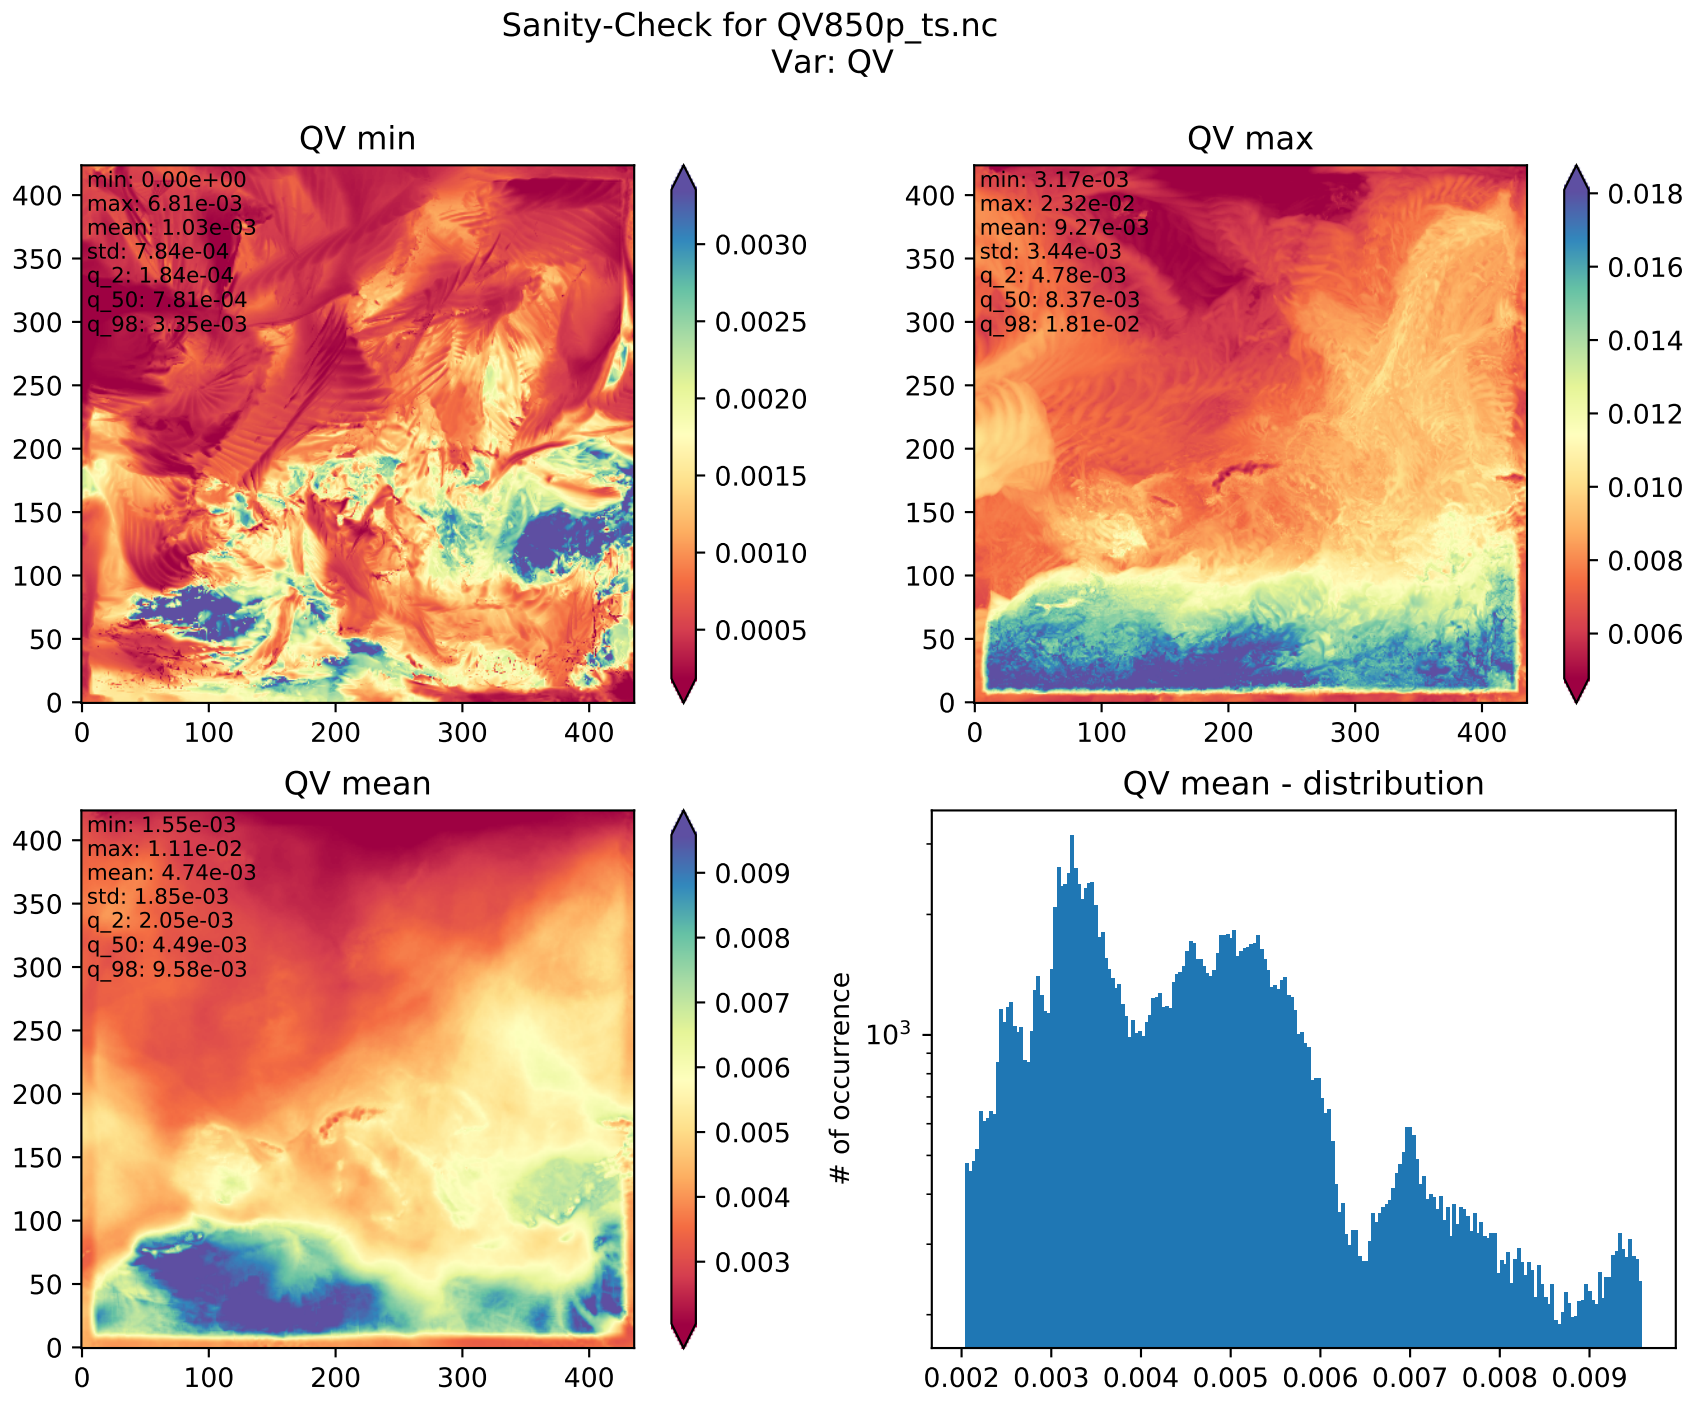
Sanity-Check for QV850p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 0.00e+00
max: 6.81e-03
mean: 1.03e-03
std: 7.84e-04
q_2: 1.84e-04
q_50: 7.81e-04
q_98: 3.35e-03
QV max
min: 3.17e-03
max: 2.32e-02
mean: 9.27e-03
std: 3.44e-03
q_2: 4.78e-03
q_50: 8.37e-03
q_98: 1.81e-02
QV mean
min: 1.55e-03
max: 1.11e-02
mean: 4.74e-03
std: 1.85e-03
q_2: 2.05e-03
q_50: 4.49e-03
q_98: 9.58e-03
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3