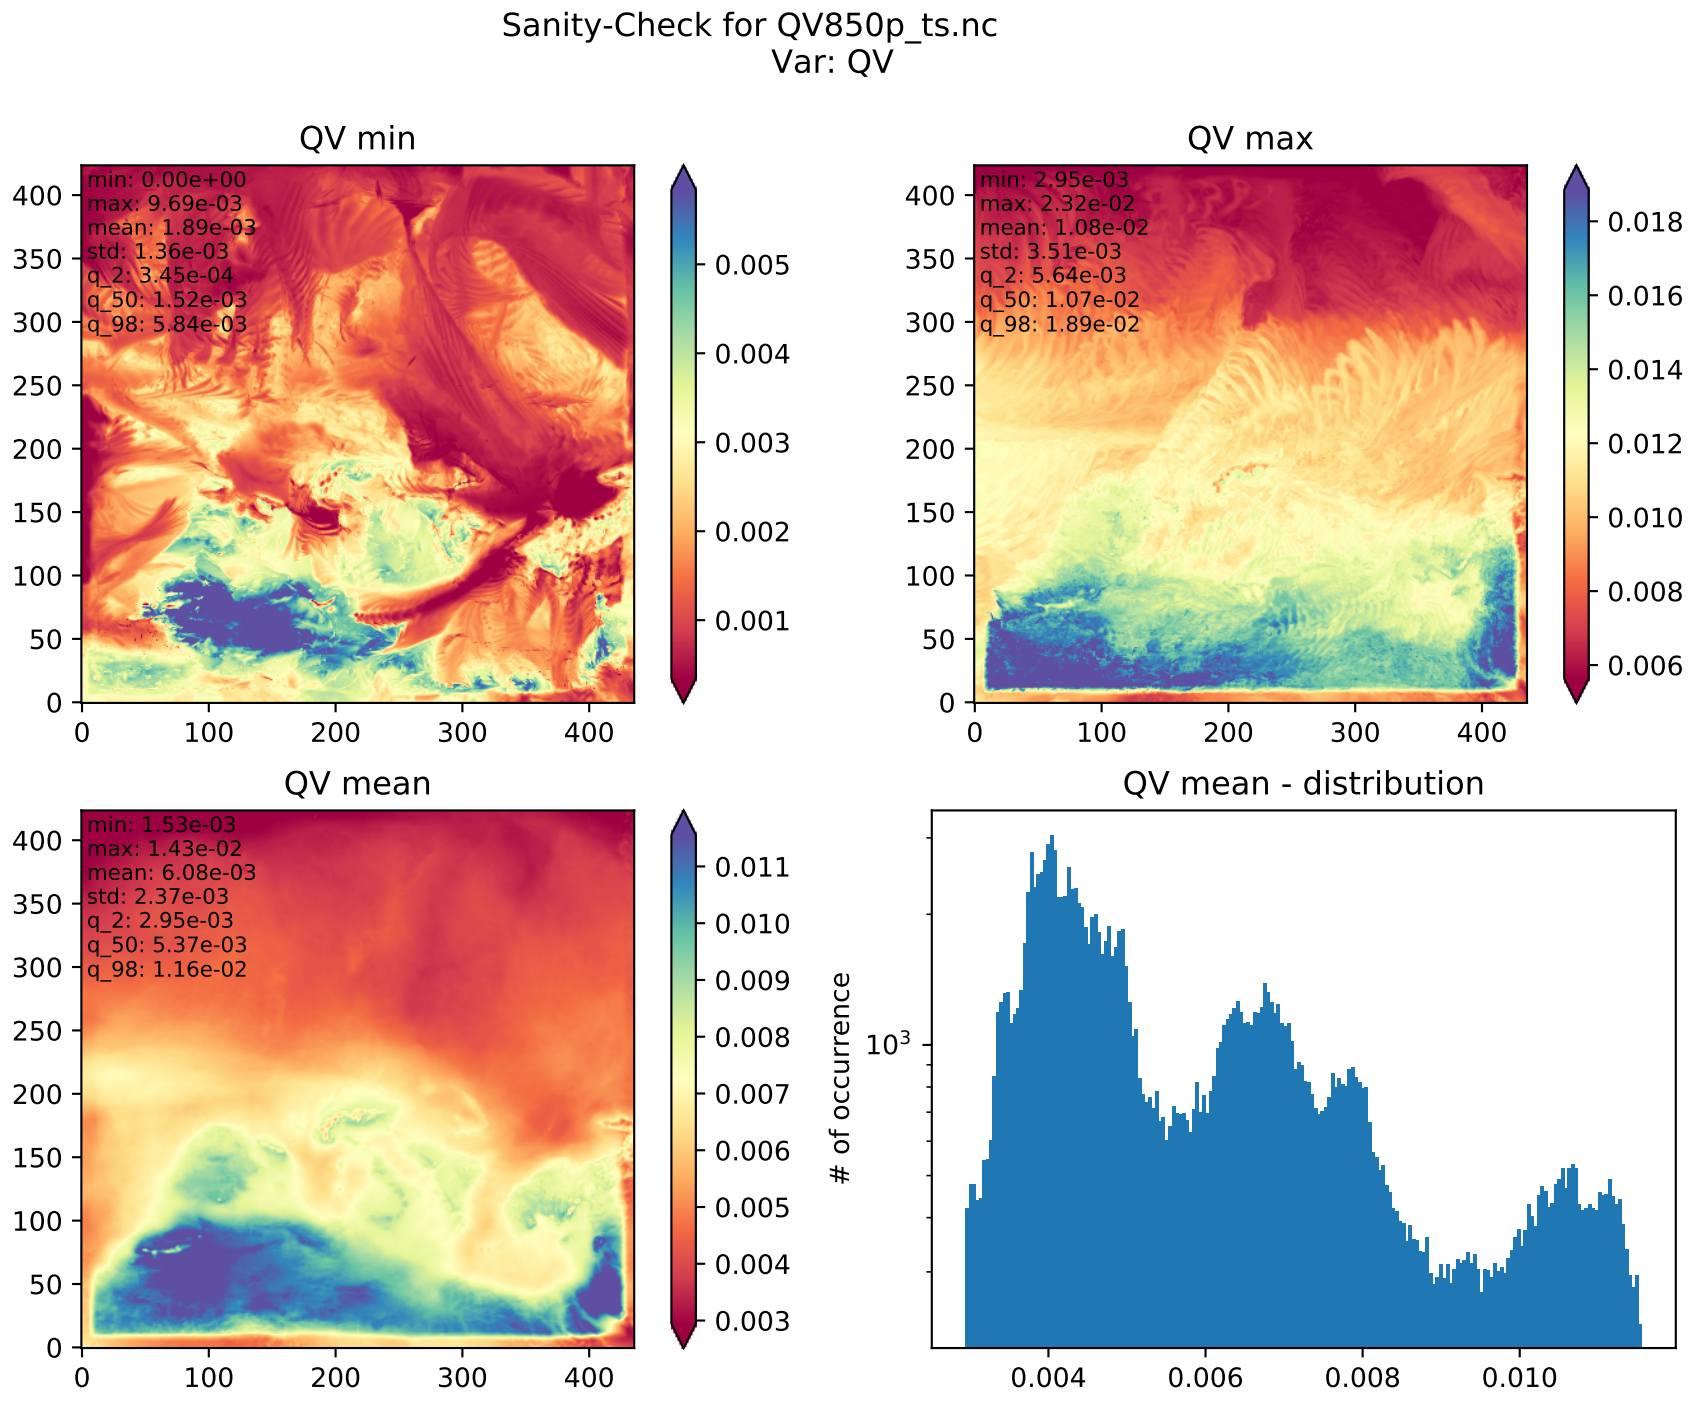
Sanity-Check for QV850p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 0.00e+00
max: 9.69e-03
mean: 1.89e-03
std: 1.36e-03
q_2: 3.45e-04
q_50: 1.52e-03
q_98: 5.84e-03
QV max
min: 2.95e-03
max: 2.32e-02
mean: 1.08e-02
std: 3.51e-03
q_2: 5.64e-03
q_50: 1.07e-02
q_98: 1.89e-02
QV mean
min: 1.53e-03
max: 1.43e-02
mean: 6.08e-03
std: 2.37e-03
q_2: 2.95e-03
q_50: 5.37e-03
q_98: 1.16e-02
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3