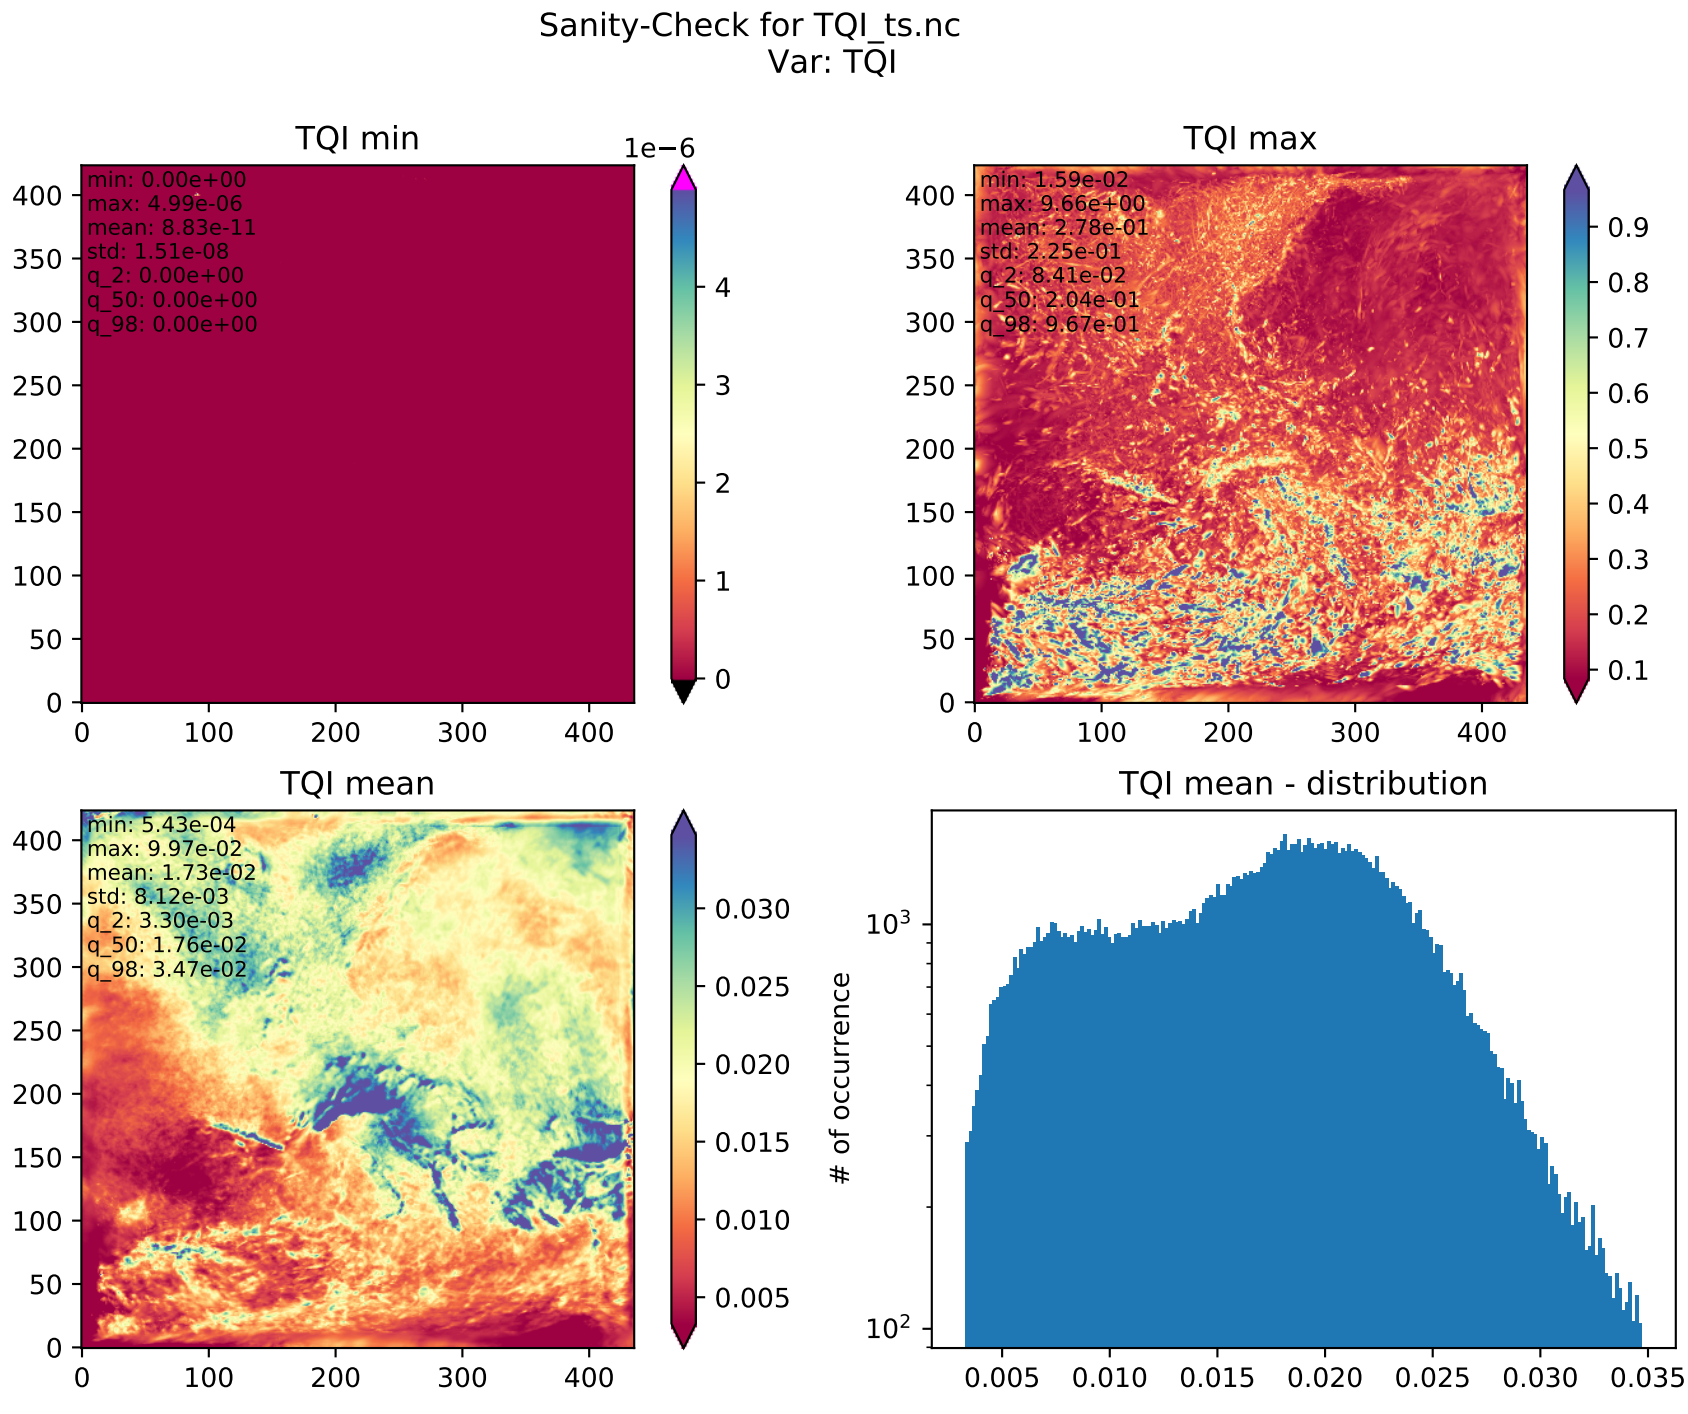
Sanity-Check for TQI_ts.nc
Var: TQI
TQI min
min: 0.00e+00
max: 4.99e-06
mean: 8.83e-11
std: 1.51e-08
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−6
TQI max
min: 1.59e-02
max: 9.66e+00
mean: 2.78e-01
std: 2.25e-01
q_2: 8.41e-02
q_50: 2.04e-01
q_98: 9.67e-01
TQI mean
min: 5.43e-04
max: 9.97e-02
mean: 1.73e-02
std: 8.12e-03
q_2: 3.30e-03
q_50: 1.76e-02
q_98: 3.47e-02
TQI mean - distribution
# of occurrence