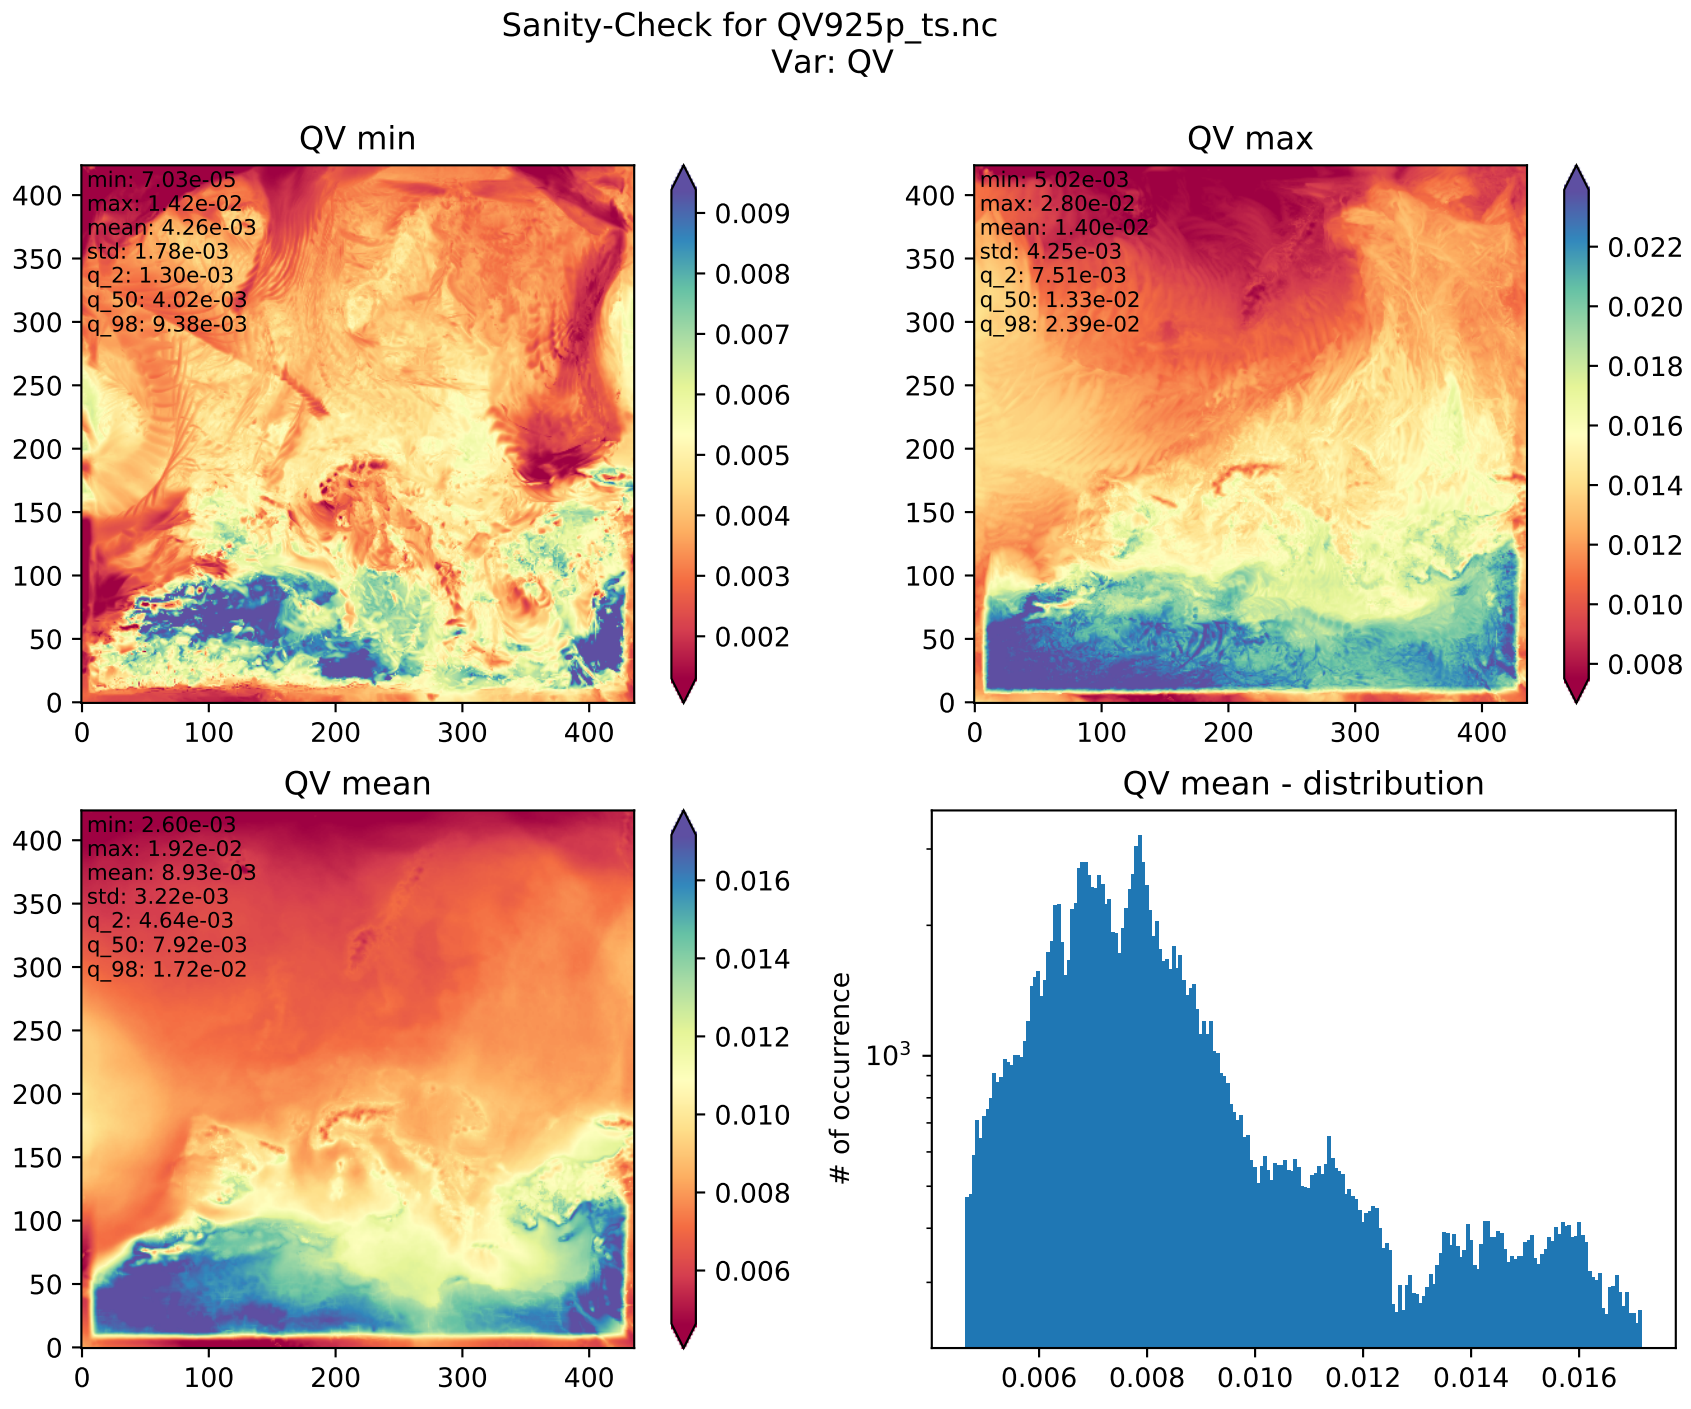
Sanity-Check for QV925p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 7.03e-05
max: 1.42e-02
mean: 4.26e-03
std: 1.78e-03
q_2: 1.30e-03
q_50: 4.02e-03
q_98: 9.38e-03
QV max
min: 5.02e-03
max: 2.80e-02
mean: 1.40e-02
std: 4.25e-03
q_2: 7.51e-03
q_50: 1.33e-02
q_98: 2.39e-02
QV mean
min: 2.60e-03
max: 1.92e-02
mean: 8.93e-03
std: 3.22e-03
q_2: 4.64e-03
q_50: 7.92e-03
q_98: 1.72e-02
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3