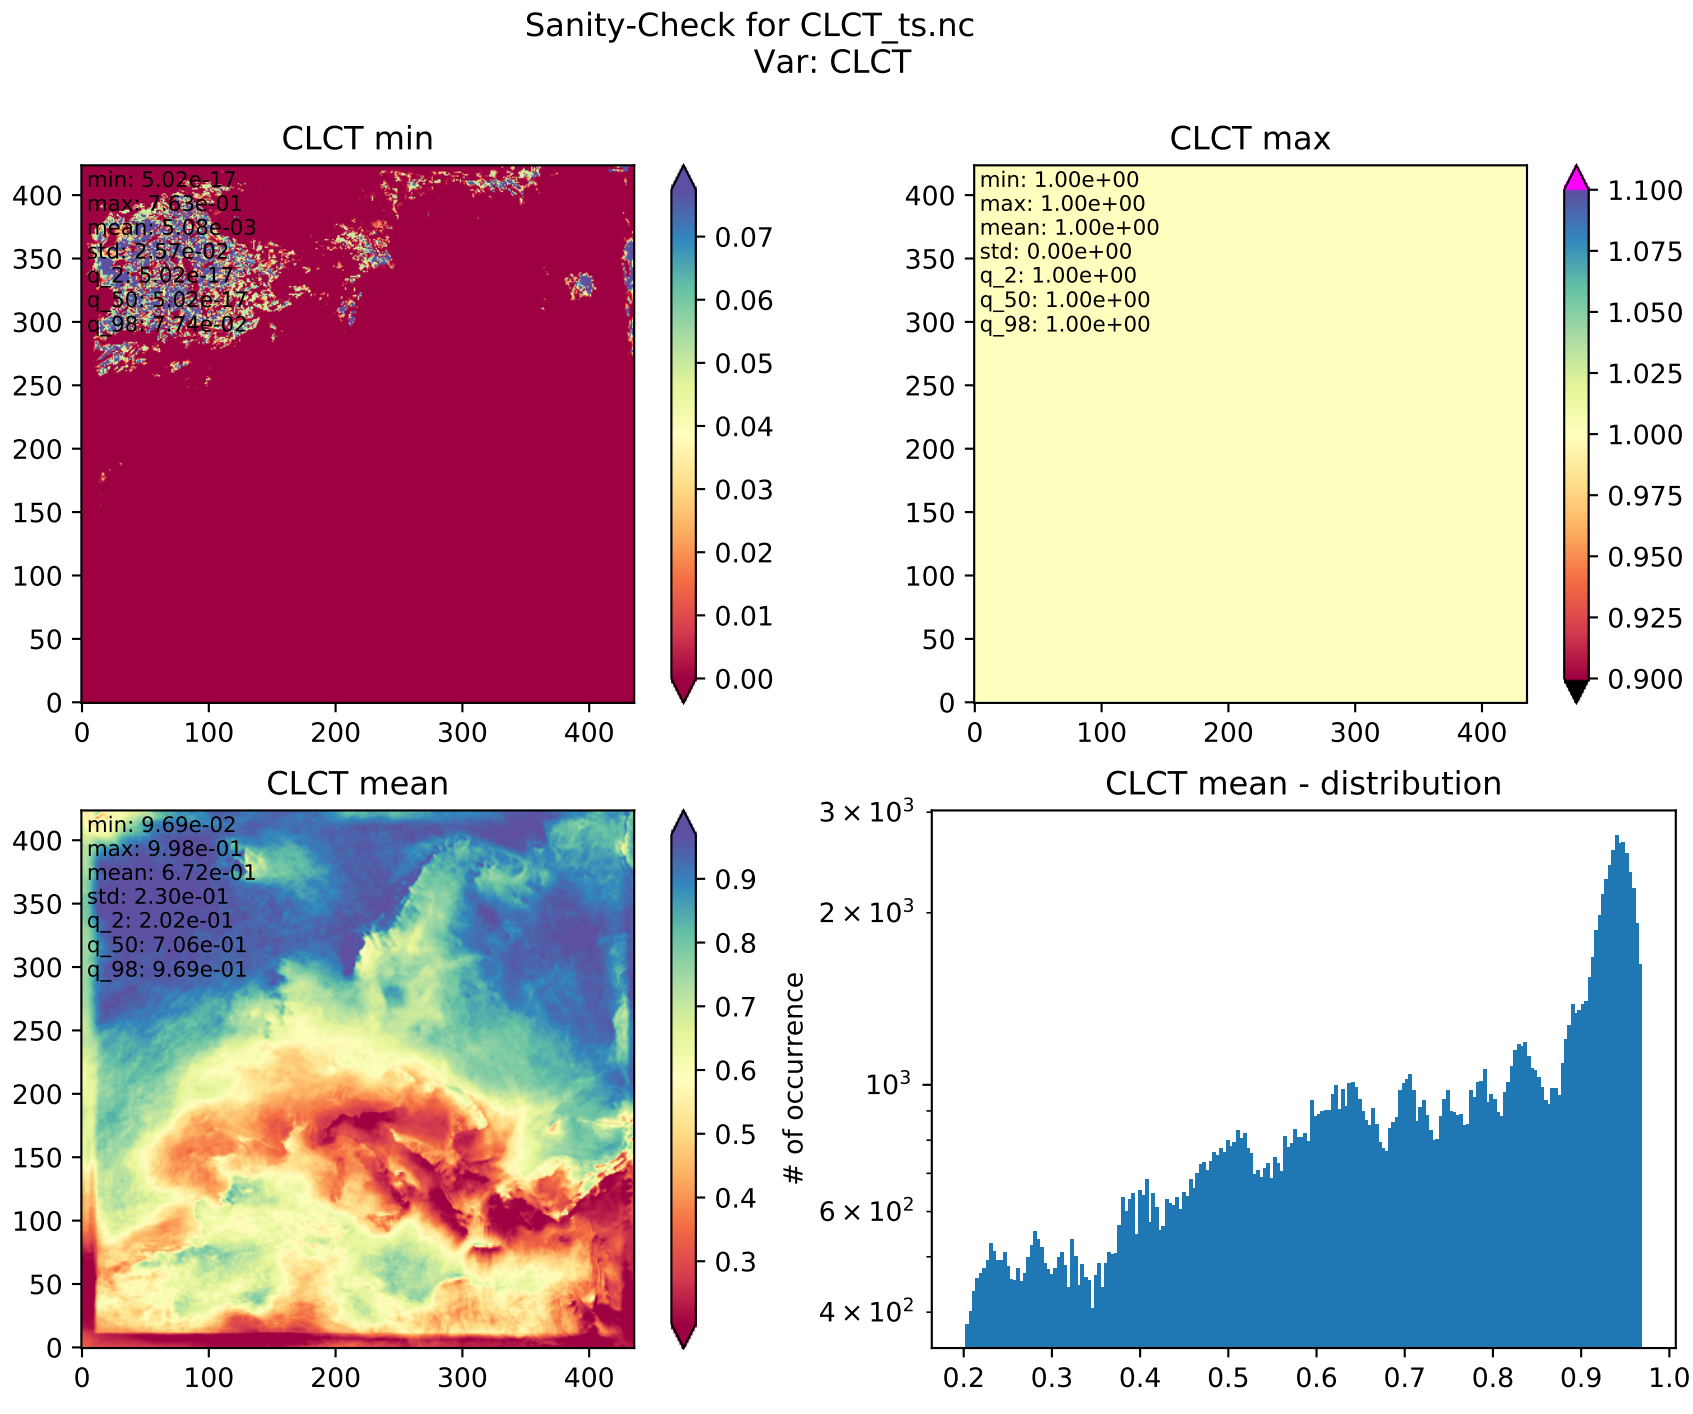
Sanity-Check for CLCT_ts.nc
Var: CLCT
CLCT min
min: 5.02e-17
max: 7.63e-01
mean: 5.08e-03
std: 2.57e-02
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 7.74e-02
CLCT max
min: 1.00e+00
max: 1.00e+00
mean: 1.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 1.00e+00
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCT mean
min: 9.69e-02
max: 9.98e-01
mean: 6.72e-01
std: 2.30e-01
q_2: 2.02e-01
q_50: 7.06e-01
q_98: 9.69e-01
CLCT mean - distribution
# of occurrence