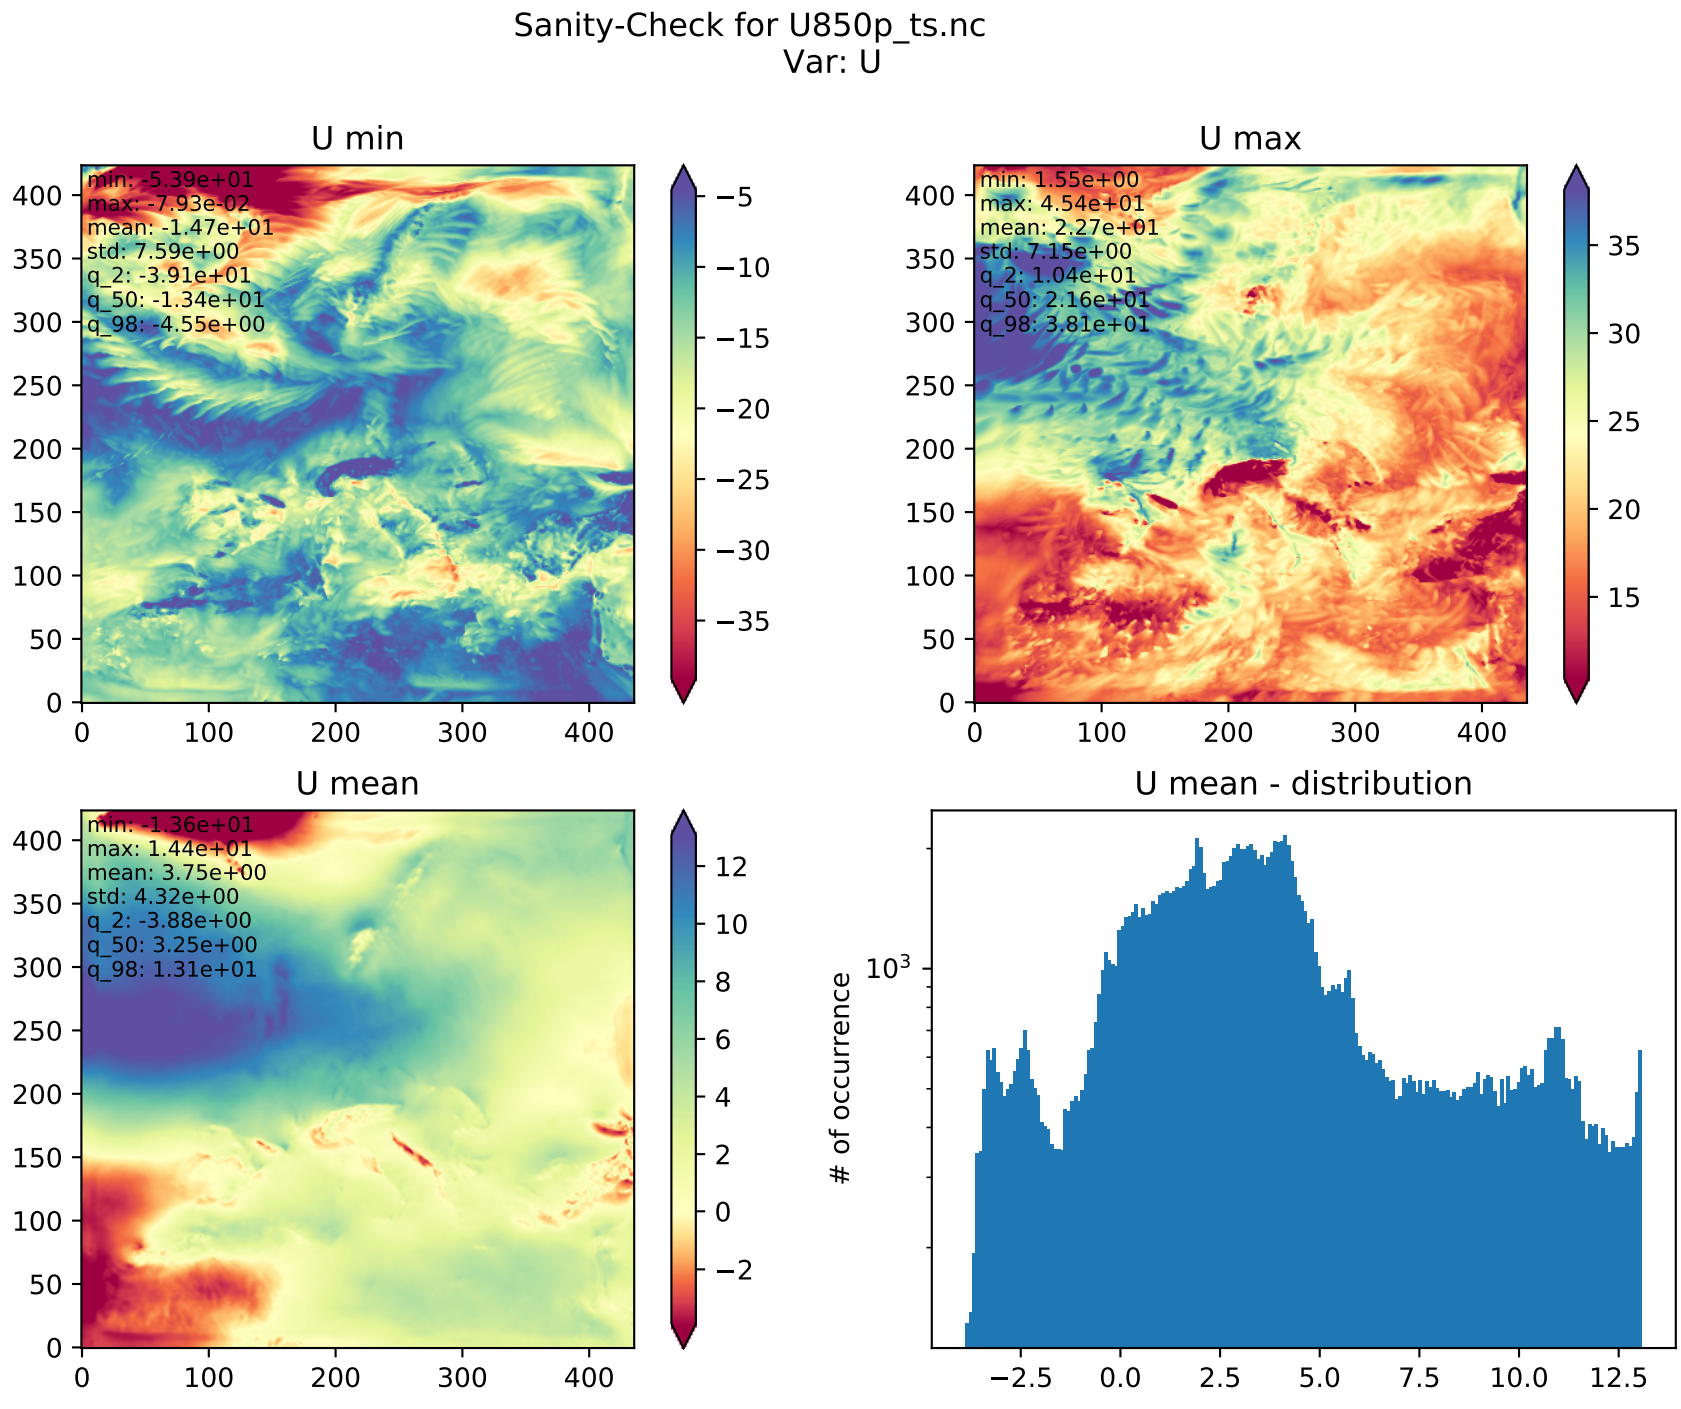
Sanity-Check for U850p_ts.nc
Var: U
U min
min: -5.39e+01
max: -7.93e-02
mean: -1.47e+01
std: 7.59e+00
q_2: -3.91e+01
q_50: -1.34e+01
q_98: -4.55e+00
U max
min: 1.55e+00
max: 4.54e+01
mean: 2.27e+01
std: 7.15e+00
q_2: 1.04e+01
q_50: 2.16e+01
q_98: 3.81e+01
U mean
min: -1.36e+01
max: 1.44e+01
mean: 3.75e+00
std: 4.32e+00
q_2: -3.88e+00
q_50: 3.25e+00
q_98: 1.31e+01
U mean - distribution
# of occurrence
10^3