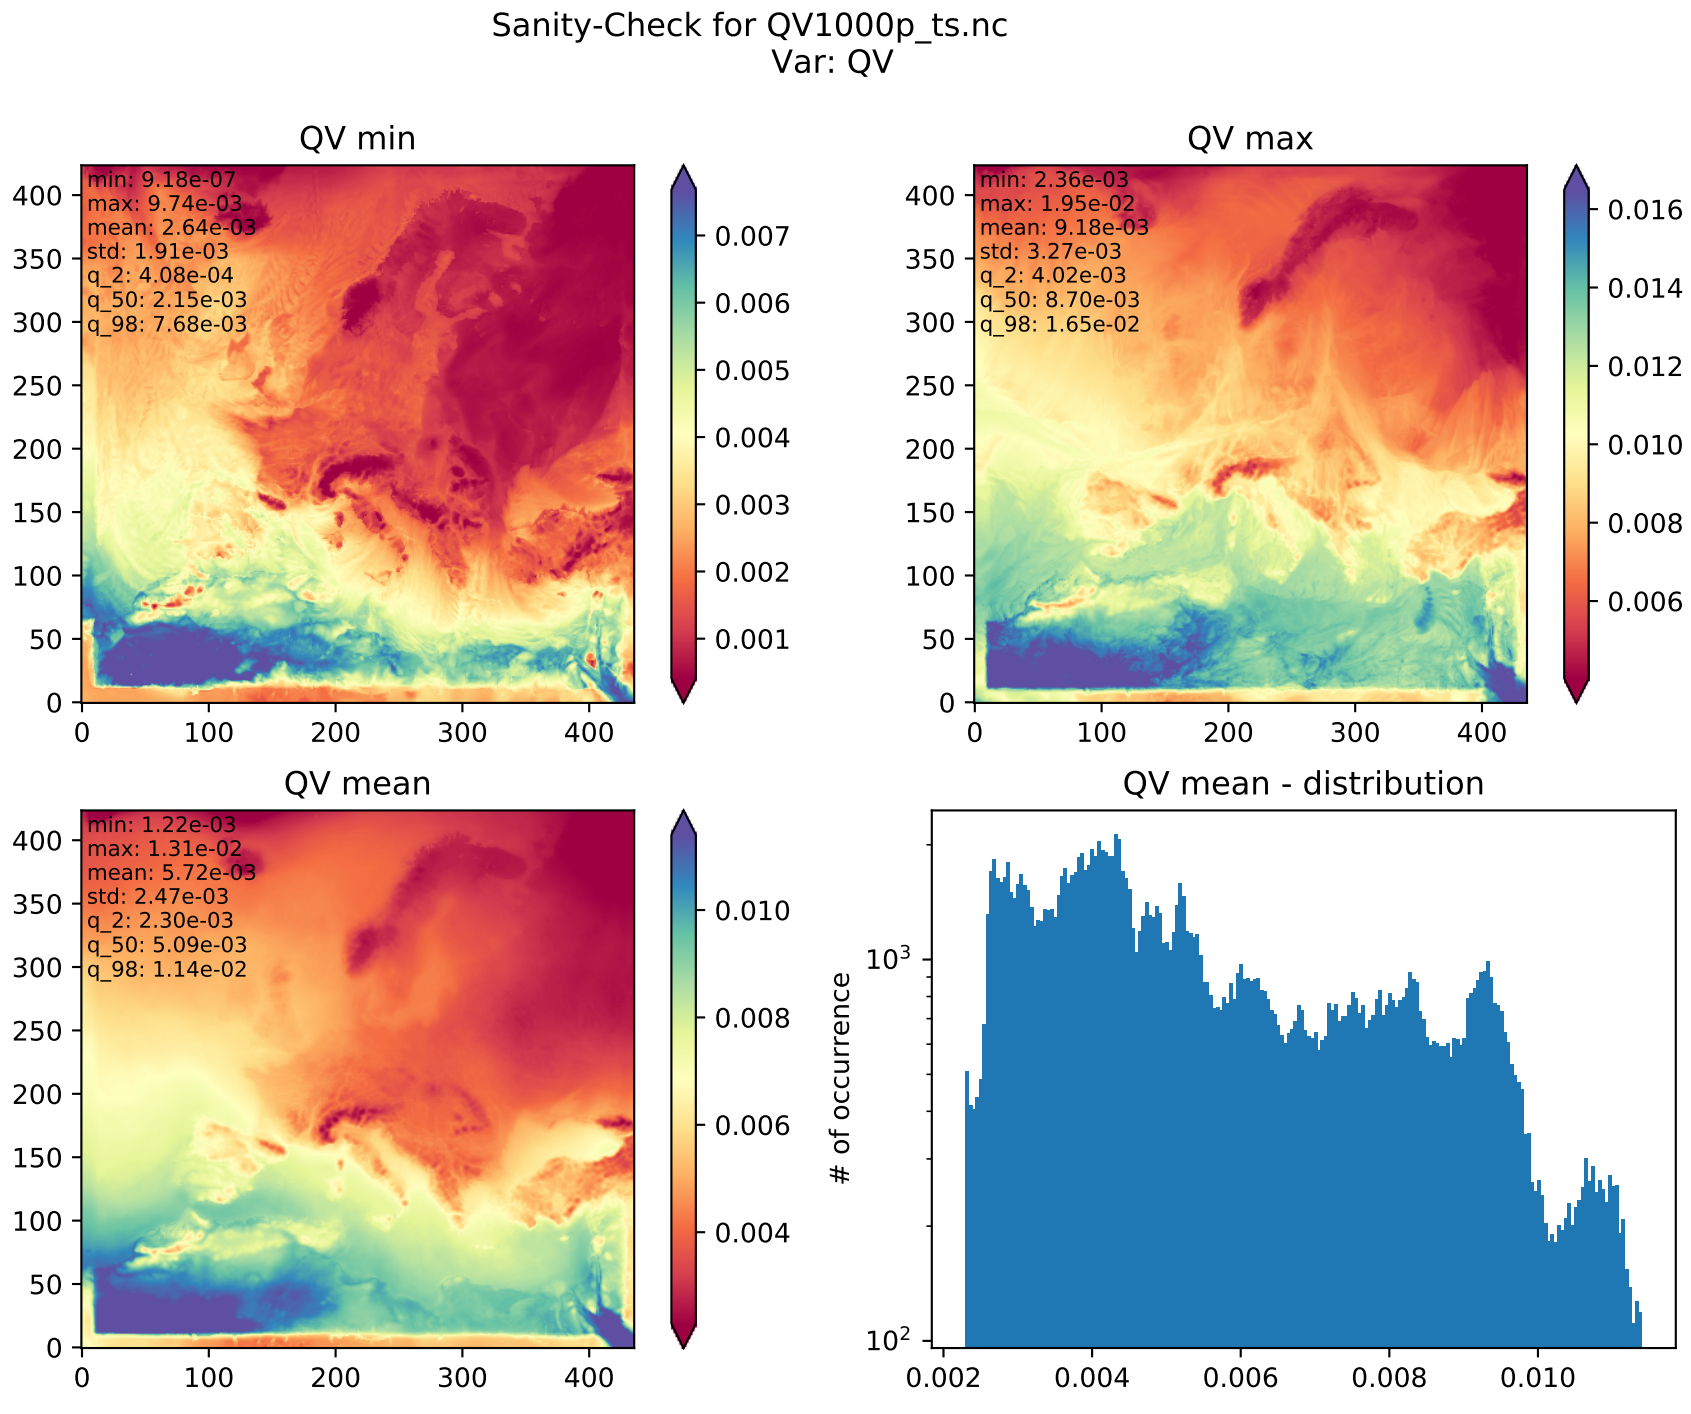
Sanity-Check for QV1000p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 9.18e-07
max: 9.74e-03
mean: 2.64e-03
std: 1.91e-03
q_2: 4.08e-04
q_50: 2.15e-03
q_98: 7.68e-03
QV max
min: 2.36e-03
max: 1.95e-02
mean: 9.18e-03
std: 3.27e-03
q_2: 4.02e-03
q_50: 8.70e-03
q_98: 1.65e-02
QV mean
min: 1.22e-03
max: 1.31e-02
mean: 5.72e-03
std: 2.47e-03
q_2: 2.30e-03
q_50: 5.09e-03
q_98: 1.14e-02
QV mean - distribution
# of occurrence