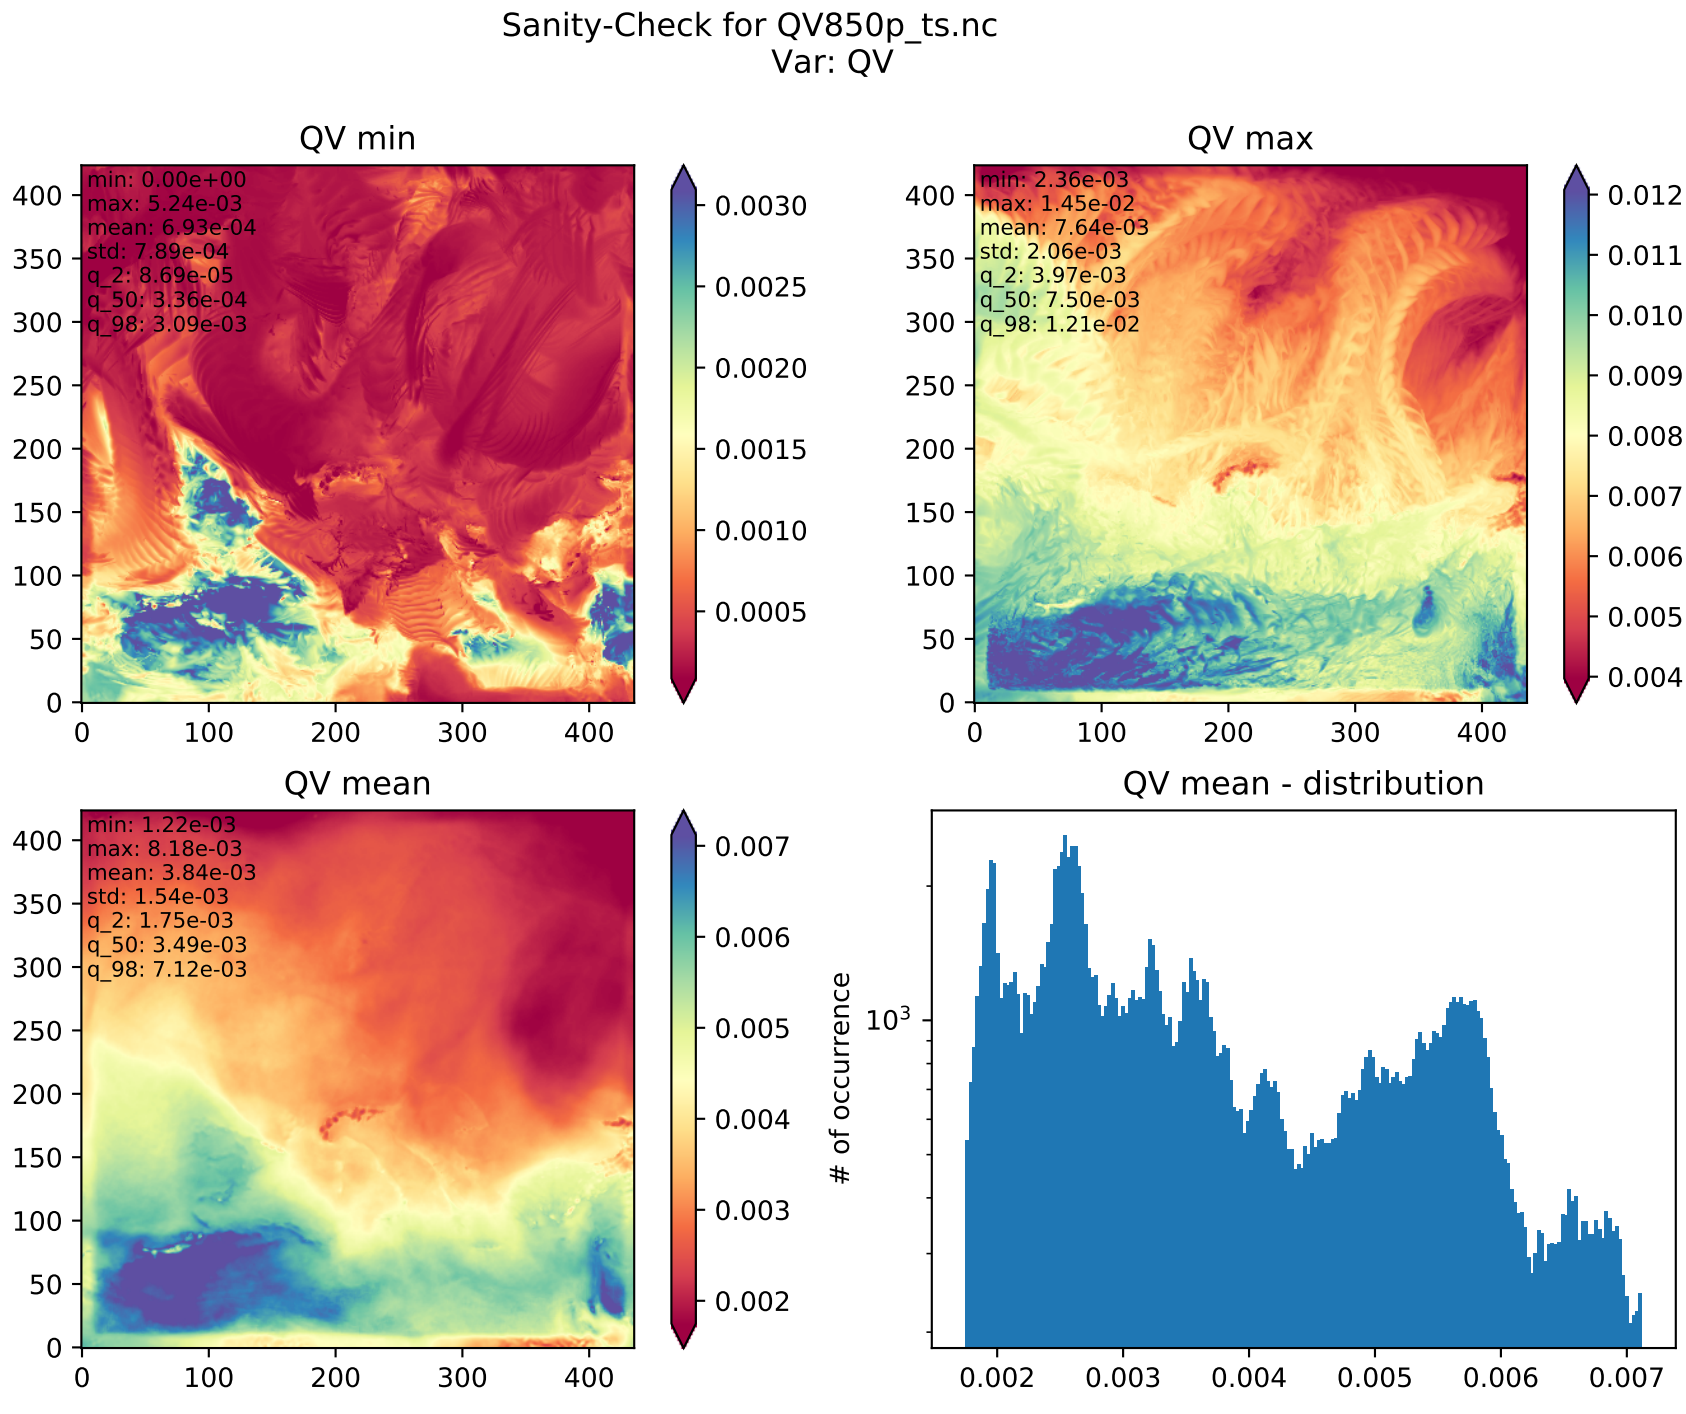
Sanity-Check for QV850p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 0.00e+00
max: 5.24e-03
mean: 6.93e-04
std: 7.89e-04
q_2: 8.69e-05
q_50: 3.36e-04
q_98: 3.09e-03
QV max
min: 2.36e-03
max: 1.45e-02
mean: 7.64e-03
std: 2.06e-03
q_2: 3.97e-03
q_50: 7.50e-03
q_98: 1.21e-02
QV mean
min: 1.22e-03
max: 8.18e-03
mean: 3.84e-03
std: 1.54e-03
q_2: 1.75e-03
q_50: 3.49e-03
q_98: 7.12e-03
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3