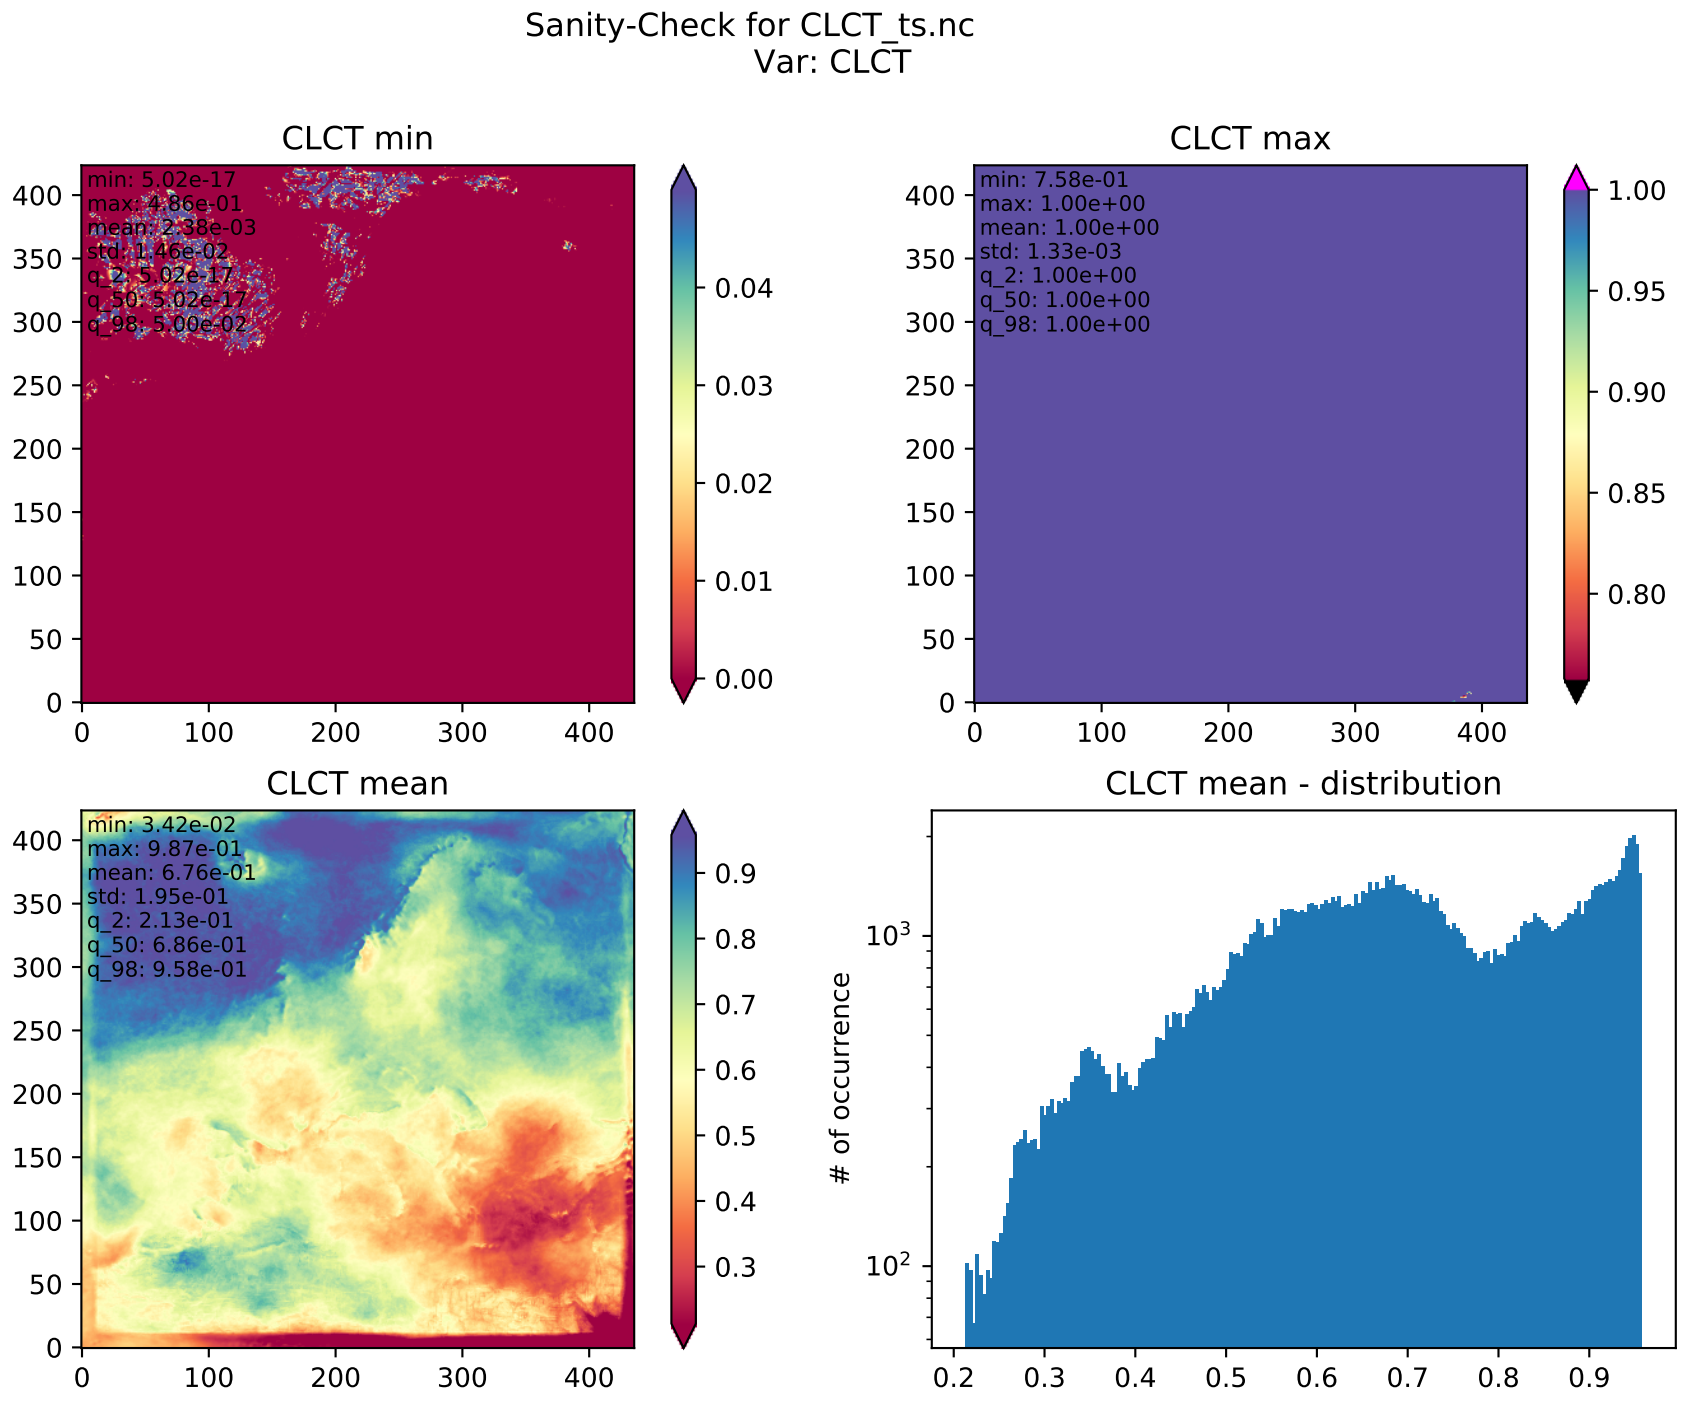
Sanity-Check for CLCT_ts.nc
Var: CLCT
CLCT min
min: 5.02e-17
max: 4.86e-01
mean: 2.38e-03
std: 1.46e-02
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 5.00e-02
CLCT max
min: 7.58e-01
max: 1.00e+00
mean: 1.00e+00
std: 1.33e-03
q_2: 1.00e+00
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCT mean
min: 3.42e-02
max: 9.87e-01
mean: 6.76e-01
std: 1.95e-01
q_2: 2.13e-01
q_50: 6.86e-01
q_98: 9.58e-01
CLCT mean - distribution
# of occurrence