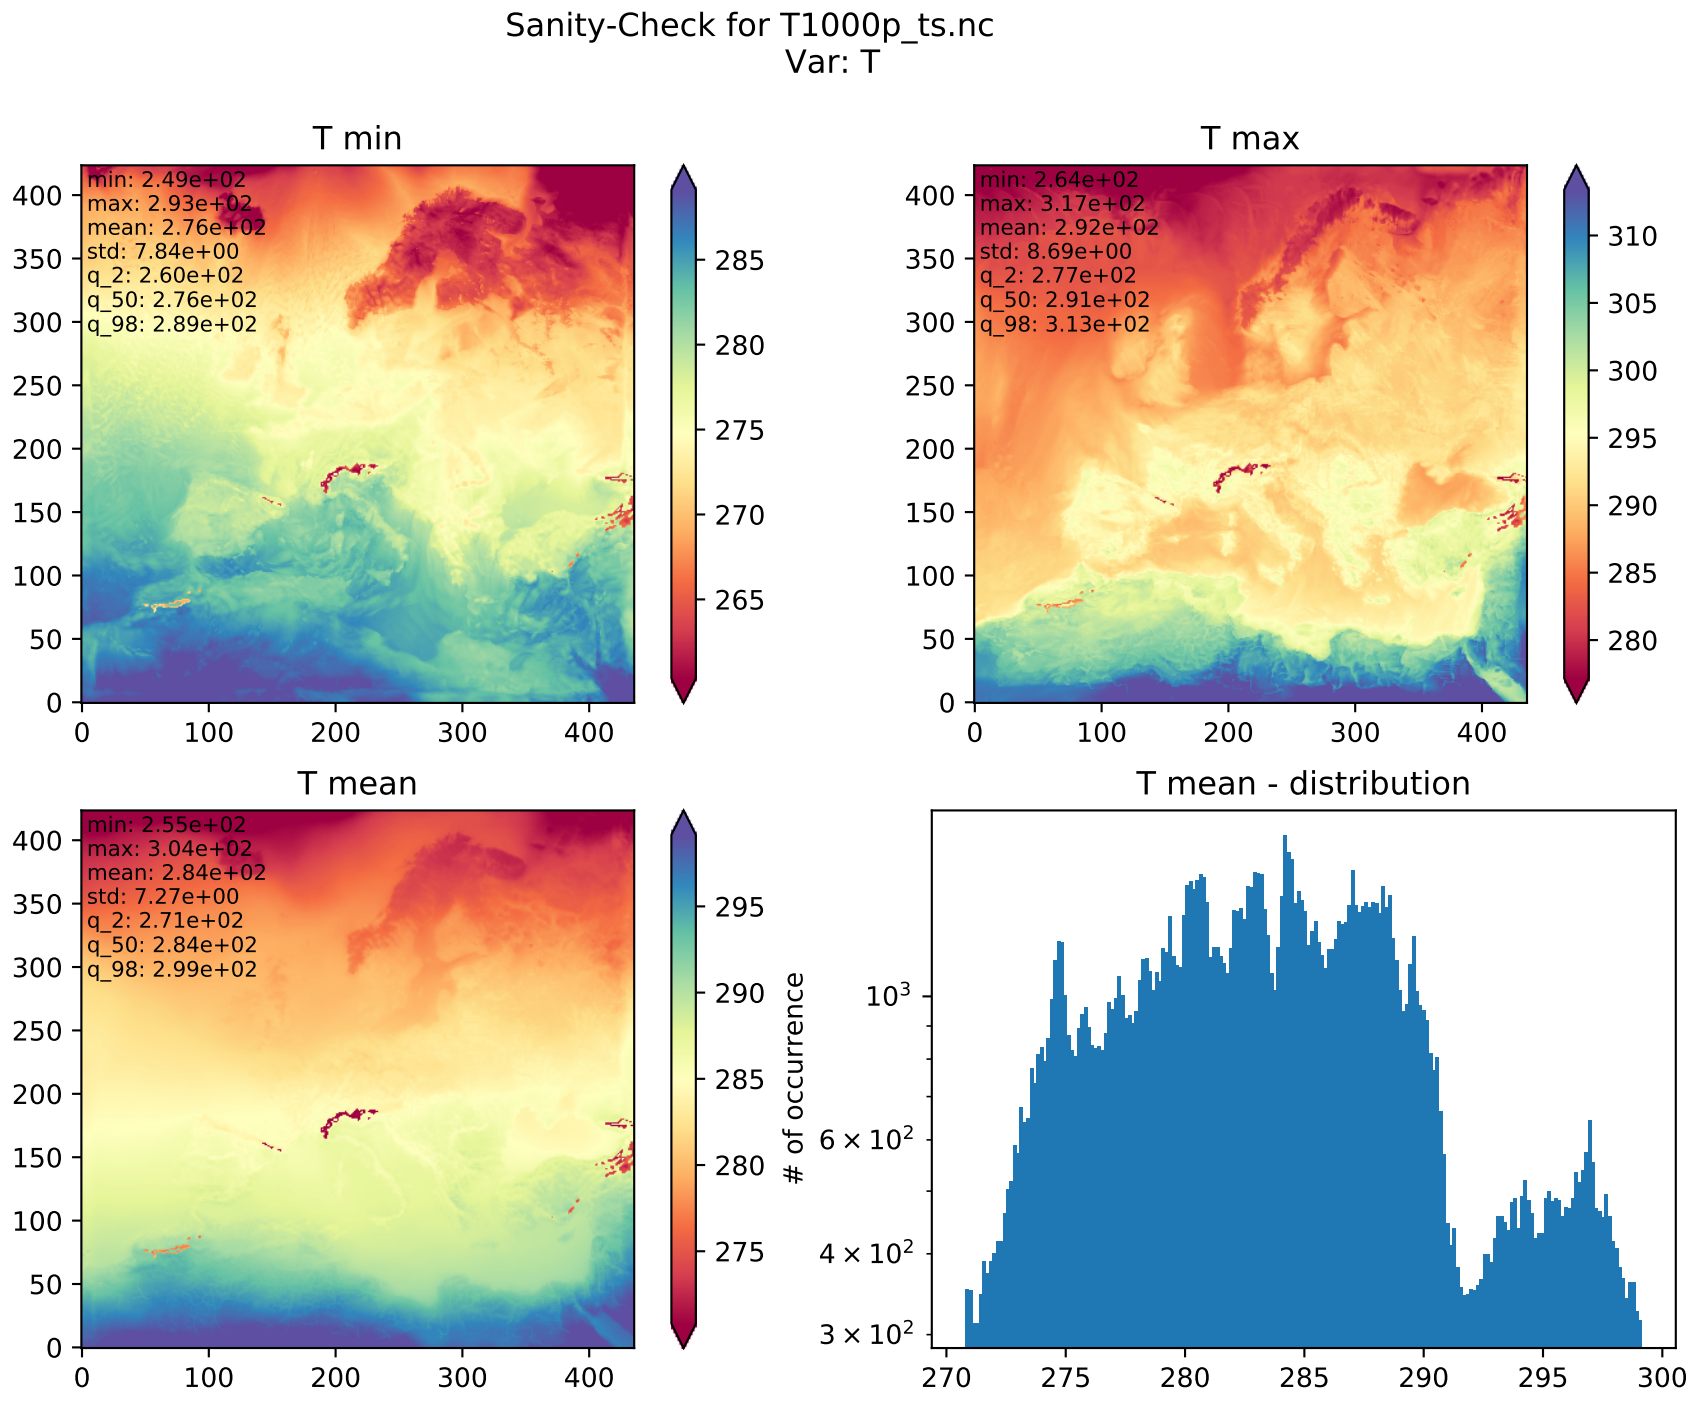
Sanity-Check for T1000p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.49e+02
max: 2.93e+02
mean: 2.76e+02
std: 7.84e+00
q_2: 2.60e+02
q_50: 2.76e+02
q_98: 2.89e+02
T max
min: 2.64e+02
max: 3.17e+02
mean: 2.92e+02
std: 8.69e+00
q_2: 2.77e+02
q_50: 2.91e+02
q_98: 3.13e+02
T mean
min: 2.55e+02
max: 3.04e+02
mean: 2.84e+02
std: 7.27e+00
q_2: 2.71e+02
q_50: 2.84e+02
q_98: 2.99e+02
T mean - distribution
# of occurrence