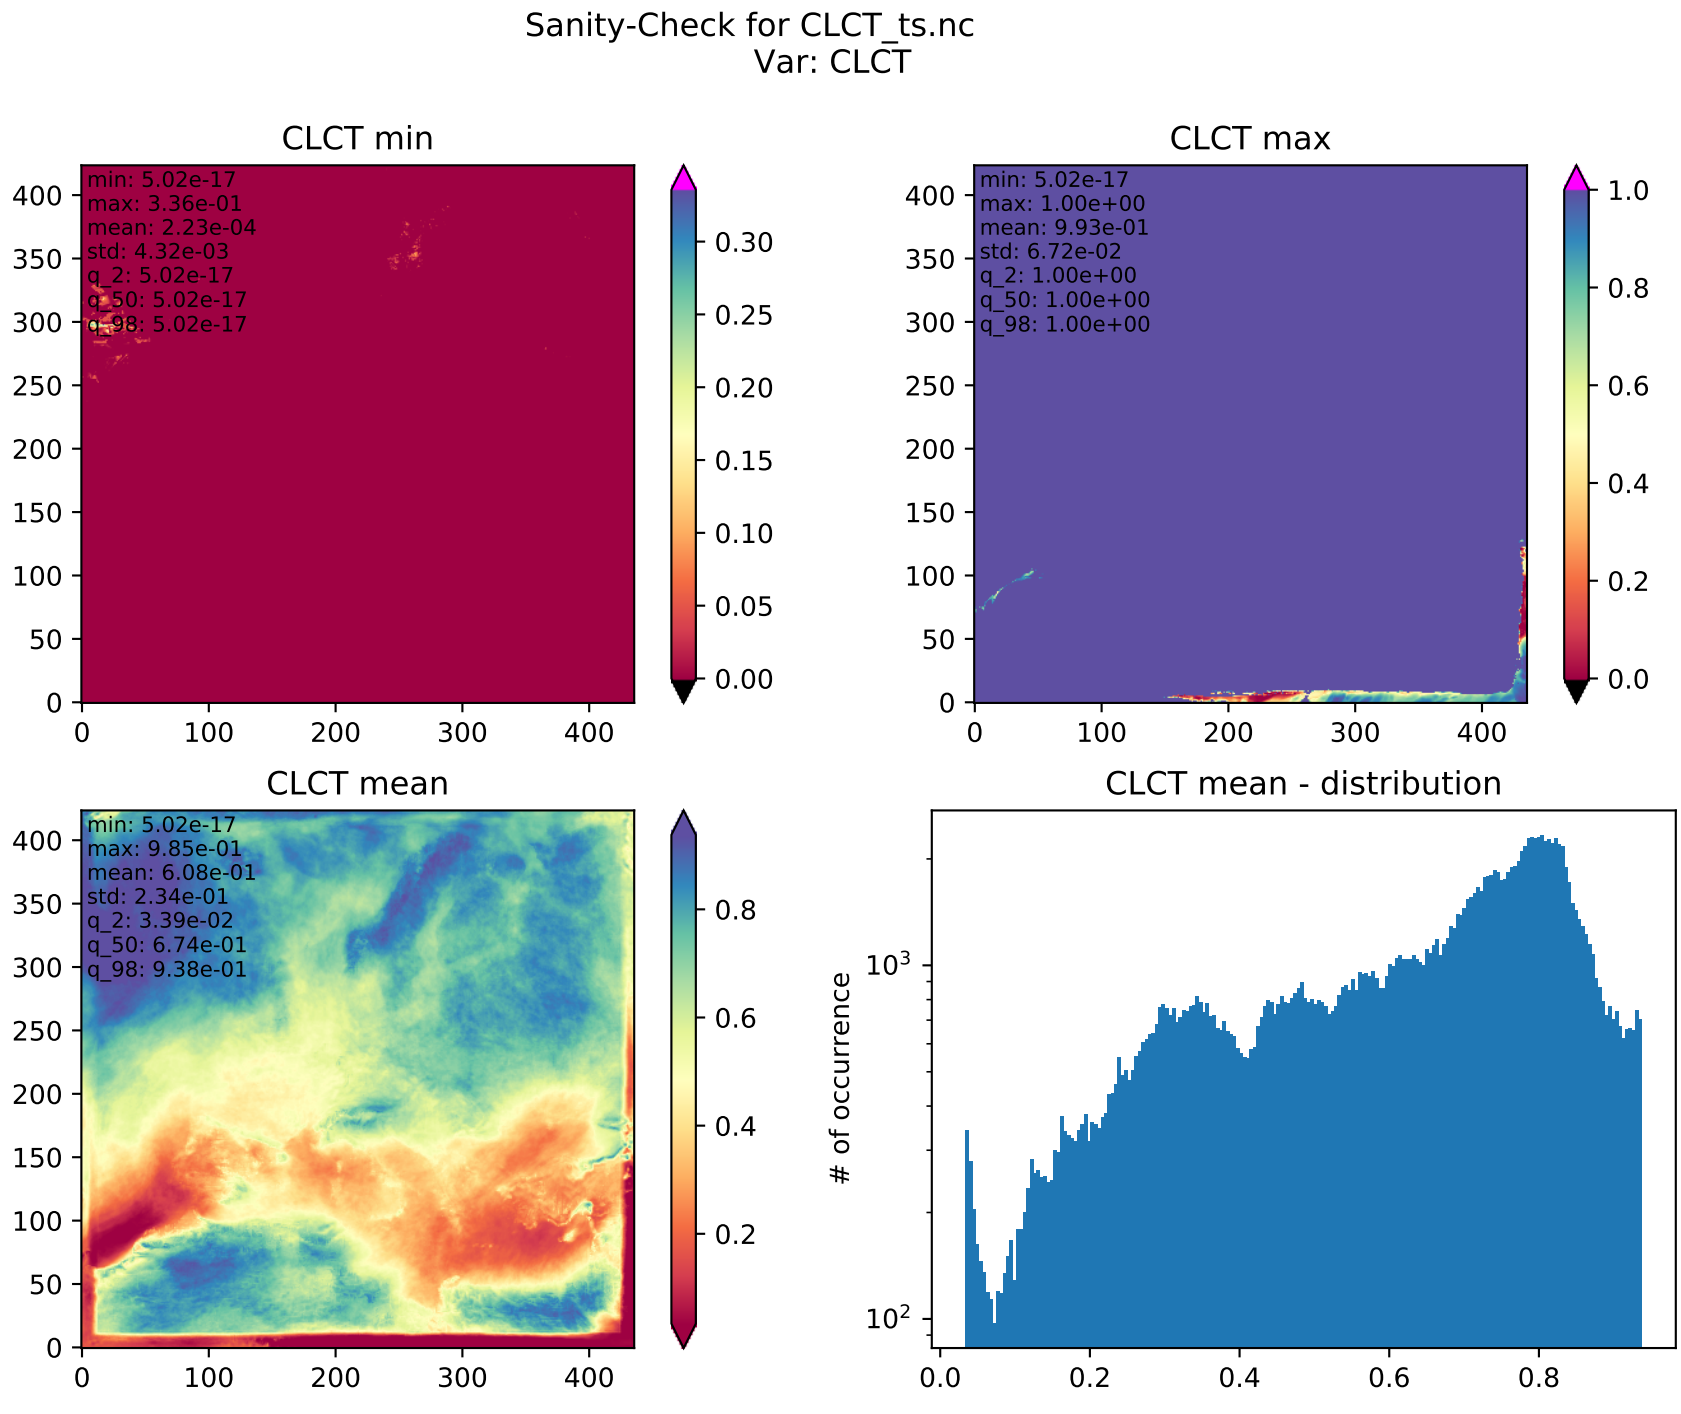
Sanity-Check for CLCT_ts.nc
Var: CLCT
CLCT min
min: 5.02e-17
max: 3.36e-01
mean: 2.23e-04
std: 4.32e-03
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 5.02e-17
CLCT max
min: 5.02e-17
max: 1.00e+00
mean: 9.93e-01
std: 6.72e-02
q_2: 1.00e+00
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCT mean
min: 5.02e-17
max: 9.85e-01
mean: 6.08e-01
std: 2.34e-01
q_2: 3.39e-02
q_50: 6.74e-01
q_98: 9.38e-01
CLCT mean - distribution
# of occurrence