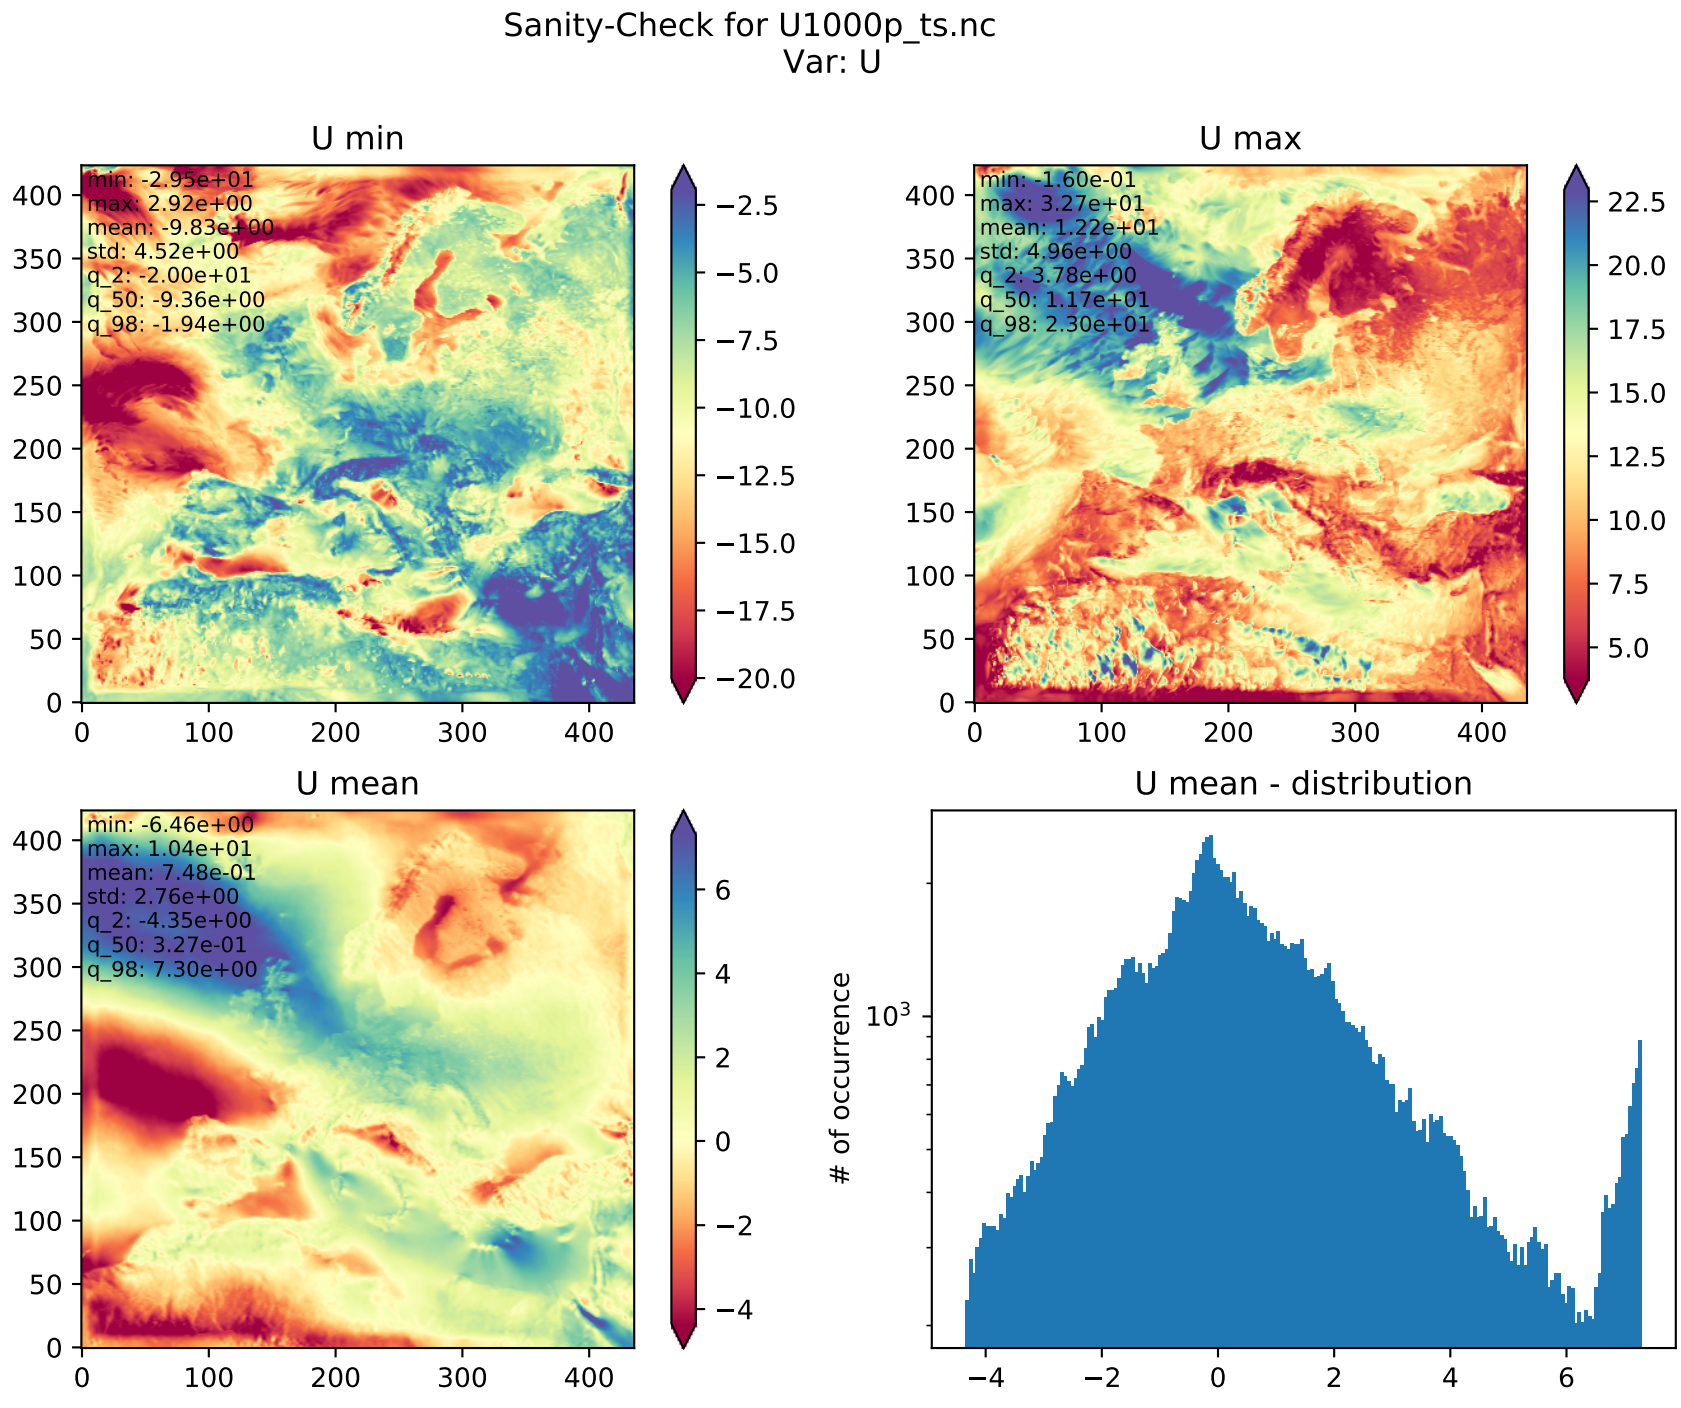
Sanity-Check for U1000p_ts.nc
Var: U
U min
min: -2.95e+01
max: 2.92e+00
mean: -9.83e+00
std: 4.52e+00
q_2: -2.00e+01
q_50: -9.36e+00
q_98: -1.94e+00
U max
min: -1.60e-01
max: 3.27e+01
mean: 1.22e+01
std: 4.96e+00
q_2: 3.78e+00
q_50: 1.17e+01
q_98: 2.30e+01
U mean
min: -6.46e+00
max: 1.04e+01
mean: 7.48e-01
std: 2.76e+00
q_2: -4.35e+00
q_50: 3.27e-01
q_98: 7.30e+00
U mean - distribution
# of occurrence
10^3