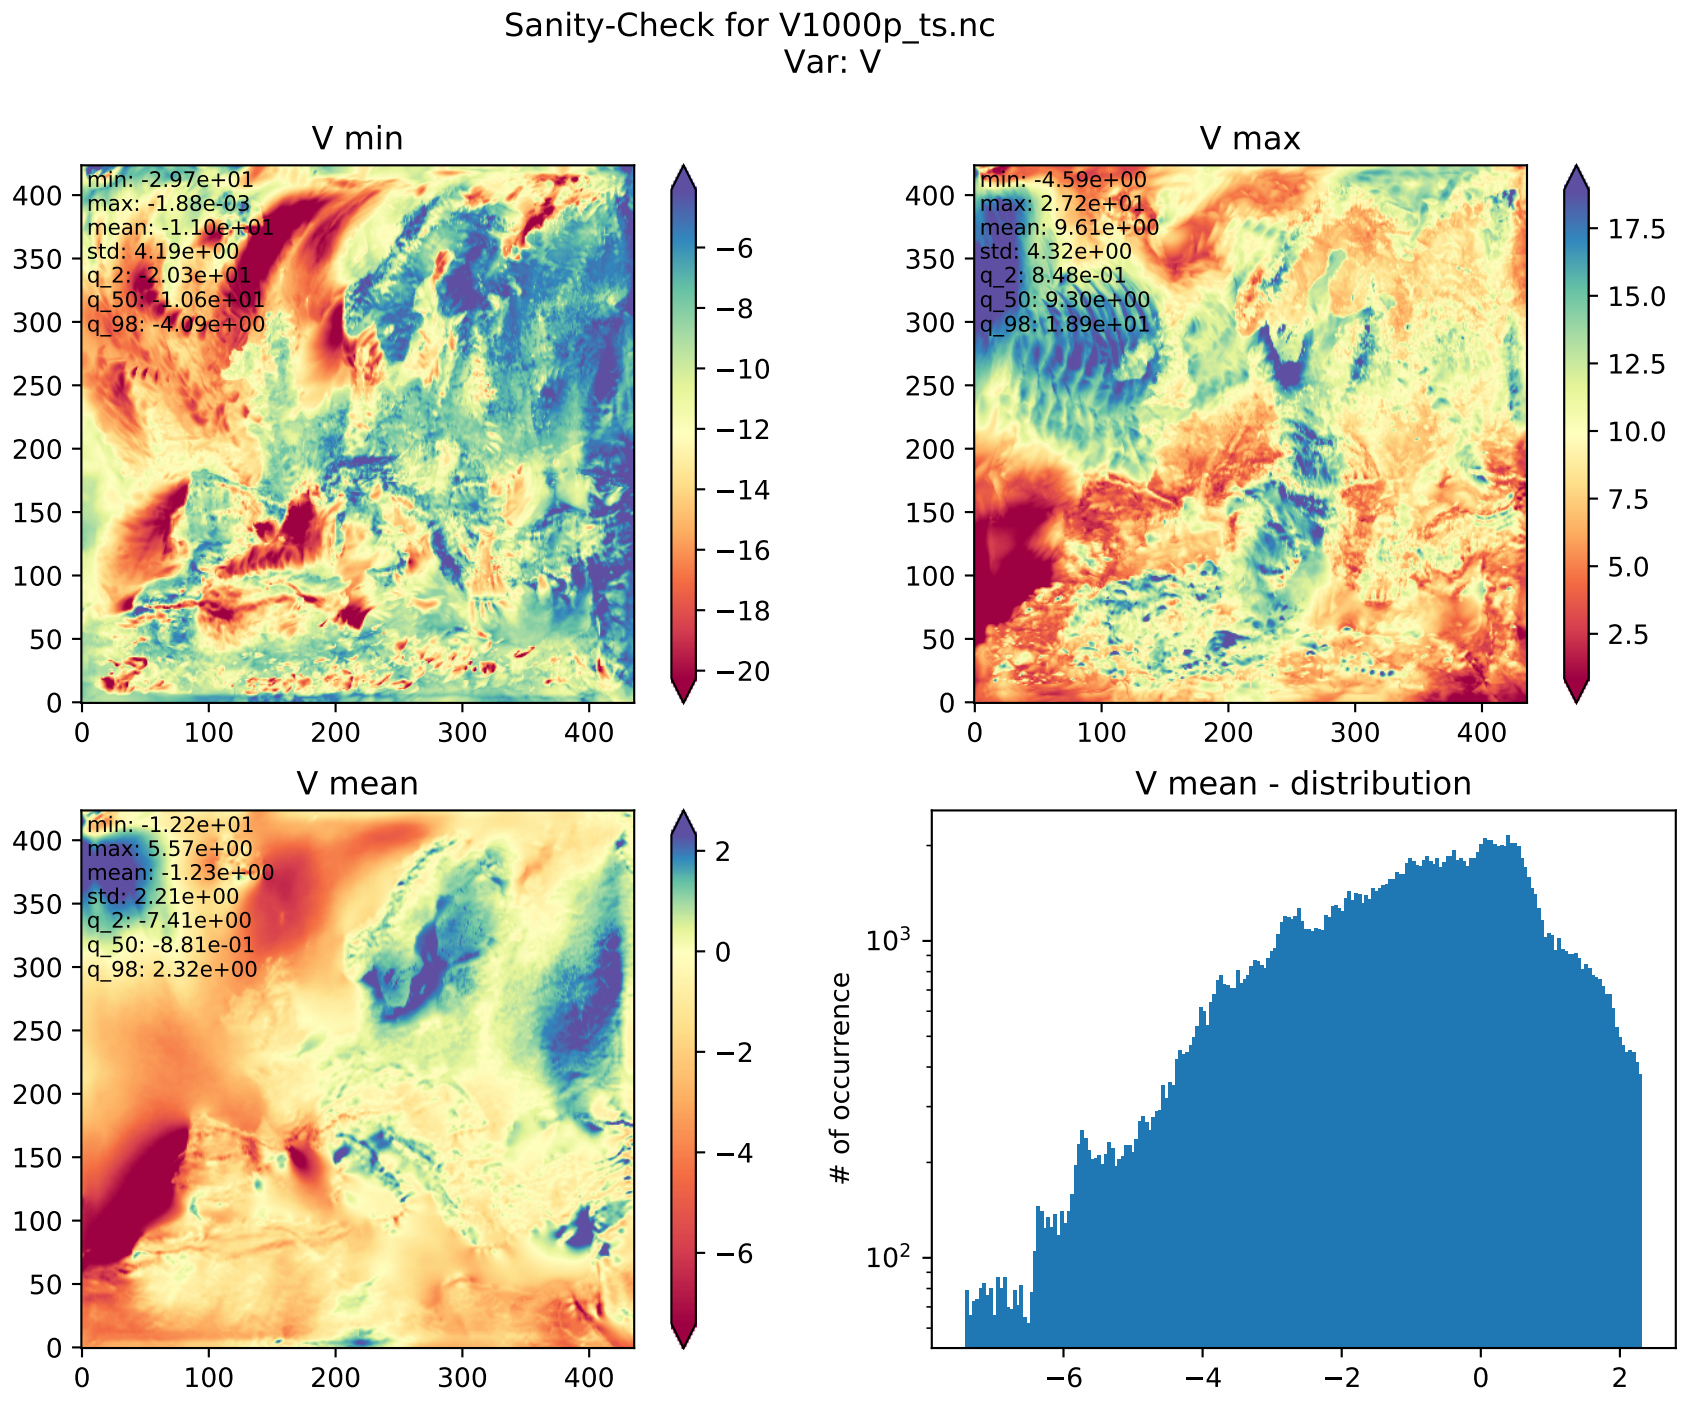
Sanity-Check for V1000p_ts.nc
Var: V
V min
min: -2.97e+01
max: -1.88e-03
mean: -1.10e+01
std: 4.19e+00
q_2: -2.03e+01
q_50: -1.06e+01
q_98: -4.09e+00
V max
min: -4.59e+00
max: 2.72e+01
mean: 9.61e+00
std: 4.32e+00
q_2: 8.48e-01
q_50: 9.30e+00
q_98: 1.89e+01
V mean
min: -1.22e+01
max: 5.57e+00
mean: -1.23e+00
std: 2.21e+00
q_2: -7.41e+00
q_50: -8.81e-01
q_98: 2.32e+00
V mean - distribution
# of occurrence