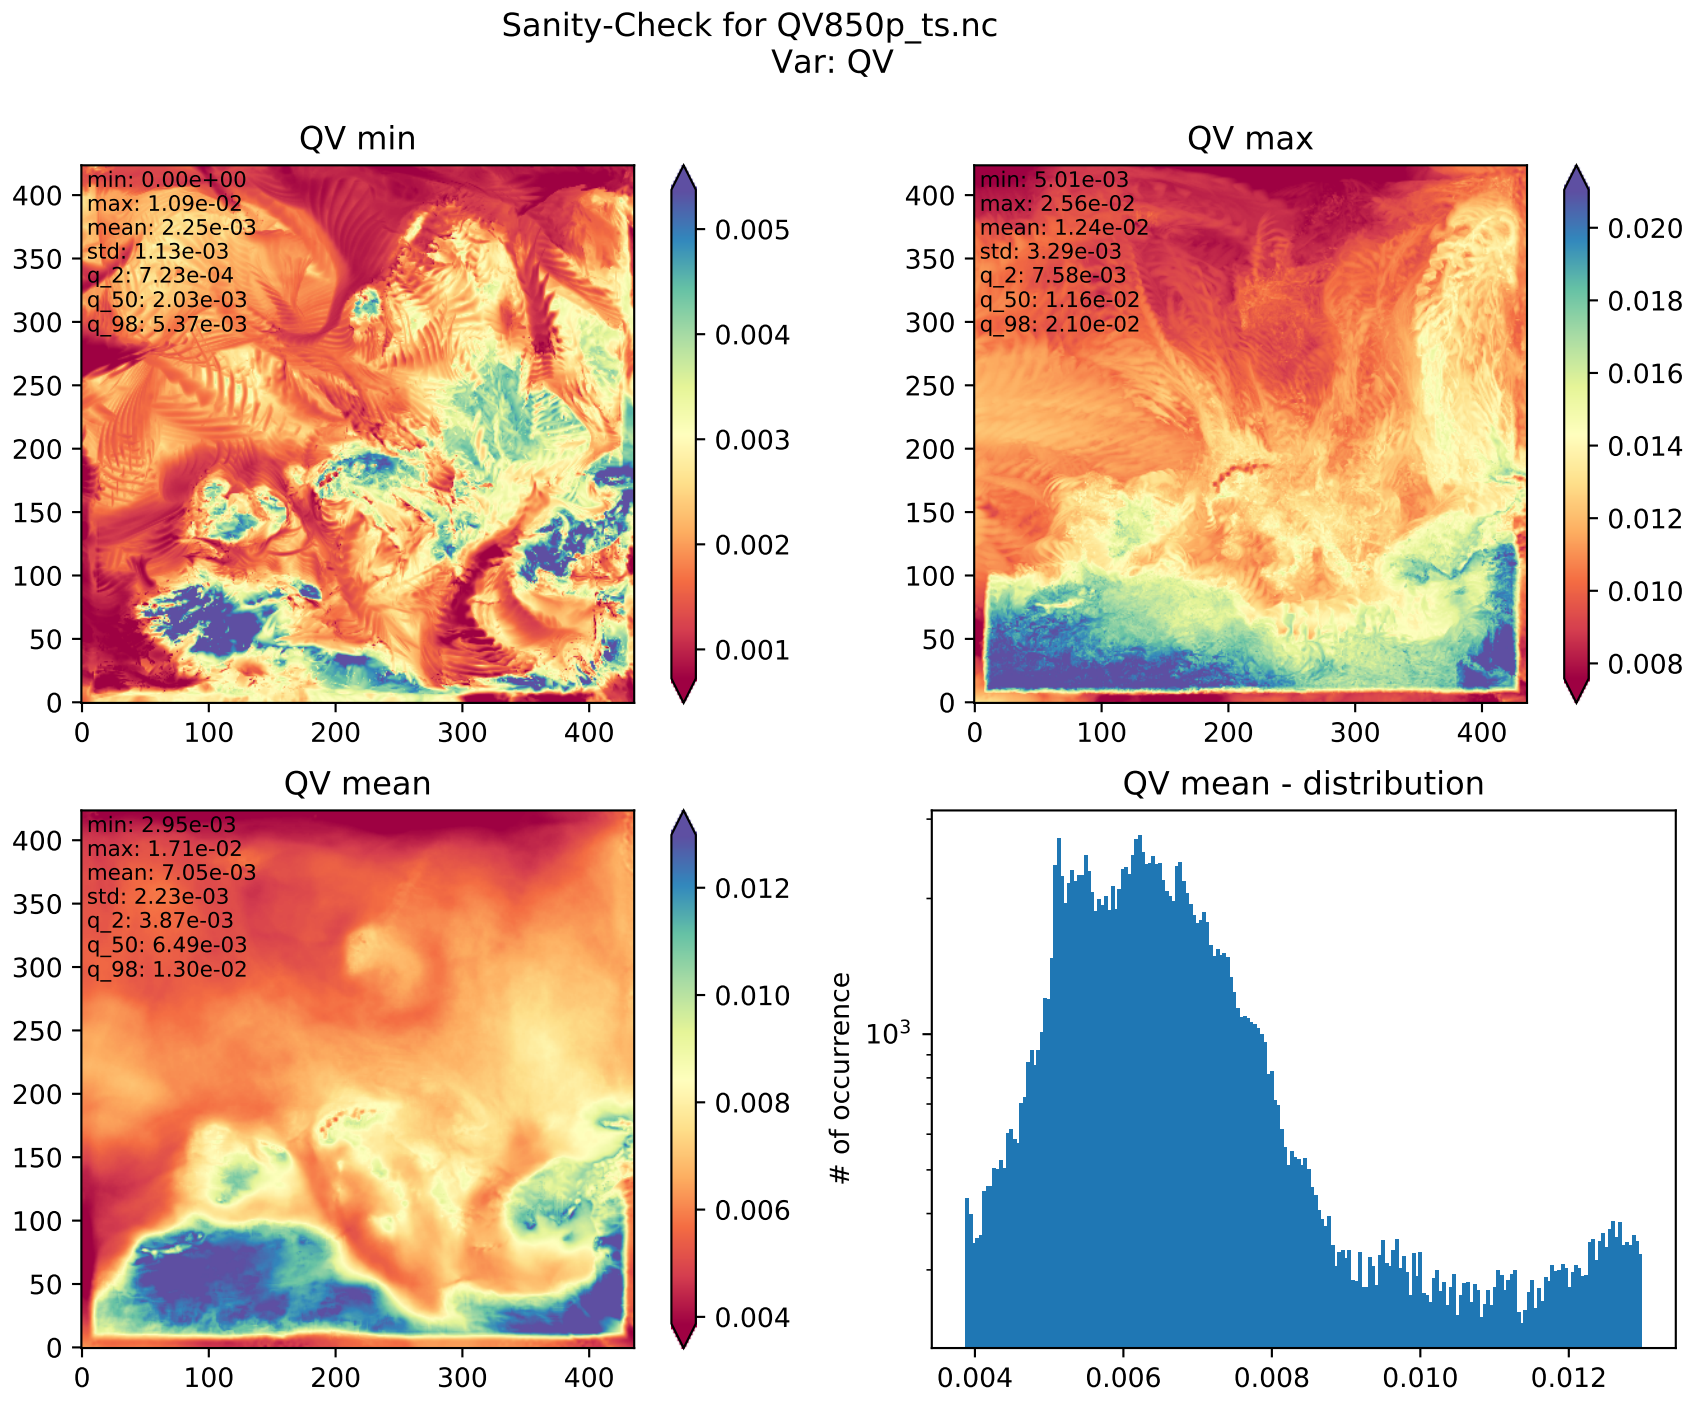
Sanity-Check for QV850p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 0.00e+00
max: 1.09e-02
mean: 2.25e-03
std: 1.13e-03
q_2: 7.23e-04
q_50: 2.03e-03
q_98: 5.37e-03
QV max
min: 5.01e-03
max: 2.56e-02
mean: 1.24e-02
std: 3.29e-03
q_2: 7.58e-03
q_50: 1.16e-02
q_98: 2.10e-02
QV mean
min: 2.95e-03
max: 1.71e-02
mean: 7.05e-03
std: 2.23e-03
q_2: 3.87e-03
q_50: 6.49e-03
q_98: 1.30e-02
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3