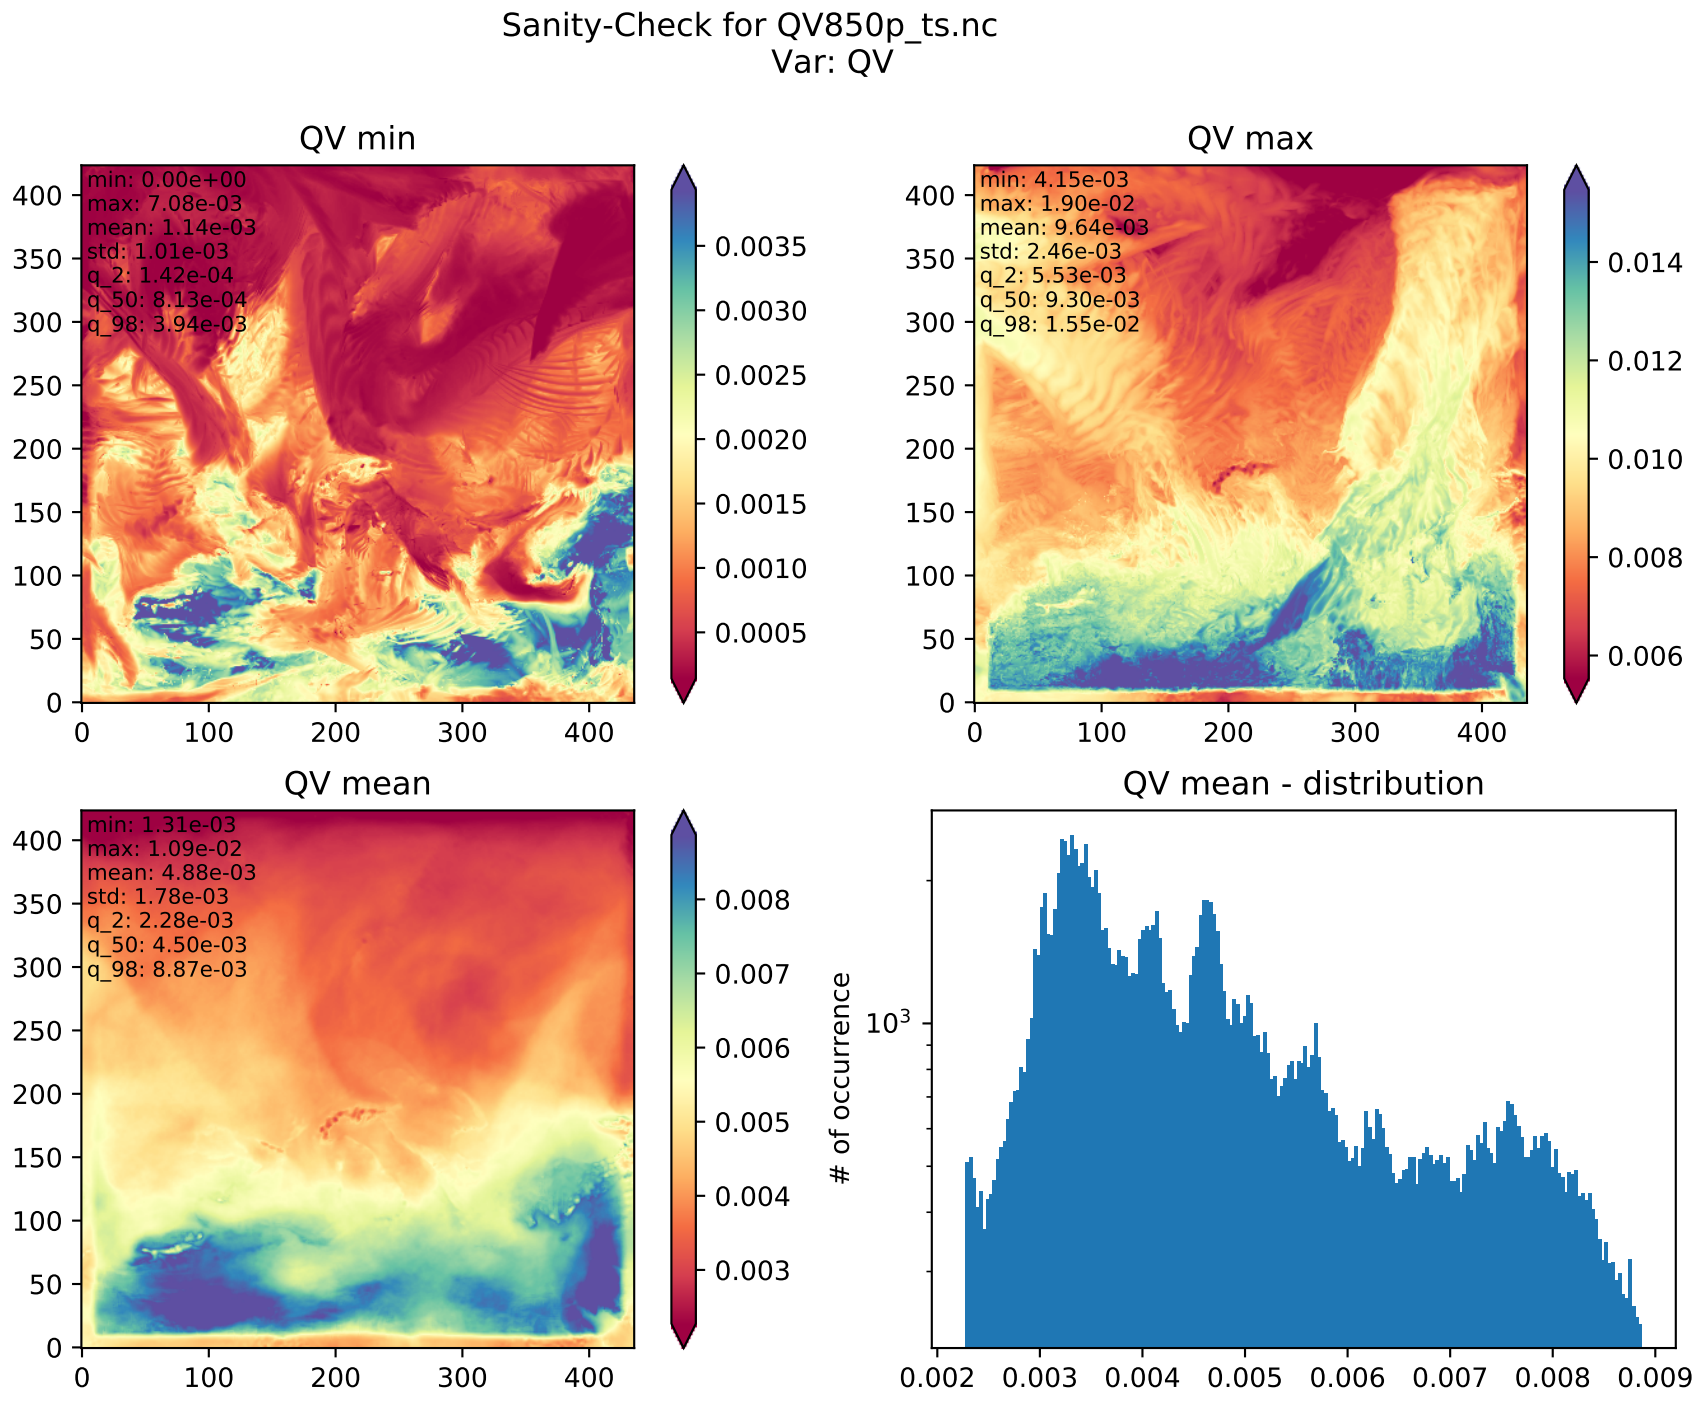
Sanity-Check for QV850p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 0.00e+00
max: 7.08e-03
mean: 1.14e-03
std: 1.01e-03
q_2: 1.42e-04
q_50: 8.13e-04
q_98: 3.94e-03
QV max
min: 4.15e-03
max: 1.90e-02
mean: 9.64e-03
std: 2.46e-03
q_2: 5.53e-03
q_50: 9.30e-03
q_98: 1.55e-02
QV mean
min: 1.31e-03
max: 1.09e-02
mean: 4.88e-03
std: 1.78e-03
q_2: 2.28e-03
q_50: 4.50e-03
q_98: 8.87e-03
QV mean - distribution
# of occurrence
10^3