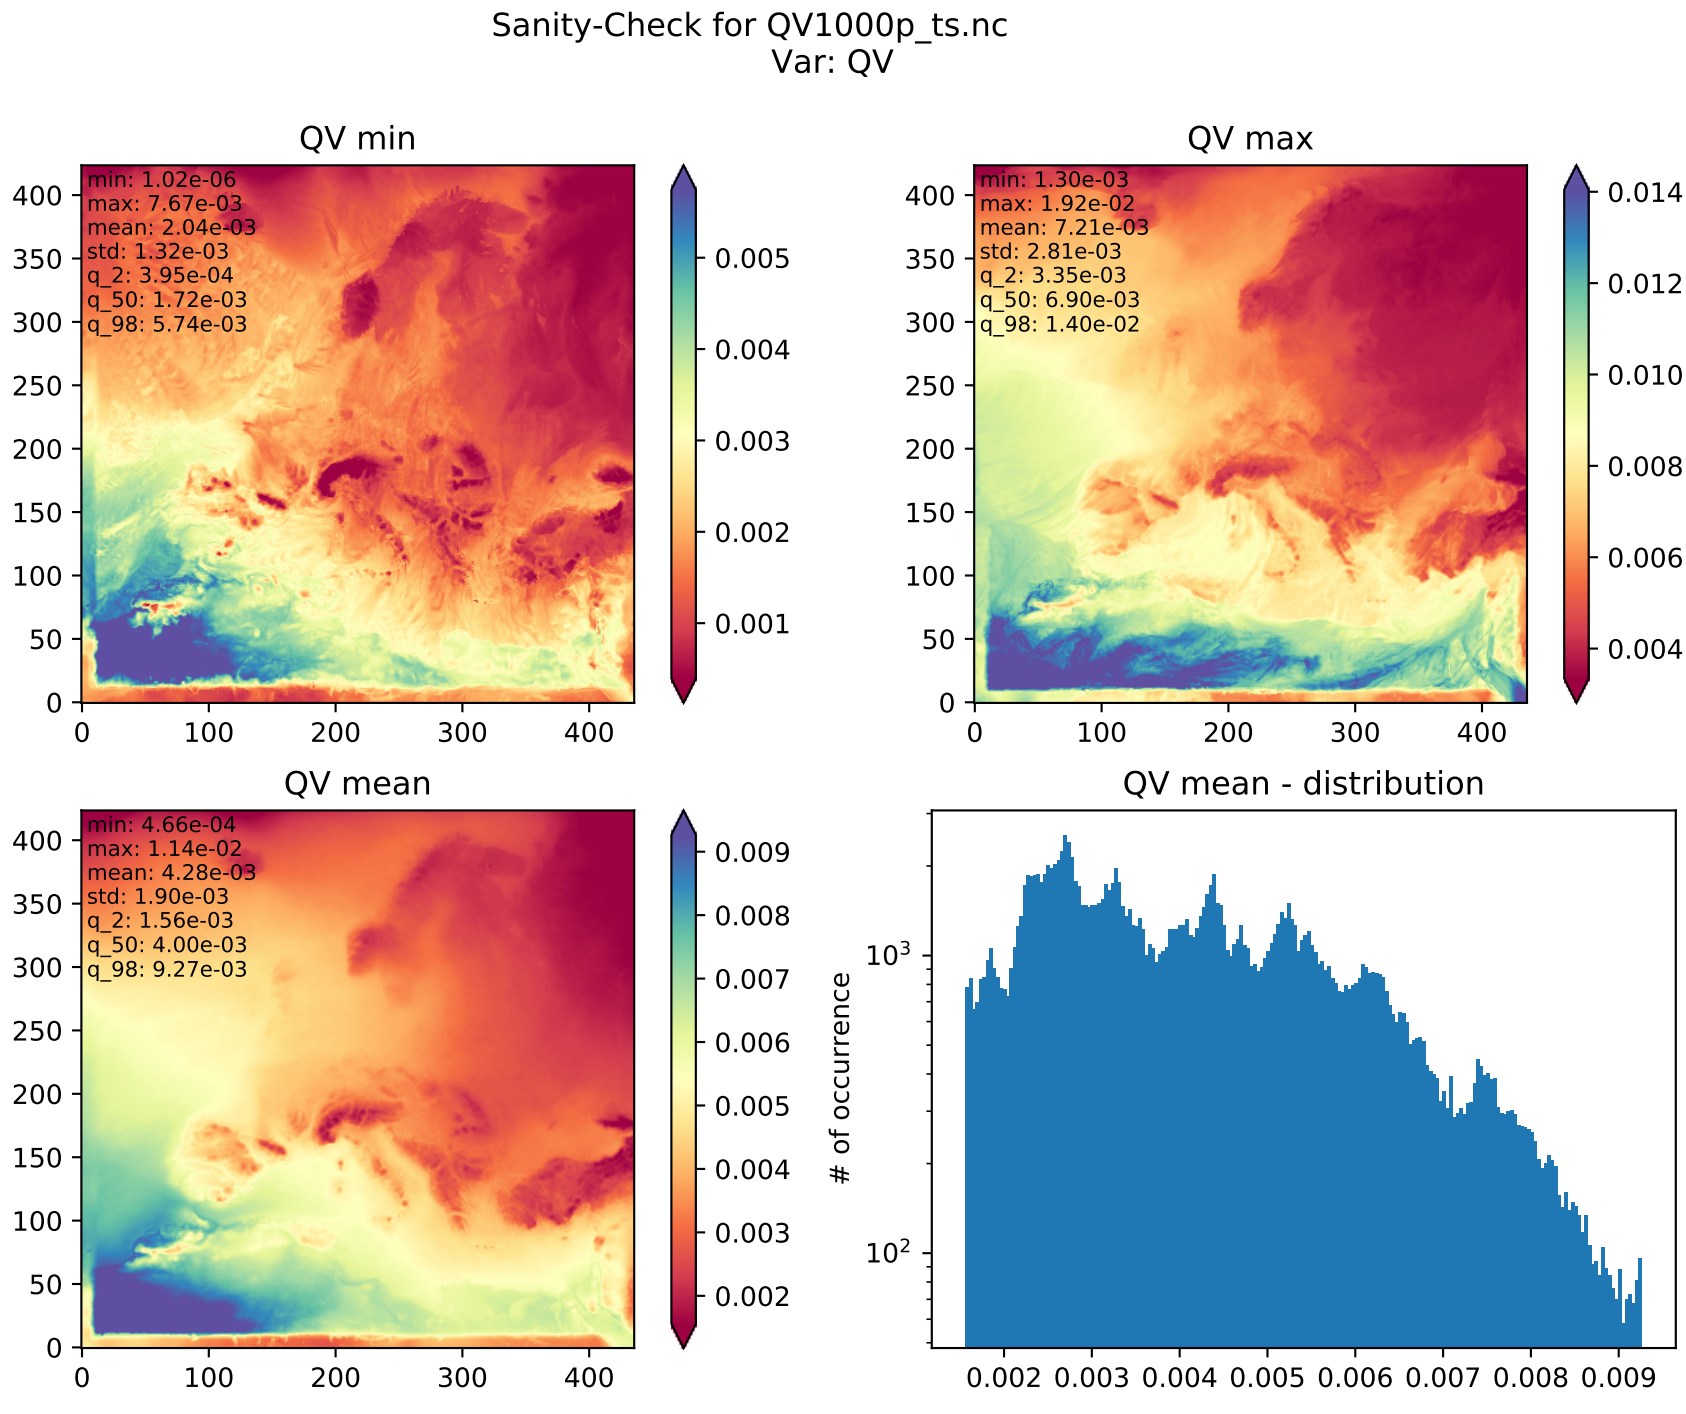
Sanity-Check for QV1000p_ts.nc
Var: QV
QV min
min: 1.02e-06
max: 7.67e-03
mean: 2.04e-03
std: 1.32e-03
q_2: 3.95e-04
q_50: 1.72e-03
q_98: 5.74e-03
QV max
min: 1.30e-03
max: 1.92e-02
mean: 7.21e-03
std: 2.81e-03
q_2: 3.35e-03
q_50: 6.90e-03
q_98: 1.40e-02
QV mean
min: 4.66e-04
max: 1.14e-02
mean: 4.28e-03
std: 1.90e-03
q_2: 1.56e-03
q_50: 4.00e-03
q_98: 9.27e-03
QV mean - distribution
# of occurrence