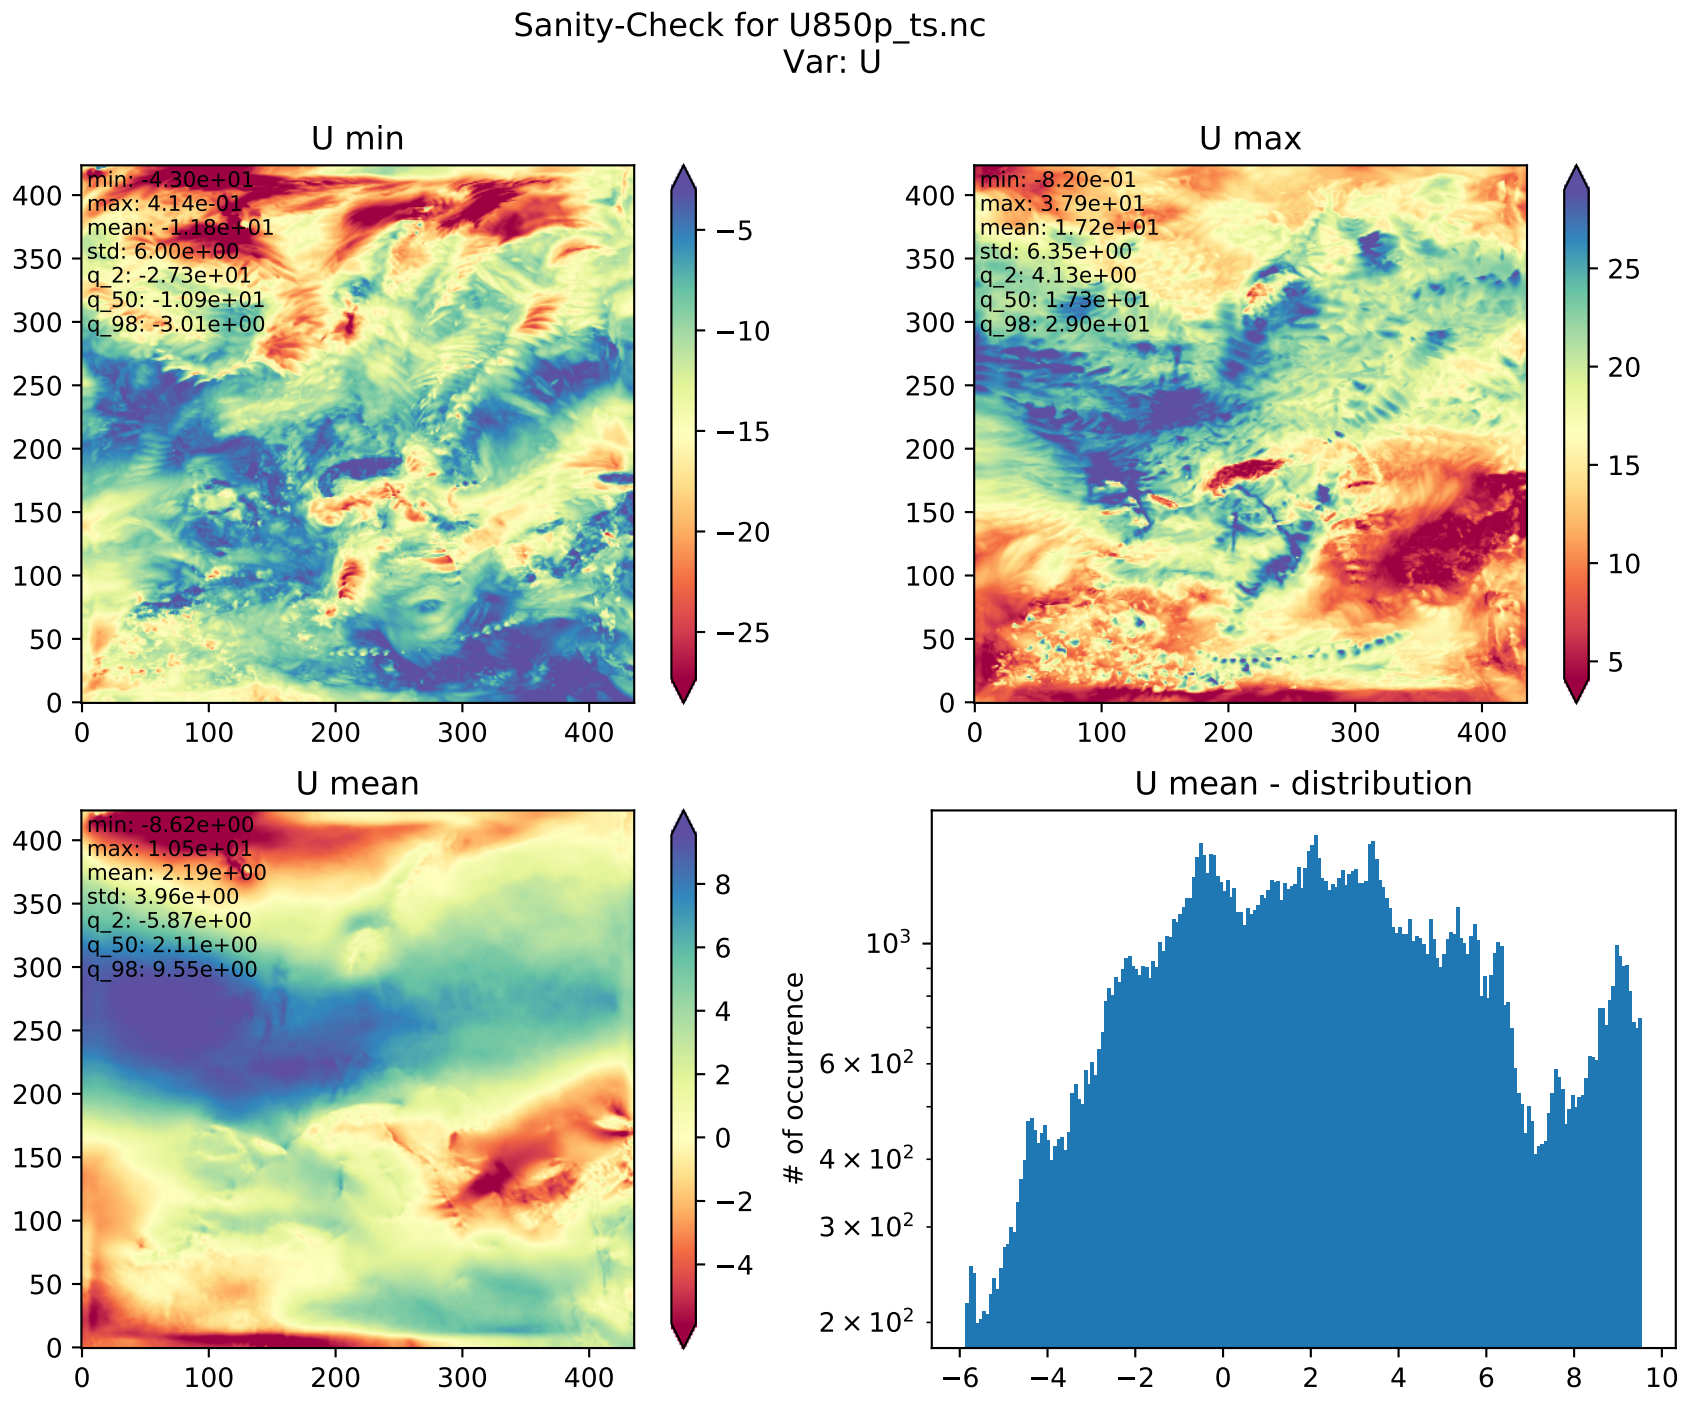
Sanity-Check for U850p_ts.nc
Var: U
U min
min: -4.30e+01
max: 4.14e-01
mean: -1.18e+01
std: 6.00e+00
q_2: -2.73e+01
q_50: -1.09e+01
q_98: -3.01e+00
U max
min: -8.20e-01
max: 3.79e+01
mean: 1.72e+01
std: 6.35e+00
q_2: 4.13e+00
q_50: 1.73e+01
q_98: 2.90e+01
U mean
min: -8.62e+00
max: 1.05e+01
mean: 2.19e+00
std: 3.96e+00
q_2: -5.87e+00
q_50: 2.11e+00
q_98: 9.55e+00
U mean - distribution
# of occurrence