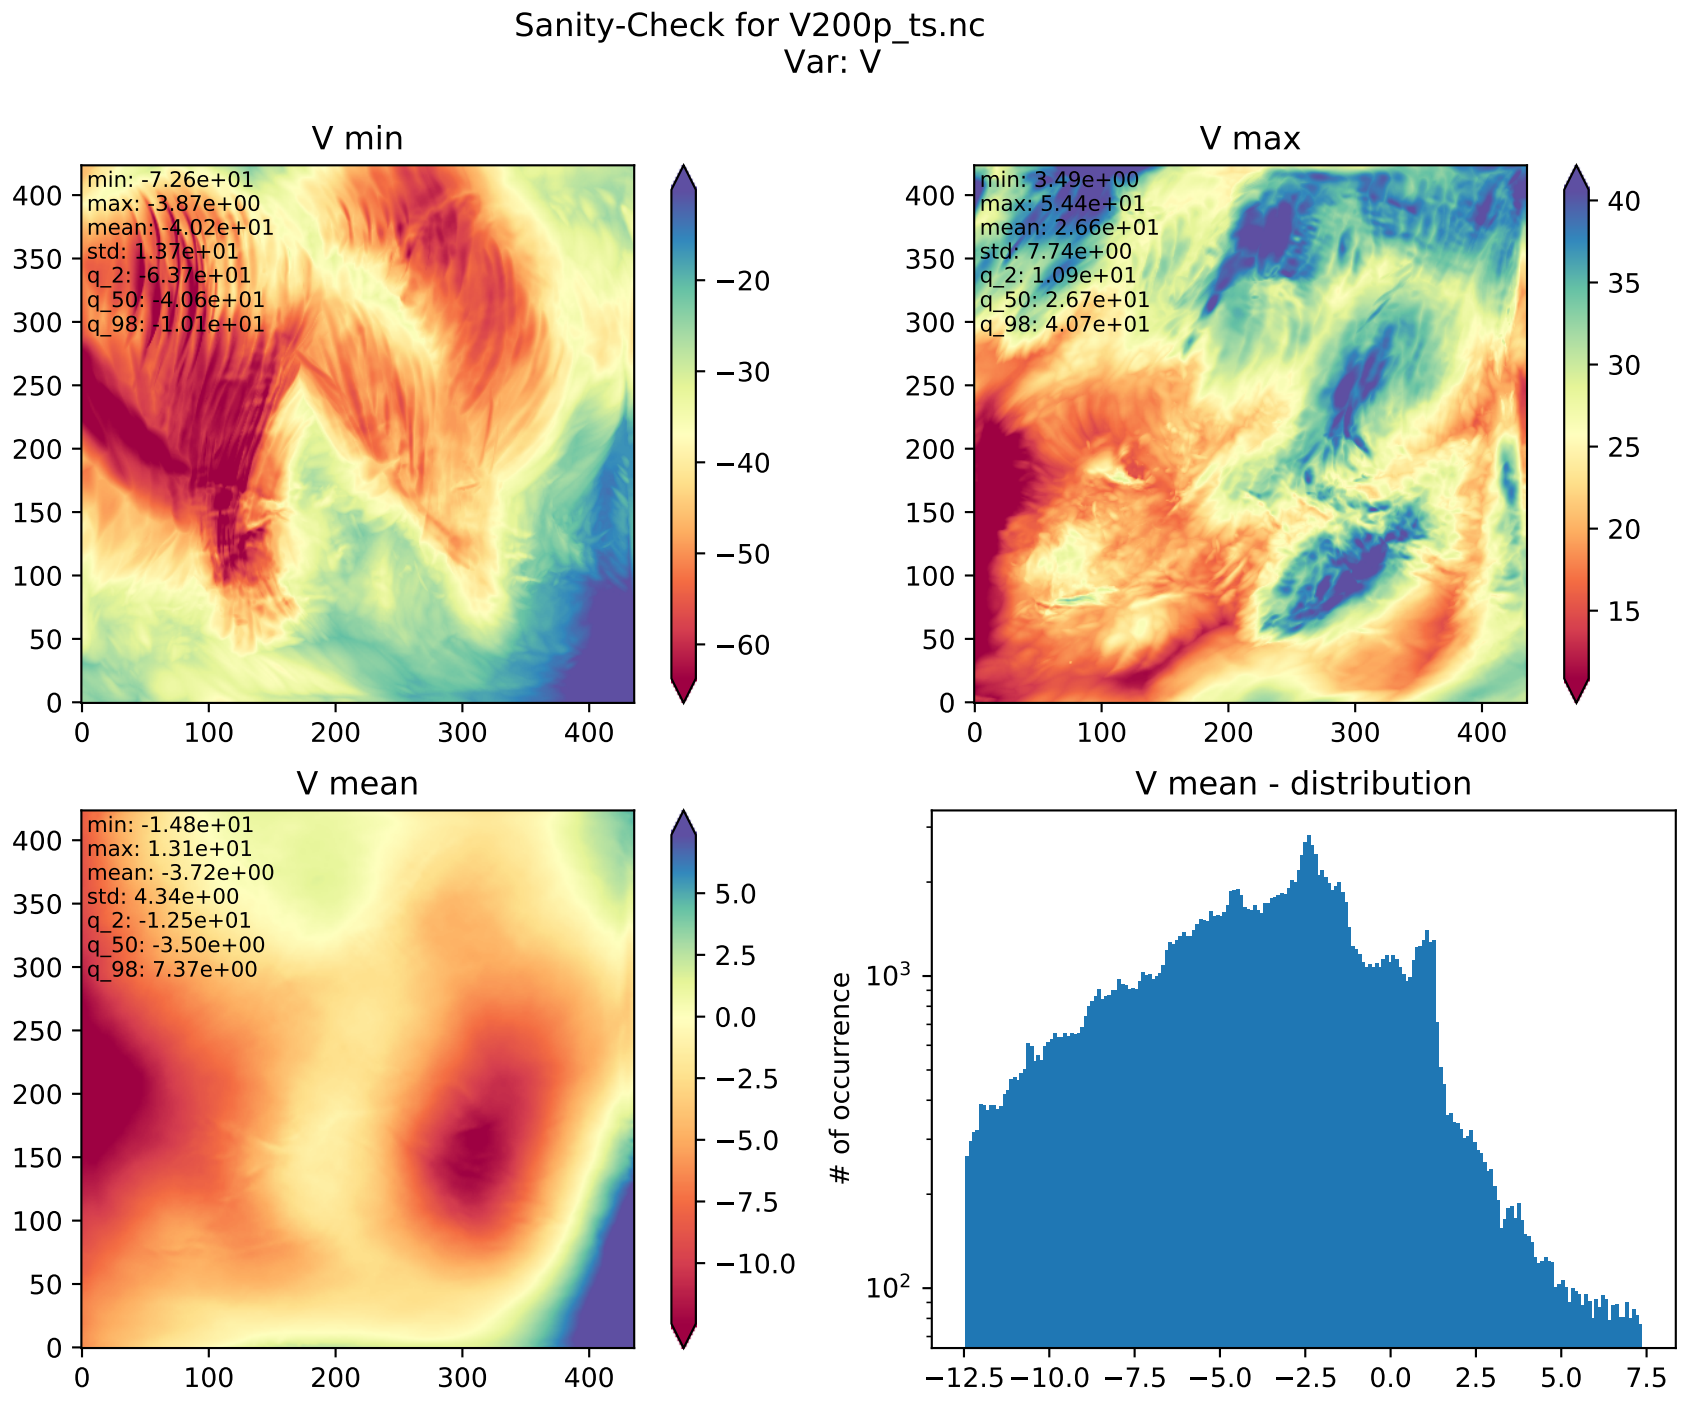
Sanity-Check for V200p_ts.nc
Var: V
V min
min: -7.26e+01
max: -3.87e+00
mean: -4.02e+01
std: 1.37e+01
q_2: -6.37e+01
q_50: -4.06e+01
q_98: -1.01e+01
V max
min: 3.49e+00
max: 5.44e+01
mean: 2.66e+01
std: 7.74e+00
q_2: 1.09e+01
q_50: 2.67e+01
q_98: 4.07e+01
V mean
min: -1.48e+01
max: 1.31e+01
mean: -3.72e+00
std: 4.34e+00
q_2: -1.25e+01
q_50: -3.50e+00
q_98: 7.37e+00
V mean - distribution
# of occurrence