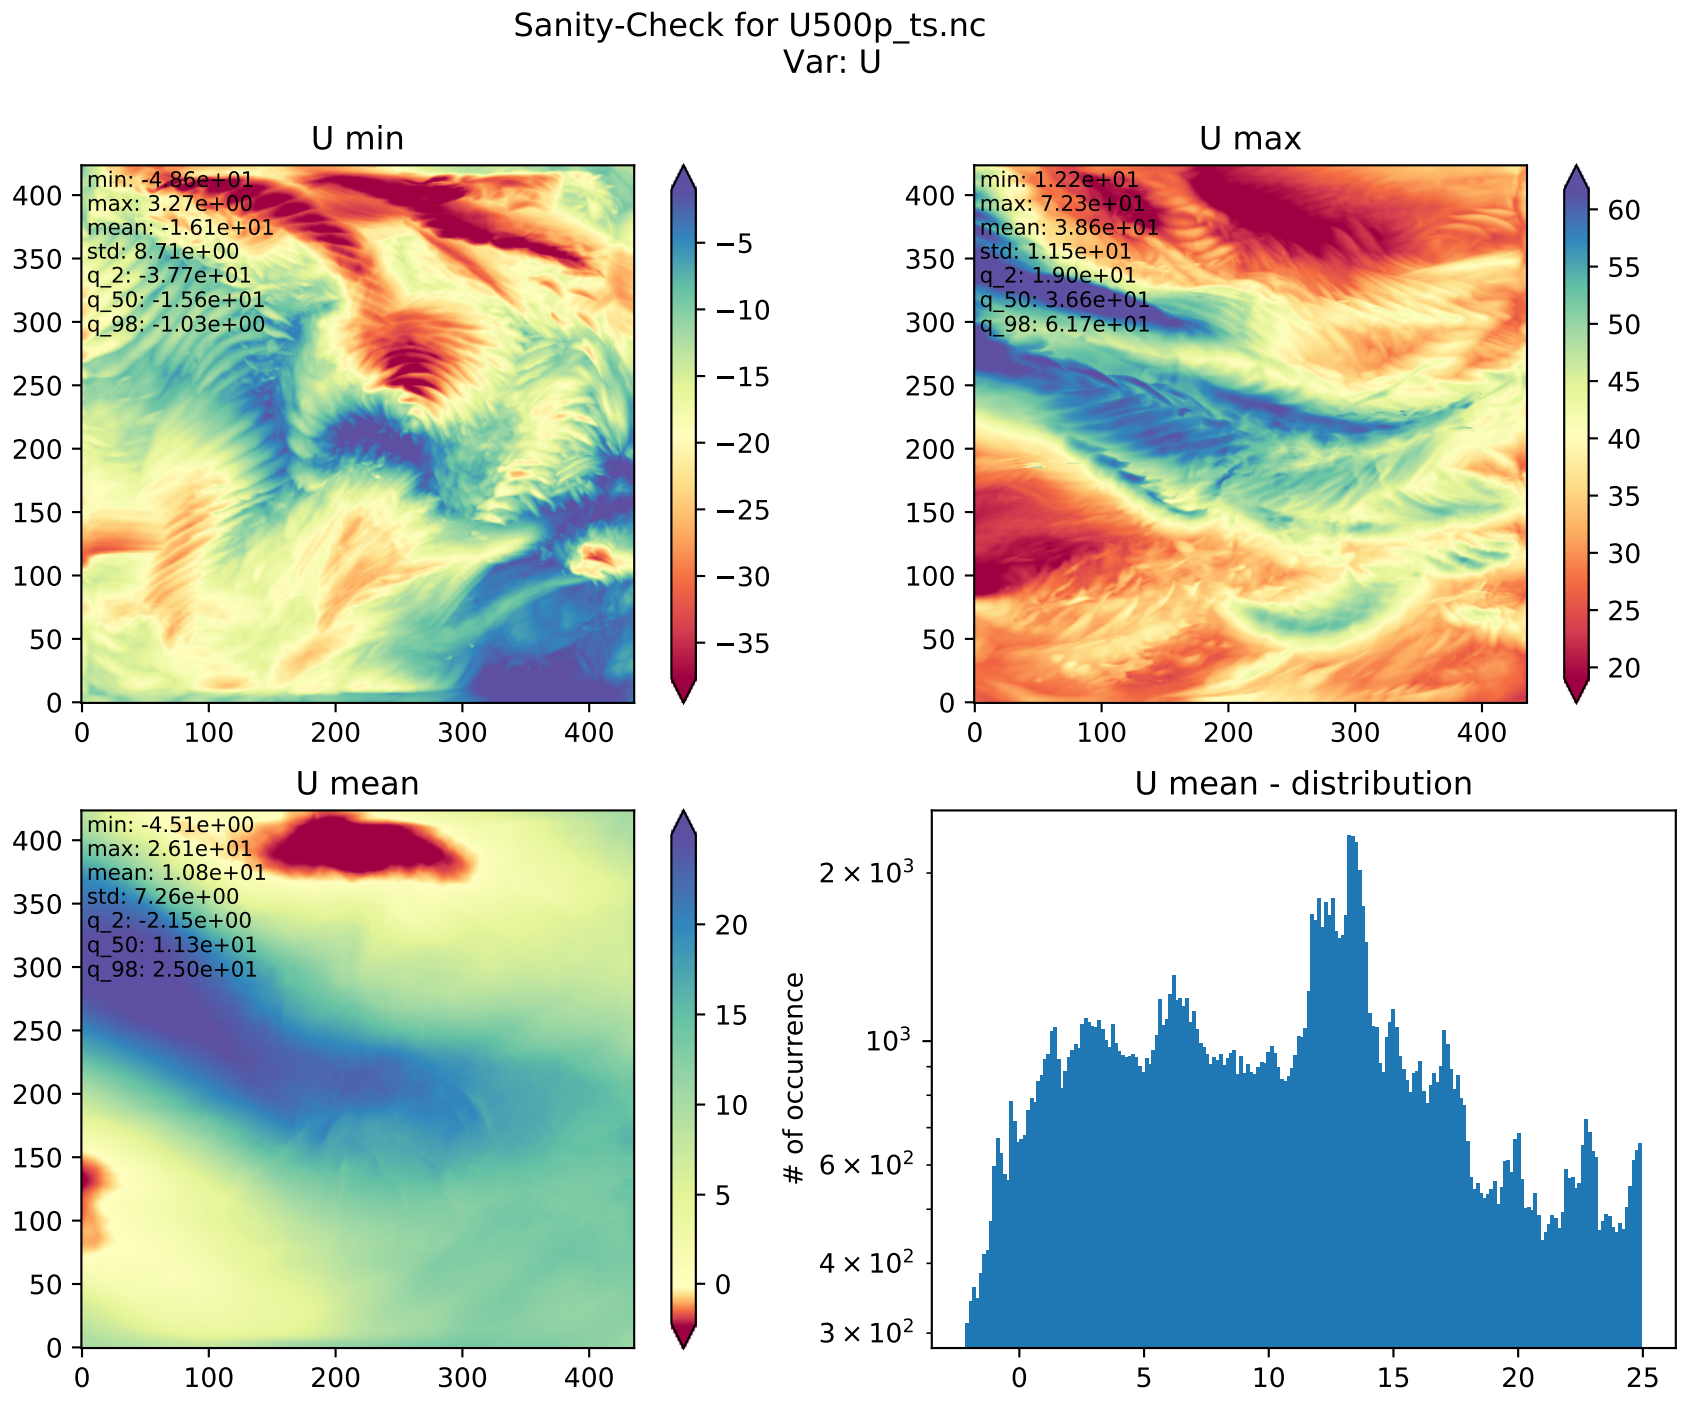
Sanity-Check for U500p_ts.nc
Var: U
U min
min: -4.86e+01
max: 3.27e+00
mean: -1.61e+01
std: 8.71e+00
q_2: -3.77e+01
q_50: -1.56e+01
q_98: -1.03e+00
U max
min: 1.22e+01
max: 7.23e+01
mean: 3.86e+01
std: 1.15e+01
q_2: 1.90e+01
q_50: 3.66e+01
q_98: 6.17e+01
U mean
min: -4.51e+00
max: 2.61e+01
mean: 1.08e+01
std: 7.26e+00
q_2: -2.15e+00
q_50: 1.13e+01
q_98: 2.50e+01
U mean - distribution
# of occurrence